

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

CALIBRATION CERTIFICATE

Certificado N°

L4511125

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: MONITOR DE PRESIÓN

Device

MARCA: LENZ

Brand

MODELO: NA

Model

SERIE: 805BJ09150000926

Serial

Inventario Institución: 572989

Institute Inventory

PATRONES UTILIZADOS

Equipo	Marca	Modelo	Serie	Fecha de calibración
Simulador de Signos Vitales	Fluke Biomedical	ProSim 4	2667213	2025-01-30

CONDICIONES DE LA MEDICIÓN

Fecha Recepción: 2025-12-01

Date of Receipt

Fecha Calibración: 2025-12-01

Date of Calibration

TEMPERATURA Inicial: 21 °C **Final:** 22 °C

Temperature

End

HUMEDAD Rel. Inicial: 56 % **Final:** 58 %

Humidity

End

Lugar de Calibración: ALMACEN

Place of Calibration

DATOS DE LA INSTITUCIÓN

INSTITUCIÓN: Hospital universitario San Jorge de pereira

Institution

TELÉFONO: 6063119058

Telephone

CIUDAD: PEREIRA

City

DIRECCIÓN: cra 4 #24-88

Address

Correo: rutahospitalaria@husj.gov.co

E-mail

COD: PS-FO002 - VERSION 01

Elaboró

Revisó

Leire Garcia

LEIRE GARCIA MORALES

Metrologa

Metrologist

MARTÍN LÓPEZ BALLESTEROS

Coordinador de Prestación de Servicios

Service Delivery Coordinator

Cooperativa de Entidades de Salud del Risaralda
Avenida 30 de Agosto 87 298 Pereira Risaralda
PBX: (6) 3272070
www.coodesuris.com

Certificado de Calibración N° L4511125

NOTAS ACLARATORIAS

Este certificado no podrá ser reproducido total o parcialmente excepto cuando se haya obtenido permiso por escrito de Coodesuris.
This certificate must not be partially or totally reproduced, except with Coodesuris permission.

Los resultados contenidos en el presente certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones.
The results of this certificate refer to the moment and condition in which the measurements were made.

El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos calibrados.
The issuing laboratory assumes no responsibility for the misuse of the calibrated instruments.

El usuario es responsable de la recalibración de sus instrumentos a intervalos apropiados.
The user is responsible for having his instruments calibrated at appropriate intervals.


La calibración se realiza por el método de comparación con un patrón de referencia.
Calibration is performed by the method of comparison with a reference pattern.

La incertidumbre de calibración ha sido estimada con un nivel de confianza del 95% utilizando un factor de cobertura $k=2$.
The calibration uncertainty has been estimated with a confidence level of 95% using a coverage factor $k=2$.

RESULTADOS DE LA MEDICIÓN

PRESIÓN NO INVASIVA SISTÓLICA

Valor de Referencia (EQUIPO PATRÓN)	Medición Promedio (EQUIPO BAJO PRUEBA)	ERROR	Incertidumbre Expandida	Unidad de la Medición
80	74.50	-5.50	± 1.01	mmHg
120	120.25	0.25	± 1.50	
200	194.00	-6.00	± 1.42	

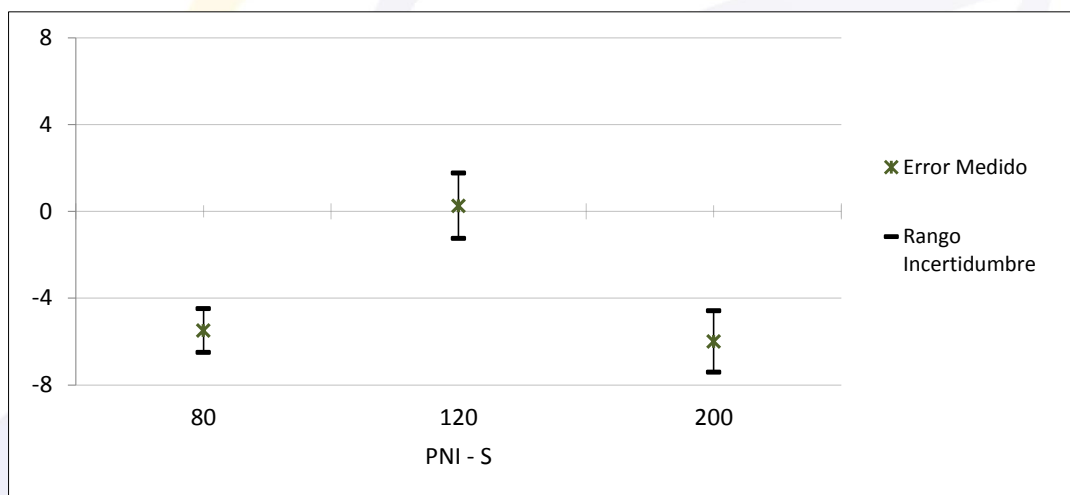


Cooperativa de Entidades de Salud del Risaralda
Avenida 30 de Agosto 87 298 Pereira Risaralda
PBX: (6) 3272070
www.coodesuris.com

Certificado de Calibración N° L4511125

PRESIÓN NO INVASIVA DIASTÓLICA

Valor de Referencia (EQUIPO PATRÓN)	Medición Promedio (EQUIPO BAJO PRUEBA)	ERROR	Incertidumbre Expandida	Unidad de la Medición
50	46.50	-3.50	± 1.01	mmHg

80	82.75	2.75	±	2.22
150	146.00	-4.00	±	0.82

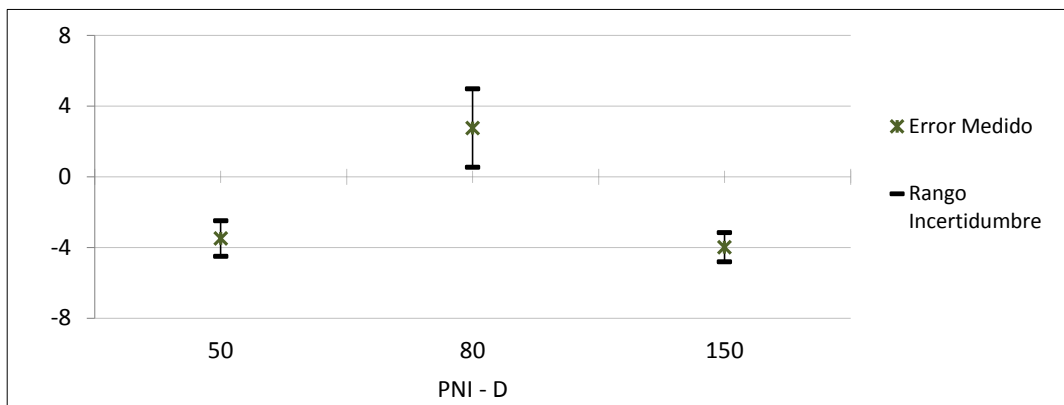


FRECUENCIA CARDIACA

Valor de Referencia (EQUIPO PATRÓN)	Medición Promedio (EQUIPO BAJO PRUEBA)	ERROR		Incertidumbre Expandida
60	59.00	-1.00	±	0.82
130	130.50	0.50	±	1.91
180	179.00	-1.00	±	0.82

Unidad de la Medición

BPM

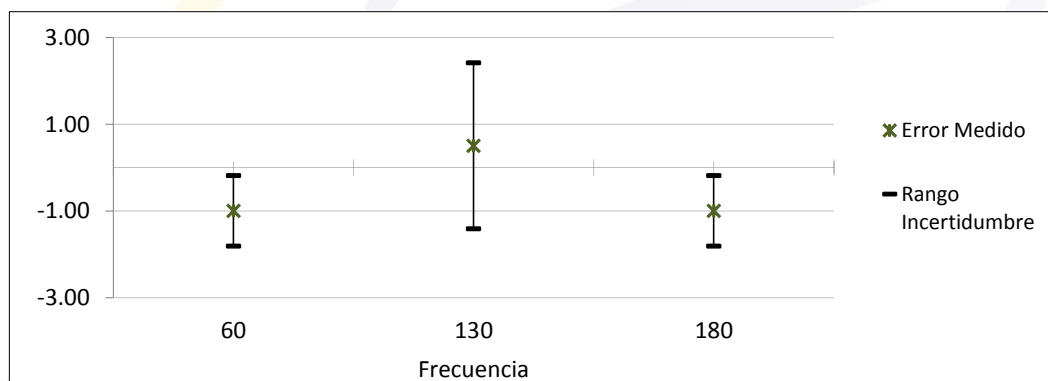

FIN DEL CERTIFICADO