

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

CALIBRATION CERTIFICATE

Certificado N°

L4571125

DATOS DEL EQUIPO			
EQUIPO: Device	MONITOR DE PRESIÓN	MARCA: Brand	LENZ
MODELO: Model	NA	SERIE: Serial	805BJ09150000459
Inventario Institución: Institute Inventory	573027		

PATRONES UTILIZADOS				
Equipo	Marca	Modelo	Serie	Fecha de calibración
Simulador de Signos Vitales	Fluke Biomedical	ProSim 4	2667213	2025-01-30

CONDICIONES DE LA MEDICIÓN							
Fecha Recepción: Date of Receipt	2025-12-03		Fecha Calibración: Date of Calibration	2025-12-03			
TEMPERATURA Inicial: Temperature	21 °C	Final: End	22 °C	HUMEDAD Rel. Inicial: Humidity	56 %	Final: End	58 %
Lugar de Calibración: Place of Calibration	CONSULTA EXTERNA						

DATOS DE LA INSTITUCIÓN	
INSTITUCIÓN: Hospital universitario San Jorge de pereira Institution	
TELÉFONO: 6063119058 Telephone	CIUDAD: PEREIRA City
DIRECCIÓN: cra 4 #24-88 Address	Correo: rutahospitalaria@husj.gov.co E-mail

COD: PS-FO002 - VERSION 01

Elaboró

Revisó


JORGE CARDONA IDARRAGA
Métrólogo


MARTÍN LÓPEZ BALLESTEROS
Coordinador de Prestación de Servicios
Service Delivery Coordinator

Metrologist
Cooperativa de Entidades de Salud del Risaralda
Avenida 30 de Agosto 87 298 Pereira Risaralda
PBX: (6) 3272070
www.coodesuris.com

NOTAS ACLARATORIAS

Este certificado no podrá ser reproducido total o parcialmente excepto cuando se haya obtenido permiso por escrito de Coodesuris
This certificate must not be partially or totally reproduced, except with Coodesuris permission.

Los resultados contenidos en el presente certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones.
The results of this certificate refer to the moment and condition in which the measurements were made.

El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos calibrados.
The issuing laboratory assumes no responsibility to the misuse of the calibrated instruments.

El usuario es responsable de la recalibración de sus instrumentos a intervalos apropiados.
The user is responsible for having his instruments calibrated at appropriate intervals.


La calibración se realiza por el método de comparación con un patrón de referencia
Calibration is performed by the method of comparison with a reference pattern

La incertidumbre de calibración ha sido estimada con un nivel de confianza del 95% utilizando un factor de cobertura $k=2$
The calibration uncertainty has been estimated with a confidence level of 95% using a coverage factor $k = 2$

RESULTADOS DE LA MEDICIÓN

PRESIÓN NO INVASIVA SISTÓLICA

Valor de Referencia (EQUIPO PATRÓN)	Medición Promedio (EQUIPO BAJO PRUEBA)	ERROR		Incertidumbre Expandida	Unidad de la Medición
80	75.50	-4.50	$\pm$	1.01	
120	122.50	2.50	$\pm$	1.92	mmHg
200	194.50	-5.50	$\pm$	1.01	

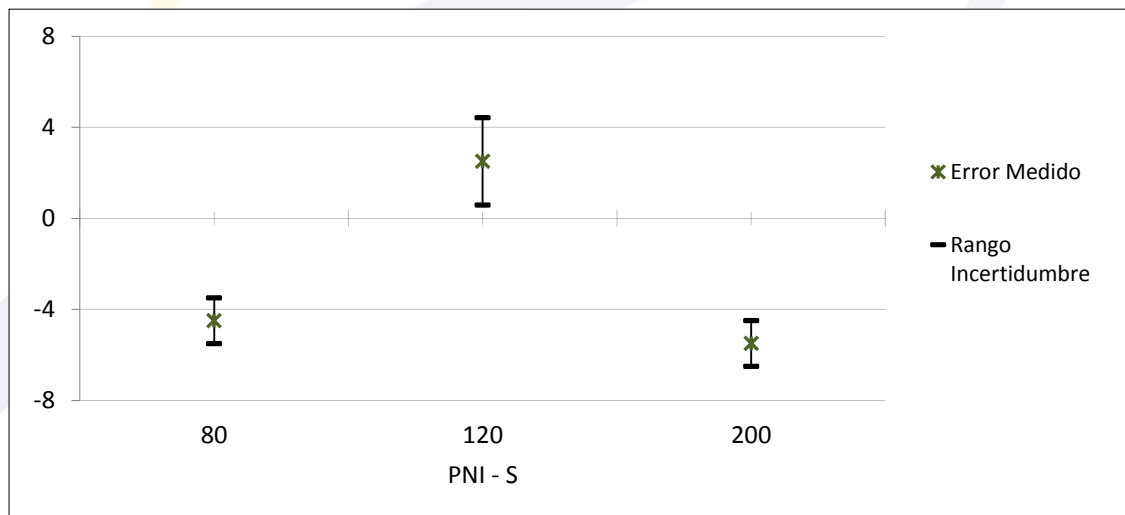


Cooperativa de Entidades de Salud del Risaralda
Avenida 30 de Agosto 87 298 Pereira Risaralda
PBX: (6) 3272070
www.coodesuris.com

Certificado de Calibración N° L4571125

PRESIÓN NO INVASIVA DIASTÓLICA

Valor de Referencia (EQUIPO PATRÓN)	Medición Promedio (EQUIPO BAJO PRUEBA)	ERROR		Incertidumbre Expandida
50	47.50	-2.50	±	1.01
80	78.00	-2.00	±	3.56
150	147.50	-2.50	±	1.01


Unidad de la Medición
mmHg

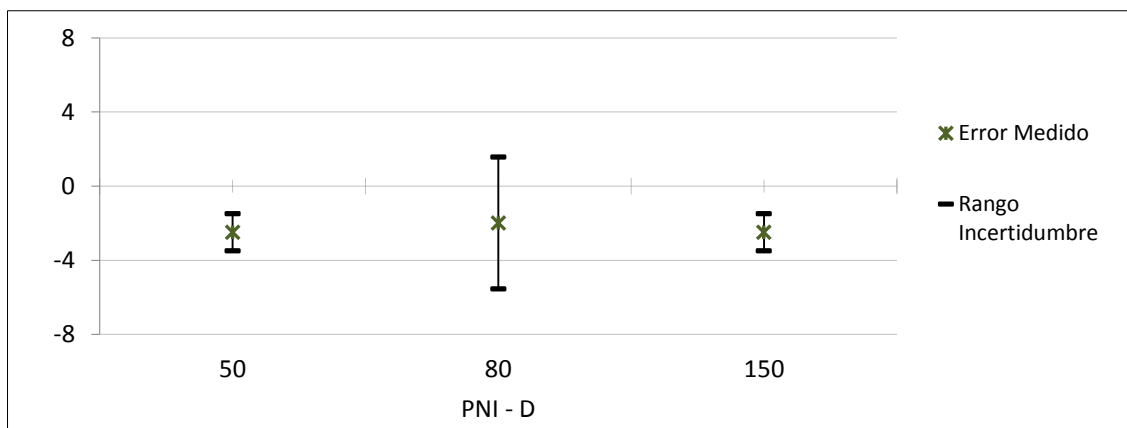

FRECUENCIA CARDIACA

Valor de Referencia (EQUIPO PATRÓN)	Medición Promedio (EQUIPO BAJO PRUEBA)	ERROR		Incertidumbre Expandida
60	59.50	-0.50	±	1.00
130	131.00	1.00	±	0.82
180	179.50	-0.50	±	1.00

Unidad de la Medición
BPM

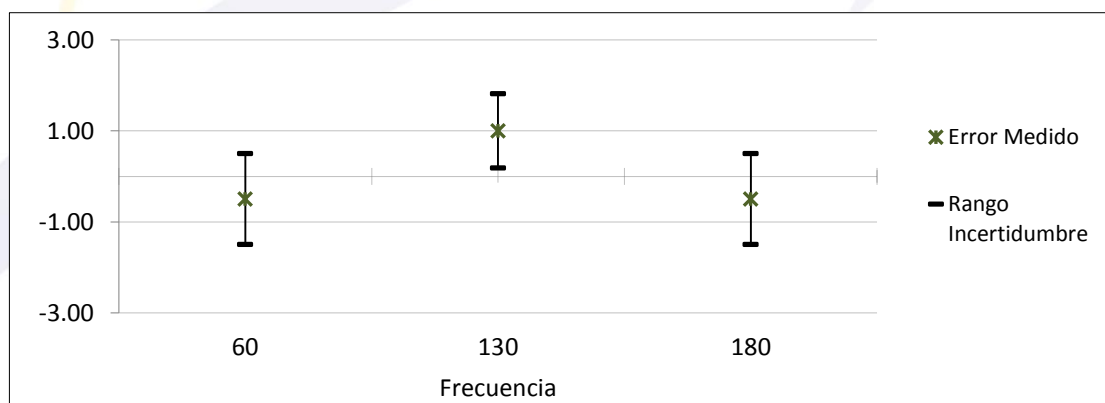

FIN DEL CERTIFICADO