

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
CALIBRATION CERTIFICATE

Certificado N° J0520825

DATOS DEL EQUIPO				
EQUIPO: Device	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MARCA: Brand	EDAN	
MODELO: Model	iM70	SERIE: Serial	360080-M20912910002	
Inventario Institución: Institute Inventory	573328	UBICACIÓN: Location	INTERMEDIOS NEONATOS	

PATRONES UTILIZADOS				
Equipo	Marca	Modelo	Serie	Fecha de calibración
Simulador de Signos Vitales	Fluke Biomedical	ProSim 4	2667213	2025-01-30

CONDICIONES DE LA MEDICIÓN				
Fecha Recepción: Date of Receipt	2025-08-20	Fecha Calibración: Date of Calibration	2025-08-20	
TEMPERATURA Inicial: Temperature	25,8 °C	Final: End	25,8 °C	
HUMEDAD Rel. Inicial: Humidity	59 %	Final: End	59 %	
Lugar de Calibración: Place of Calibration	HOSPITAL SAN JORGE			

DATOS DE LA INSTITUCIÓN				
INSTITUCIÓN: Institution	HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE			
TELÉFONO: Telephone	(606)3119058	CIUDAD: City	PEREIRA	
DIRECCIÓN: Address	CRA 4 # 24-88	Correo: E-mail	coordinacion.biomedicos@husj.gov.co	

COD: PS-FO002 - VERSION 01 (5V)

Elaboró



JORGE CARDONA IDARRAGA
Metrólogo
Metrologist

Revisó



MARTÍN LÓPEZ BALLESTEROS
Coordinador de Prestación de Servicios
Service Delivery Coordinator

NOTAS ACLARATORIAS

Este certificado no podrá ser reproducido total o parcialmente excepto cuando se haya obtenido permiso por escrito de Coodesuris
This certificate must not be partially or totally reproduced, except with Coodesuris permission.

Los resultados contenidos en el presente certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones.
The results of this certificate refer to the moment and condition in which the measurements were made.

El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos calibrados.
The issuing laboratory assumes no responsibility to the misuse of the calibrated instruments.

El usuario es responsable de la recalibración de sus instrumentos a intervalos apropiados
The user is responsible for having his instruments calibrated at appropriate intervals.


La calibración se realiza por el método de comparación con un patrón de referencia
Calibration is performed by the method of comparison with a reference pattern

La incertidumbre de calibración ha sido estimada con un nivel de confianza del 95% utilizando un factor de cobertura $k=2$
The calibration uncertainty has been estimated with a confidence level of 95% using a coverage factor $k = 2$

RESULTADOS DE LA MEDICIÓN


PRESIÓN NO INVASIVA SISTÓLICA

Valor de Referencia (EQUIPO PATRÓN)	Medición Promedio (EQUIPO BAJO PRUEBA)	ERROR	Incertidumbre Expandida	Unidad de la Medición
60	59,50	-0,50	$\pm 1,01$	mmHg
90	91,50	1,50	$\pm 1,01$	
120	120,00	0,00	$\pm 0,82$	

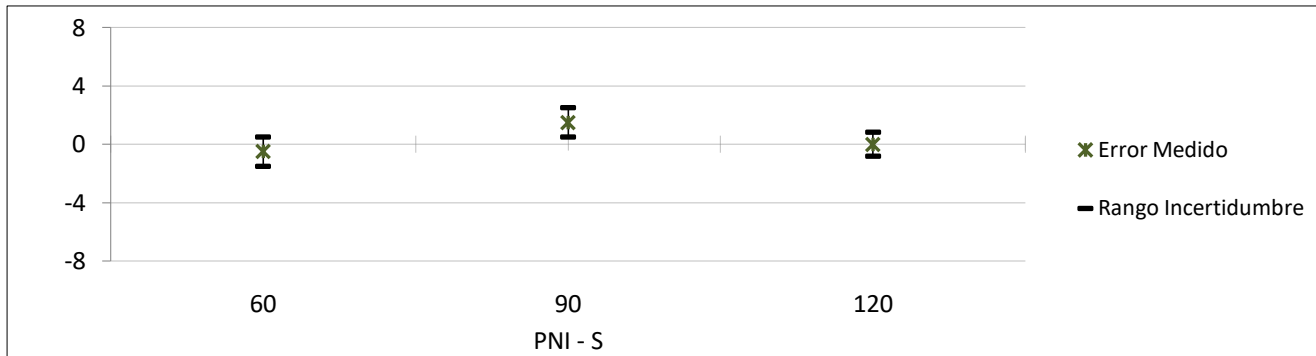


PRESIÓN NO INVASIVA DIASTÓLICA

Valor de Referencia (EQUIPO PATRÓN)	Medición Promedio (EQUIPO BAJO PRUEBA)	ERROR	Incertidumbre Expandida	Unidad de la Medición
30	34,00	4,00	$\pm 0,82$	mmHg
50	53,00	3,00	$\pm 0,82$	
80	81,50	1,50	$\pm 1,01$	

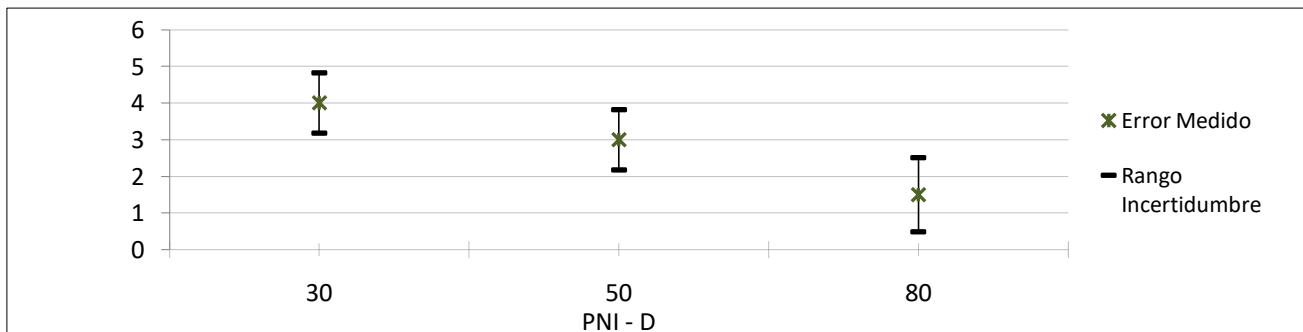


TEMPERATURA

Valor de Referencia (EQUIPO PATRÓN)	Medición Promedio (EQUIPO BAJO PRUEBA)	ERROR		Incertidumbre Expandida	Unidad de la Medición
36,0	36,00	0,00	±	0,09	°C
38,0	38,10	0,10	±	0,09	

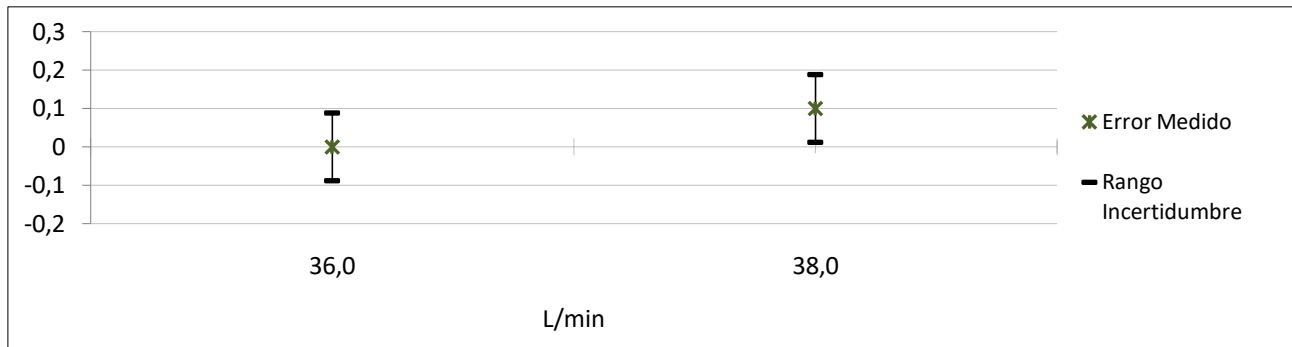

SATURACIÓN DE OXÍGENO

Valor de Referencia (EQUIPO PATRÓN)	Medición Promedio (EQUIPO BAJO PRUEBA)	ERROR		Incertidumbre Expandida	Unidad de la Medición
75	74,50	-0,50	±	2,35	%
85	85,00	0,00	±	2,27	
95	95,50	0,50	±	2,35	

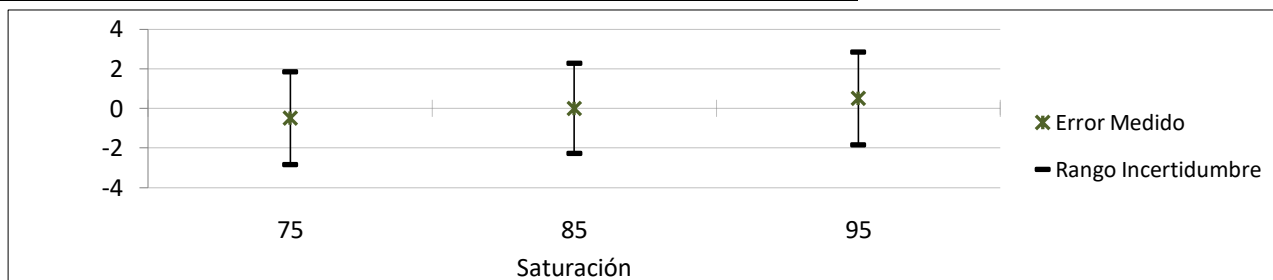


FRECUENCIA CARDIACA SPO2

Valor de Referencia (EQUIPO PATRÓN)	Medición Promedio (EQUIPO BAJO PRUEBA)	ERROR		Incertidumbre Expandida	Unidad de la Medición
60	60,00	0,00	±	0,88	BPM
150	150,00	0,00	±	0,88	

FRECUENCIA CARDIACA

Valor de Referencia (EQUIPO PATRÓN)	Medición Promedio (EQUIPO BAJO PRUEBA)	ERROR		Incertidumbre Expandida	Unidad de la Medición
60	60,00	0,00	±	0,82	BPM
120	120,00	0,00	±	0,82	
200	200,00	0,00	±	0,82	

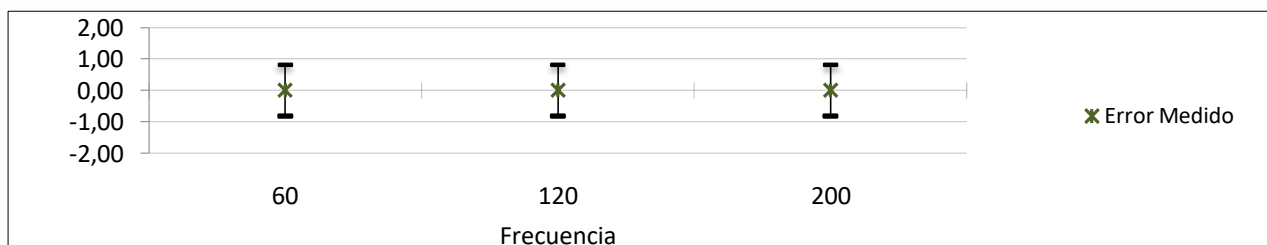

PRESIÓN INVASIVA SISTÓLICA IBP1

Valor de Referencia (EQUIPO PATRÓN)	Medición Promedio (EQUIPO BAJO PRUEBA)	ERROR	Incertidumbre Expandida	
50	49,00	-1,00	±	0,74
80	79,00	-1,00	±	0,85
110	109,00	-1,00	±	1,10

Unidad de la Medición
mmHg

PRESIÓN INVASIVA DIASTÓLICA IBP1

Valor de Referencia (EQUIPO PATRÓN)	Medición Promedio (EQUIPO BAJO PRUEBA)	ERROR	Incertidumbre Expandida	
20	20,00	0,00	±	0,65
40	39,00	-1,00	±	0,74
70	69,00	-1,00	±	0,91

Unidad de la Medición
mmHg

ARTERIA PULMONAR (AP) IBP1

Valor de Referencia (EQUIPO PATRÓN)	Medición Promedio (EQUIPO BAJO PRUEBA)	ERROR	Incertidumbre Expandida	
25	24,00	-1,00	±	0,62
10	10,00	0,00	±	0,62

Unidad de la Medición
mmHg

FIN DEL CERTIFICADO