

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
CALIBRATION CERTIFICATE

Certificado N° M1161025

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: Device	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MARCA: Brand	NIHON KOHDEN
MODELO: Model	BSM-2303K	SERIE: Serial	01203
Inventario Institución: Institute Inventory	518909	Ubicación: Location	URGENCIAS PEDIATRÍA

PATRONES UTILIZADOS

Equipo	Marca	Modelo	Serie	Fecha de calibración
Simulador de Signos Vitales	Fluke Biomedical	ProSim 8	2267045	2025-09-29

CONDICIONES DE LA MEDICIÓN

Fecha Recepción: Date of Receipt	2025-10-14	Fecha Calibración: Date of Calibration	2025-10-14
TEMPERATURA Inicial: Temperature	22 °C	Final: End	22 °C
HUMEDAD Rel. Inicial: Humidity	59 %	Final: End	59 %
Lugar de Calibración: Place of Calibration	HOSPITAL SAN JORGE		

DATOS DE LA INSTITUCIÓN

INSTITUCIÓN: HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE Institution	
TELÉFONO: (606)3119058 Telephone	CIUDAD: PEREIRA City
DIRECCIÓN: CRA 4 # 24-88 Address	Correo: coordinacion.biomedicos@husj.gov.co E-mail

COD: PS-FO002 - VERSION 01 (3V)

Elaboró


JORGE CARDONA IDARRAGA
Metrólogo
Metrologist

Revisó


MARTÍN LÓPEZ BALLESTEROS
Coordinador de Prestación de Servicios
Service Delivery Coordinator

NOTAS ACLARATORIAS

Este certificado no podrá ser reproducido total o parcialmente excepto cuando se haya obtenido permiso por escrito de Coodesuris
 This certificate must not be partially or totally reproduced, except with Coodesuris permission.

Los resultados contenidos en el presente certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones.
 The results of this certificate refer to the moment and condition in which the measurements were made.

El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos calibrados.
 The issuing laboratory assumes no responsibility to the misuse of the calibrated instruments.

El usuario es responsable de la recalibración de sus instrumentos a intervalos apropiados
 The user is responsible for having his instruments calibrated at appropriate intervals.


La calibración se realiza por el método de comparación con un patrón de referencia
 Calibration is performed by the method of comparison with a reference pattern

La incertidumbre de calibración ha sido estimada con un nivel de confianza del 95% utilizando un factor de cobertura $k=2$
 The calibration uncertainty has been estimated with a confidence level of 95% using a coverage factor $k = 2$

RESULTADOS DE LA MEDICIÓN

PRESIÓN NO INVASIVA SISTÓLICA

Valor de Referencia (EQUIPO PATRÓN)	Medición Promedio (EQUIPO BAJO PRUEBA)	ERROR	Incertidumbre Expandida	Unidad de la Medición
80	81,75	1,75	$\pm$ 0,96	mmHg
120	122,25	2,25	$\pm$ 0,96	
200	199,25	-0,75	$\pm$ 0,96	

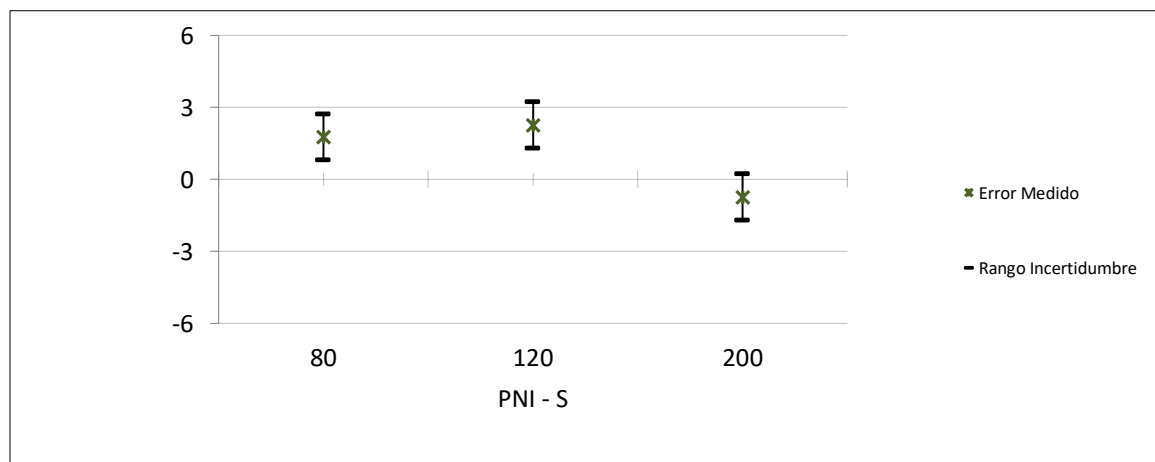


PRESIÓN NO INVASIVA DIASTÓLICA

Valor de Referencia (EQUIPO PATRÓN)	Medición Promedio (EQUIPO BAJO PRUEBA)	ERROR	Incertidumbre Expandida	
50	51,75	1,75	±	0,96
80	80,75	0,75	±	0,96
150	148,75	-1,25	±	0,96

Unidad de la
Medición

mmHg

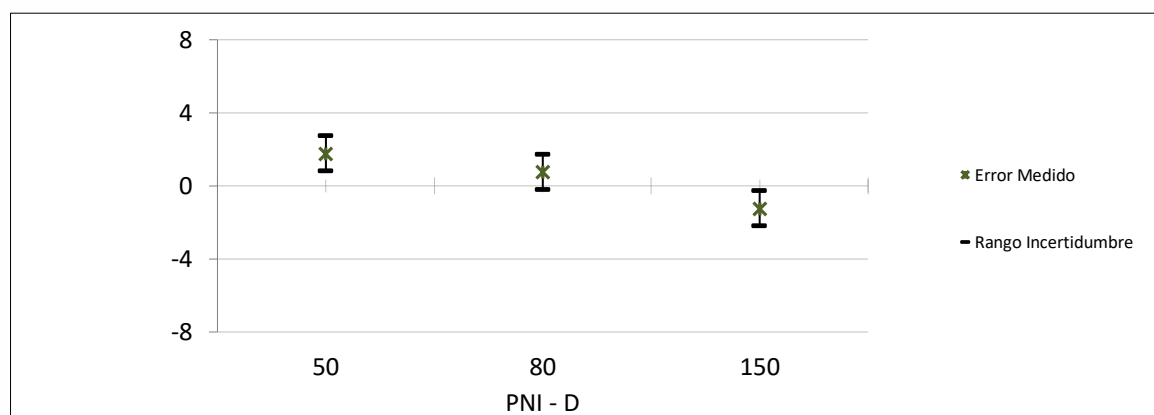


FRECUENCIA CARDIACA

Valor de Referencia (EQUIPO PATRÓN)	Medición Promedio (EQUIPO BAJO PRUEBA)	ERROR	Incertidumbre Expandida	
60	60,00	0,00	±	0,82
120	120,00	0,00	±	0,82
200	200,00	0,00	±	0,82

Unidad de la
Medición


BPM

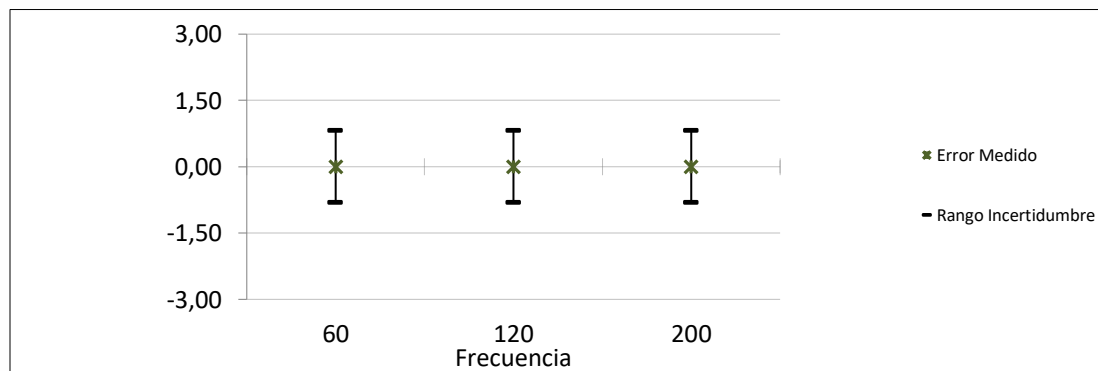

SATURACIÓN DE OXÍGENO

Valor de Referencia (EQUIPO PATRÓN)	Medición Promedio (EQUIPO BAJO PRUEBA)	ERROR	Incertidumbre Expandida	
75	75,00	0,00	±	2,27
85	85,00	0,00	±	2,27
95	95,00	0,00	±	2,27

Unidad de la Medición
%

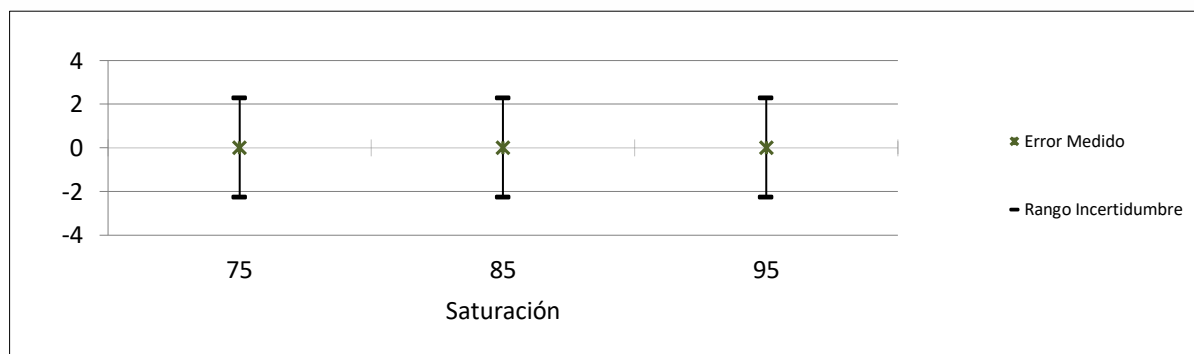

FRECUENCIA CARDIACA SP02	Valor de Referencia	Medición Promedio	ERROR	Incertidumbre Expandida	
	60	60,00	0,00	±	0,88
	150	150,00	0,00	±	0,88

Unidad de la Medición
BPM

FIN DEL CERTIFICADO