

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

CALIBRATION CERTIFICATE

Certificado N° J1601125

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO:	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MARCA:	PENLON
Device		Brand	
MODELO:	PM 8000 EXPRESS	SERIE:	AA68C22551
Model		Serial	
Inventario Institución:	541627	Ubicación:	RECUPERACIÓN
Institute Inventory		Location	

PATRONES UTILIZADOS

Equipo	Marca	Modelo	Serie	Fecha de calibración
Simulador de Signos Vitales	Fluke Biomedical	ProSim 8	2267045	2025-09-29

CONDICIONES DE LA MEDICIÓN

Fecha Recepción:	2025-11-21	Fecha Calibración:	2025-11-21
Date of Receipt		Date of Calibration	
TEMPERATURA Inicial:	24,1 °C	Final:	24,1 °C
Temperature		End	
HUMEDAD Rel. Inicial:	61 %	Final:	61 %
Humidity		End	
Lugar de Calibración:	HOSPITAL SAN JORGE		
Place of Calibration			

DATOS DE LA INSTITUCIÓN

INSTITUCIÓN: HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE	
Institution	
TELÉFONO: (606)3119058	CIUDAD: PEREIRA
Telephone	City
DIRECCIÓN: CRA 4 # 24-88	Correo: coordinacion.biomedicos@husj.gov.co
Address	E-mail

COD: PS-FO002 - VERSION 01 (3V)

Elaboró

Revisó


JORGE CARDONA IDARRAGA
Metrólogo
Metrologist


MARTÍN LÓPEZ BALLESTEROS
Coordinador de Prestación de Servicios
Service Delivery Coordinator

NOTAS ACLARATORIAS

Este certificado no podrá ser reproducido total o parcialmente excepto cuando se haya obtenido permiso por escrito de Coodesuris
This certificate must not be partially or totally reproduced, except with Coodesuris permission.

Los resultados contenidos en el presente certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones.
The results of this certificate refer to the moment and condition in which the measurements were made.

El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos calibrados.
The issuing laboratory assumes no responsibility to the misuse of the calibrated instruments.

El usuario es responsable de la recalibración de sus instrumentos a intervalos apropiados
The user is responsible for having his instruments calibrated at appropriate intervals.


La calibración se realiza por el método de comparación con un patrón de referencia
Calibration is performed by the method of comparison with a reference pattern

La incertidumbre de calibración ha sido estimada con un nivel de confianza del 95% utilizando un factor de cobertura $k=2$
The calibration uncertainty has been estimated with a confidence level of 95% using a coverage factor $k = 2$

RESULTADOS DE LA MEDICIÓN

PRESIÓN NO INVASIVA SISTÓLICA

Valor de Referencia (EQUIPO PATRÓN)	Medición Promedio (EQUIPO BAJO PRUEBA)	ERROR	Incertidumbre Expandida	Unidad de la Medición
80	81,50	1,50	$\pm$ 1,01	mmHg
120	118,50	-1,50	$\pm$ 1,01	
200	205,50	5,50	$\pm$ 1,01	

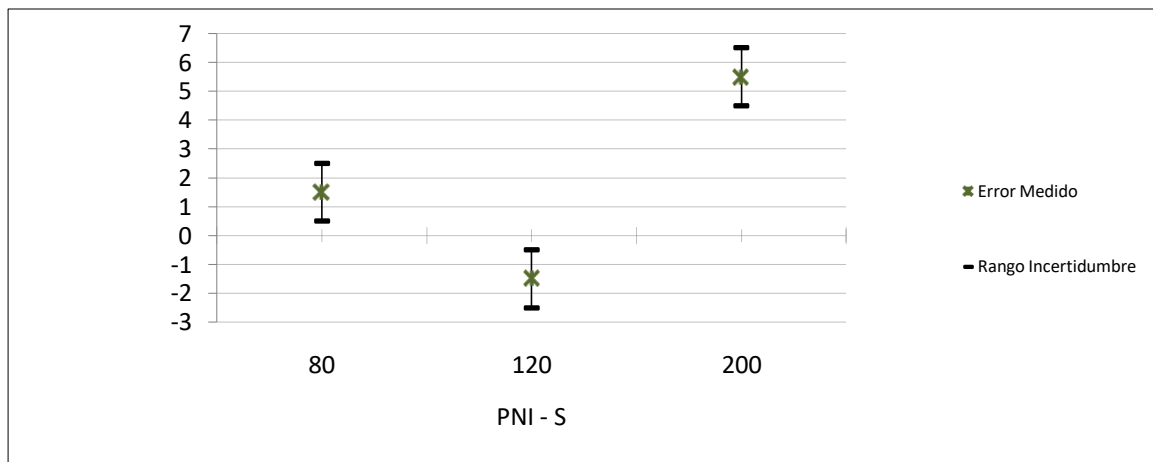


PRESIÓN NO INVASIVA DIASTÓLICA

Valor de Referencia (EQUIPO PATRÓN)	Medición Promedio (EQUIPO BAJO PRUEBA)	ERROR	Incertidumbre Expandida	
50	52,50	2,50	±	1,01
80	82,50	2,50	±	1,01
150	153,50	3,50	±	1,01

Unidad de la
Medición

mmHg

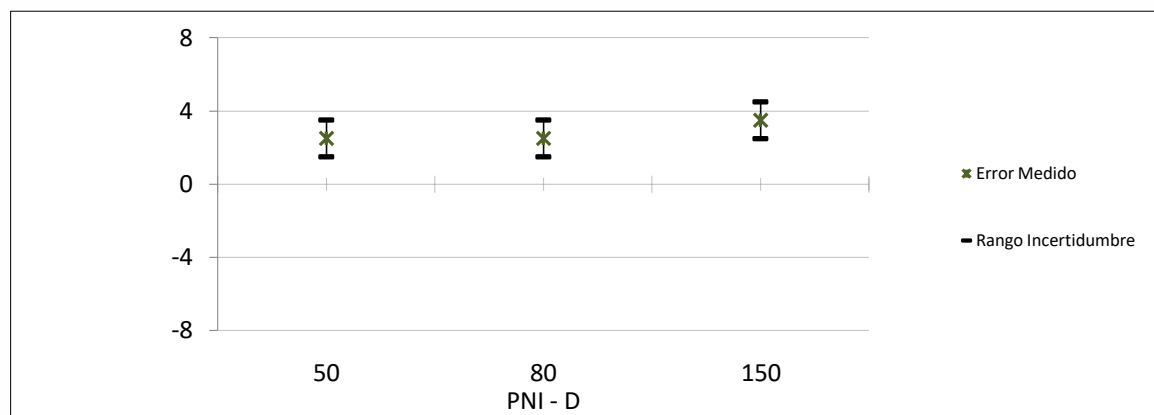


FRECUENCIA CARDIACA

Valor de Referencia (EQUIPO PATRÓN)	Medición Promedio (EQUIPO BAJO PRUEBA)	ERROR	Incertidumbre Expandida	
60	60,00	0,00	±	0,82
120	120,00	0,00	±	0,82
200	200,00	0,00	±	0,82

Unidad de la
Medición


BPM

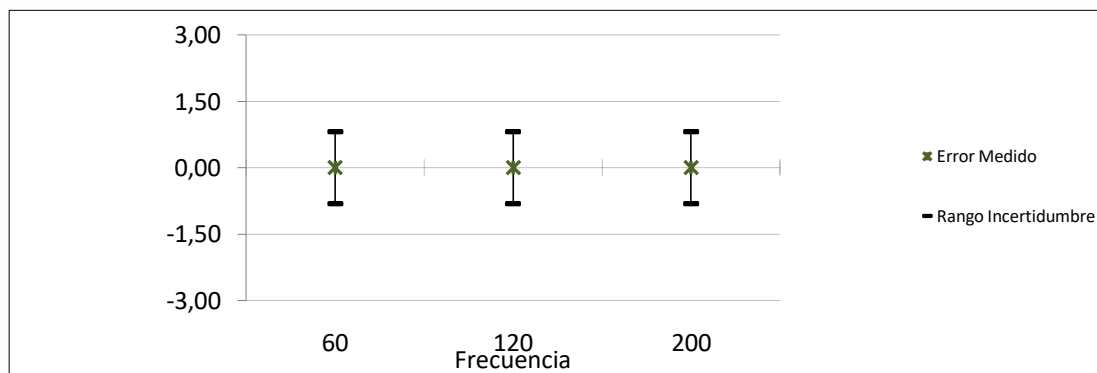

SATURACIÓN DE OXÍGENO

Valor de Referencia (EQUIPO PATRÓN)	Medición Promedio (EQUIPO BAJO PRUEBA)	ERROR	Incertidumbre Expandida	
75	74,25	-0,75	±	2,33
85	85,00	0,00	±	2,27
95	96,00	1,00	±	2,27

Unidad de la Medición
%

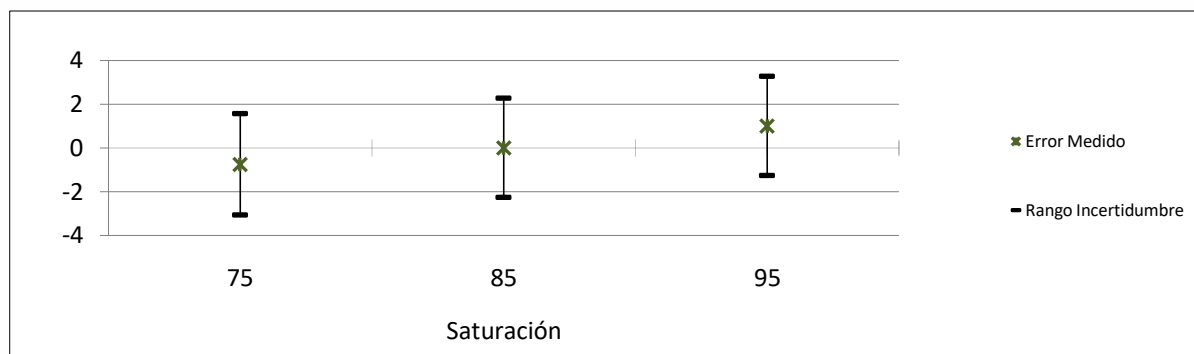

FRECUENCIA CARDIACA SP02	Valor de Referencia	Medición Promedio	ERROR	Incertidumbre Expandida	
	60	60,00	0,00	±	0,88
	150	149,00	-1,00	±	0,88

Unidad de la Medición
BPM

FIN DEL CERTIFICADO