

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
CALIBRATION CERTIFICATE

Certificado N°

M3531125

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES

Device

MARCA: EDAN

Brand

MODELO: IM70

Model

SERIE: 360080-M20912910029

Serial

Inventario Institución: 572684

Institute Inventory

PATRONES UTILIZADOS

Equipo	Marca	Modelo	Serie	Fecha de calibración
Simulador de Signos Vitales	Fluke Biomedical	ProSim 8	2267045	2025-09-29

CONDICIONES DE LA MEDICIÓN

Fecha Recepción: 2025-11-25

Date of Receipt

Fecha Calibración: 2025-11-25

Date of Calibration

TEMPERATURA Inicial: 21 °C **Final:** 21 °C

Temperature

End

HUMEDAD Rel. Inicial: 59 % **Final:** 59 %

Humidity

End

Lugar de Calibración: URGENCIAS

Place of Calibration

DATOS DE LA INSTITUCIÓN

INSTITUCIÓN: HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE

Institution

TELÉFONO: 3 119058

Telephone

CIUDAD: PEREIRA - RISARALDA

City

DIRECCIÓN: CRA 4#24-88

Address

Correo: biomedicos@husj.gov.co

E-mail

COD: PS-FO002 - VERSION 01

Elaboró

Revisó



JORGE CARDONA IDARRAGA

Metrólogo

Metrologist



MARTÍN LÓPEZ BALLESTEROS

Coordinador de Prestación de Servicios

Service Delivery Coordinator

NOTAS ACLARATORIAS

Este certificado no podrá ser reproducido total o parcialmente excepto cuando se haya obtenido permiso por escrito de Coodesuris

This certificate must not be partially or totally reproduced, except with Coodesuris permission.

Los resultados contenidos en el presente certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones.

The results of this certificate refer to the moment and condition in which the measurements were made.

El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos calibrados.

The issuing laboratory assumes no responsibility to the misuse of the calibrated instruments.

El usuario es responsable de la recalibración de sus instrumentos a intervalos apropiados

The user is responsible for having his instruments calibrated at appropriate intervals.

La calibración se realiza por el método de comparación con un patrón de referencia

Calibration is performed by the method of comparison with a reference pattern

La incertidumbre de calibración ha sido estimada con un nivel de confianza del 95% utilizando un factor de cobertura $k=2$

The calibration uncertainty has been estimated with a confidence level of 95% using a coverage factor $k = 2$


RESULTADOS DE LA MEDICIÓN

PRESIÓN NO INVASIVA SISTÓLICA

Valor de Referencia (EQUIPO PATRÓN)	Medición Promedio (EQUIPO BAJO PRUEBA)	ERROR		Incertidumbre Expandida	
80	82.00	2.00	±	0.82	
120	122.00	2.00	±	0.82	
200	201.75	1.75	±	0.96	

Unidad de la
Medición


mmHg

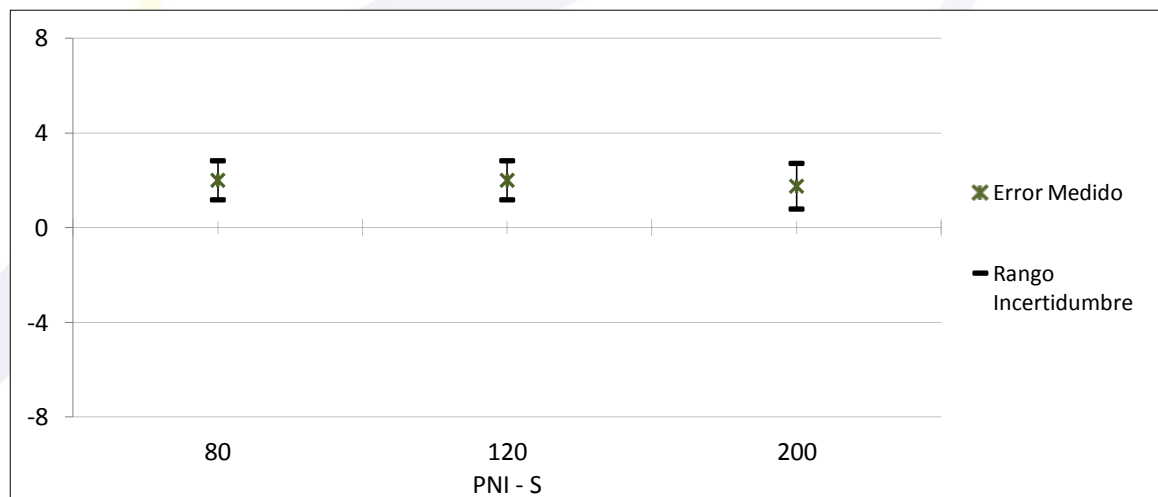

PRESIÓN NO INVASIVA DIASTÓLICA

Valor de Referencia (EQUIPO PATRÓN)	Medición Promedio (EQUIPO BAJO PRUEBA)	ERROR	Incertidumbre Expandida
50	54.00	4.00	$\pm$ 0.82
80	81.50	1.50	$\pm$ 1.30
150	151.00	1.00	$\pm$ 0.82


Unidad de la Medición
mmHg

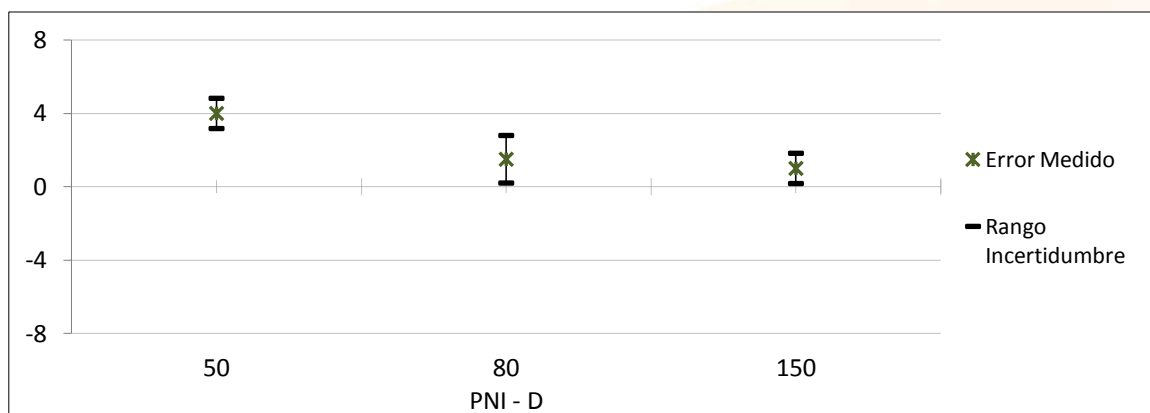

FRECUENCIA CARDIACA

Valor de Referencia (EQUIPO PATRÓN)	Medición Promedio (EQUIPO BAJO PRUEBA)	ERROR	Incertidumbre Expandida
60	60.00	0.00	$\pm$ 0.82
120	120.00	0.00	$\pm$ 0.82
200	200.00	0.00	$\pm$ 0.82


Unidad de la Medición
BPM

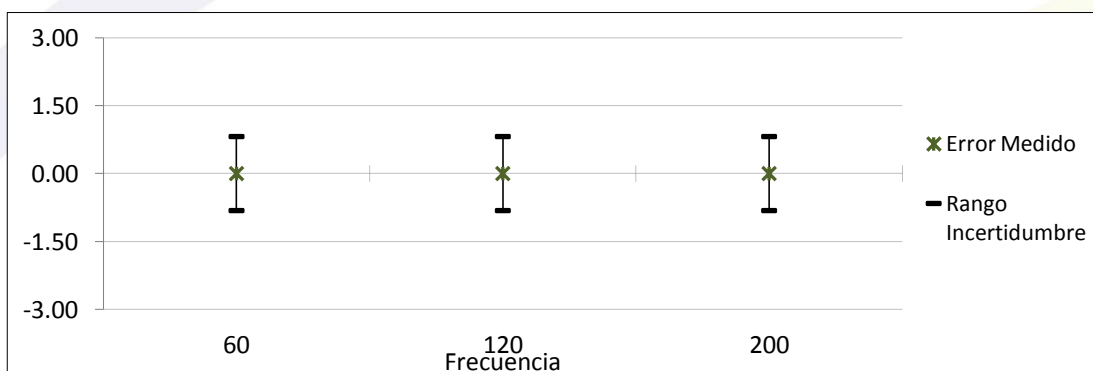

SATURACIÓN DE OXÍGENO

Valor de Referencia (EQUIPO PATRÓN)	Medición Promedio (EQUIPO BAJO PRUEBA)	ERROR	Incertidumbre Expandida	
75	75.00	0.00	±	2.27
85	86.00	1.00	±	2.27
95	95.75	0.75	±	2.33

Unidad de la Medición
%

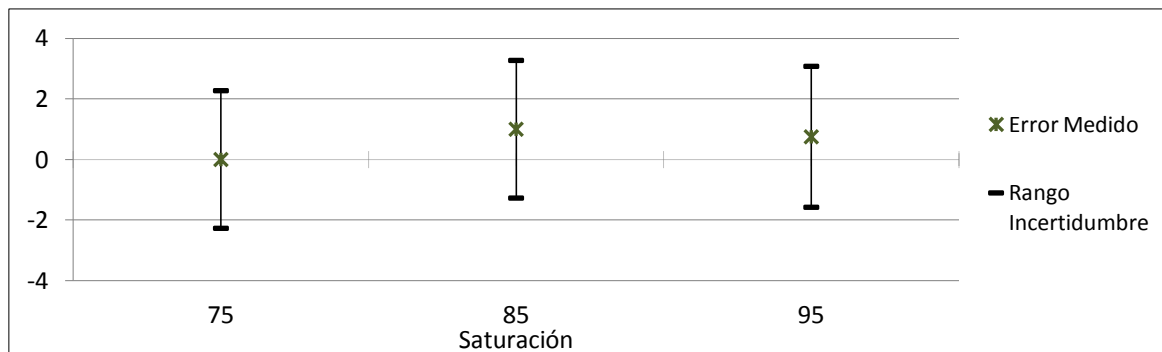

FRECUENCIA CARDIACA SP02	Valor de Referencia	Medición Promedio	ERROR	Incertidumbre Expandida	
	60	60.00	0.00	±	0.88
	150	149.00	-1.00	±	0.88

Unidad de la Medición
BPM

FIN DEL CERTIFICADO