

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

CALIBRATION CERTIFICATE

Certificado N°

L1541125

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: MONITOR FETAL

Device

MARCA: PHILIPS

Brand

MODELO: AVALON FM20

Model

SERIE: DE53014587

Serial

Inventario Institución: 544929

Institute Inventory

UBICACIÓN: UNIDAD DE CUIDADO OBSTETRICO

Location

PATRONES UTILIZADOS

Equipo	Marca	Modelo	Serie	Fecha de calibración
JUEGO DE MASAS	SET & GAD	M-CILINDRICA	101...106	2024-12-30
SIMULADOR FETAL	FLUKE BIOMEDICAL	PS 320	2270094	2025-10-21

CONDICIONES DE LA MEDICIÓN

Fecha Recepción: 2025-11-12

Date of Receipt

Fecha Calibración: 2025-11-12

Date of Calibration

TEMPERATURA Inicial: 22 °C **Final:** 22 °C

Temperature

End

HUMEDAD Rel. Inicial: 56 % **Final:** 58 %

Humidity

End

Lugar de Calibración: UNIDAD DE CUIDADO OBSTETRICO

Place of Calibration

DATOS DE LA INSTITUCIÓN

INSTITUCIÓN: Hospital universitario San Jorge de pereira

Institution

TELÉFONO: 6063119058

Telephone

CIUDAD: PEREIRA

City

DIRECCIÓN: cra 4 #24-88

Address

Correo: rutahospitalaria@husj.gov.co

E-mail

COD: PS-FO002 - VERSION 01

Elaboró

Revisó

Leire Garcia

LEIRE GARCIA MORALES

Metrologa

Metrologist

MARTÍN LÓPEZ BALLESTEROS

Coordinador de Prestación de Servicios

Service Delivery Coordinator



NOTAS ACLARATORIAS

Este certificado no podrá ser reproducido total o parcialmente excepto cuando se haya obtenido permiso por escrito de Coodesuris
This certificate must not be partially or totally reproduced, except with Coodesuris permission.

Los resultados contenidos en el presente certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones.
The results of this certificate refer to the moment and condition in which the measurements were made.

El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos calibrados.
The issuing laboratory assumes no responsibility to the misuse of the calibrated instruments.

El usuario es responsable de la recalibración de sus instrumentos a intervalos apropiados.
The user is responsible for having his instruments calibrated at appropriate intervals.

La calibración se realiza por el método de comparación con un patrón de referencia
Calibration is performed by the method of comparison with a reference pattern

La incertidumbre de calibración ha sido estimada con un nivel de confianza del 95% utilizando un factor de cobertura $k=2$
The calibration uncertainty has been estimated with a confidence level of 95% using a coverage factor $k = 2$

RESULTADOS DE LA MEDICIÓN

CONTRACCIÓN UTERINA


Peso utilizado (g)	Medición Promedio (EQUIPO BAJO PRUEBA)	ERROR ALEATORIO (Max-Min)	Incertidumbre Expandida	
30	32.5	1.0	±	0.96
70	48.5	5.0	±	1.75
100	59.8	1.0	±	0.94
120	69.0	6.0	±	1.78
150	76.8	2.0	±	1.07
180	88.0	4.0	±	1.71

Unidad de la Medición
%

FETOCARDIA

Valor de Referencia (EQUIPO PATRÓN)	Medición Promedio (EQUIPO BAJO PRUEBA)	ERROR	Incertidumbre Expandida	
90	90.0	0.0	±	0.82
150	150.5	0.5	±	1.00
210	209.0	-1.0	±	0.82

Unidad de la Medición
BPM

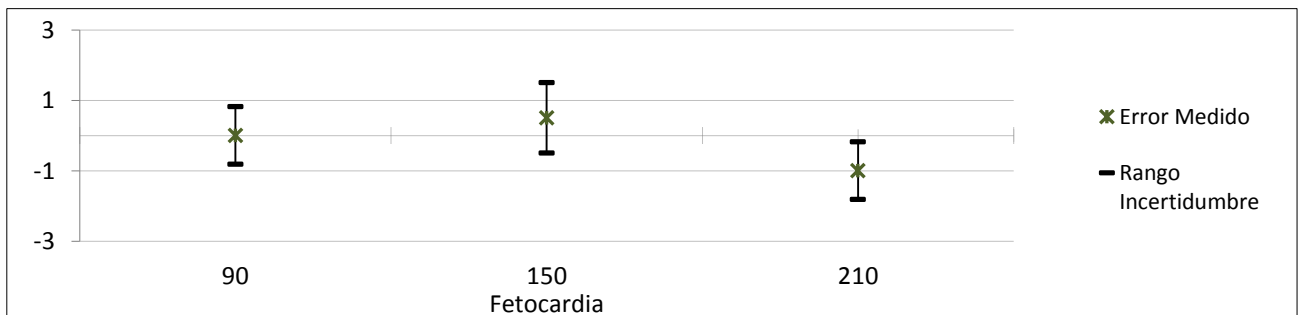

FIN DEL CERTIFICADO