

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

CALIBRATION CERTIFICATE

Certificado N° L2091125

DATOS DEL EQUIPO				
EQUIPO:	PULSOXIMETRO	MARCA:	choiceMMed	
Device		Brand		
MODELO:	MDC300C29	SERIE:	202769926452	
Model		Serial		
Inventario Institución:	2021-59	UBICACIÓN:	FISIOTERAPIA	
Institute Inventory		Location		

PATRONES UTILIZADOS				
Equipo	Marca	Modelo	Serie	Fecha de calibración
Simulador de Signos Vitales	Fluke Biomedical	ProSim 8	2267045	2025-09-29

CONDICIONES DE LA MEDICIÓN				
Fecha Recepción:	2025-11-20	Fecha Calibración:	2025-11-20	
Date of Receipt		Date of Calibration		
TEMPERATURA Inicial:	24,2 °C	Final:	24,2 °C	
Temperature		End		
HUMEDAD Rel. Inicial:	61 %	Final:	61 %	
Humidity		End		
Lugar de Calibración:	HOSPITAL SAN JORGE			
Place of Calibration				

DATOS DE LA INSTITUCIÓN	
INSTITUCIÓN:	Hospital universitario San Jorge de pereira
Institution	
TELÉFONO:	6063119058
Telephone	
DIRECCIÓN:	cra 4 #24-88
Address	
CIUDAD:	PEREIRA
City	
Correo:	rutahospitalaria@husj.gov.co
E-mail	

COD: PS-FO002 - VERSION 01

Elaboró

Revisó

Leire Garcia

LEIRE GARCIA MORALES

Metrologa

Metrologist



Av 30 de Agosto Nro 87- 298



prestacionservicios@coodesuris.com



(6) 35154 66

MARTÍN LÓPEZ BALLESTEROS

Coordinador de Prestación de Servicios

Service Delivery Coordinator

NOTAS ACLARATORIAS

Este certificado no podrá ser reproducido total o parcialmente excepto cuando se haya obtenido permiso por escrito de Coodesuris

This certificate must not be partially or totally reproduced, except with Coodesuris permission.

Los resultados contenidos en el presente certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones.

The results of this certificate refer to the moment and condition in which the measurements were made.

El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos calibrados.

The issuing laboratory assumes no responsibility to the misuse of the calibrated instruments.

El usuario es responsable de la recalibración de sus instrumentos a intervalos apropiados

The user is responsible for having his instruments calibrated at appropriate intervals.

La calibración se realiza por el método de comparación con un patrón de referencia

Calibration is performed by the method of comparison with a reference pattern


La incertidumbre de calibración ha sido estimada con un nivel de confianza del 95% utilizando un factor de cobertura $k=2$

The calibration uncertainty has been estimated with a confidence level of 95% using a coverage factor $k = 2$

RESULTADOS DE LA MEDICIÓN

SATURACIÓN DE OXÍGENO

Valor de Referencia (Equipo Patrón)	Medición Promedio (Equipo Bajo Prueba)	ERROR	Incertidumbre Expandida	Unidad de la Medición
75	74.0	-1.0	± 2.27	%
85	86.0	1.0	± 2.27	
95	95.0	0.0	± 2.27	

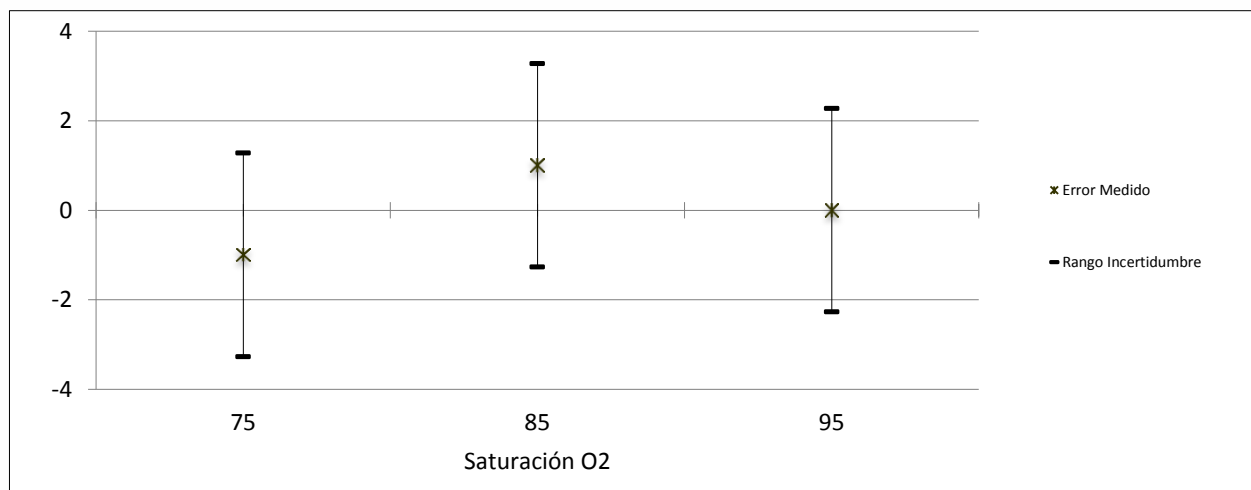

Av 30 de Agosto Nro 87- 298



prestacionservicios@coodesuris.com




(6) 35154 66

FRECUENCIA CARDIACA

Valor de Referencia (Equipo Patrón)	Medición Promedio (Equipo Bajo Prueba)	ERROR		Incertidumbre Expandida
60	60.0	0.0	±	0.88
120	120.0	0.0	±	0.88
180	180.0	0.0	±	0.88

Unidad de la Medición
Pulse/min

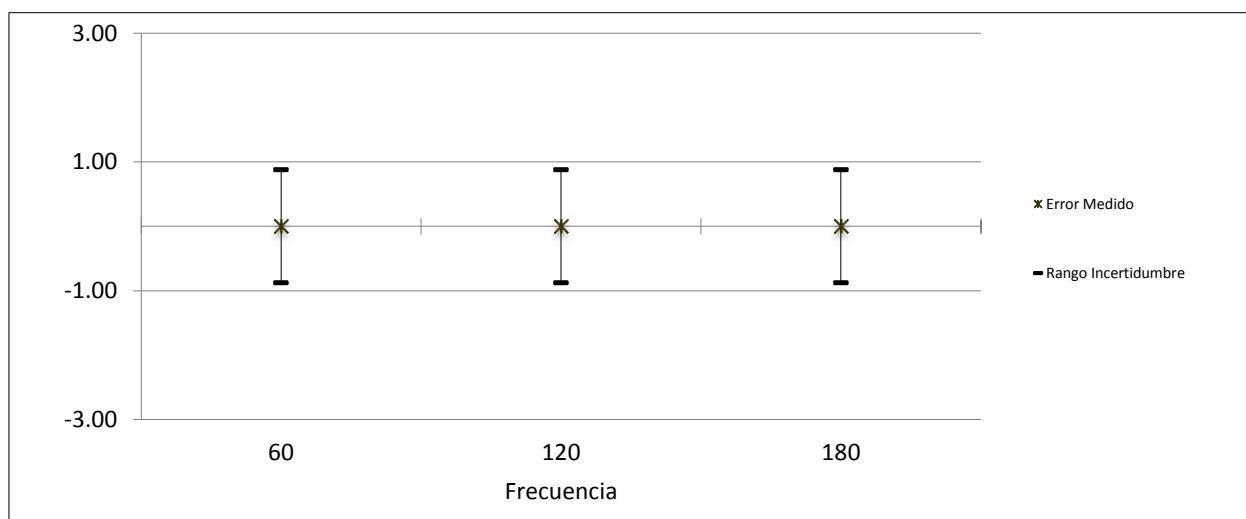

FIN DEL CERTIFICADO



Av 30 de Agosto Nro 87- 298



prestacionservicios@coodesuris.com



(6) 35154 66