

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

CALIBRATION CERTIFICATE

Certificado N° L2571125

DATOS DEL EQUIPO				
EQUIPO: Device	PULSOXIMETRO	MARCA: Brand	choiceMMed	
MODELO: Model	MDC300C29	SERIE: Serial	202769926460	
Inventario Institución: Institute Inventory	2021-51	UBICACIÓN: Location	FISIOTERAPIA	

PATRONES UTILIZADOS				
Equipo	Marca	Modelo	Serie	Fecha de calibración
Simulador de Signos Vitales	Fluke Biomedical	ProSim 8	2267045	2025-09-29

CONDICIONES DE LA MEDICIÓN				
Fecha Recepción: Date of Receipt	2025-11-20		Fecha Calibración: Date of Calibration	2025-11-20
TEMPERATURA Inicial: Temperature	24,2 °C	Final: End	HUMEDAD Rel. Inicial: Humidity	61 %
Lugar de Calibración: Place of Calibration	HOSPITAL SAN JORGE		Final: End	61 %

DATOS DE LA INSTITUCIÓN				
INSTITUCIÓN: Institution	Hospital universitario San Jorge de pereira			
TELÉFONO: Telephone	6063119058	CIUDAD: City	PEREIRA	
DIRECCIÓN: Address	cra 4 #24-88	Correo: E-mail	rutahospitalaria@husj.gov.co	

COD: PS-FO002 - VERSION 01

Elaboró

Leire Garcia

LEIRE GARCIA MORALES

Metrologa

Metrologist



Av 30 de Agosto Nro 87- 298



prestacionservicios@coodesuris.com



(6) 35154 66

Revisó

MARTÍN LÓPEZ BALLESTEROS

Coordinador de Prestación de Servicios

Service Delivery Coordinator

NOTAS ACLARATORIAS

Este certificado no podrá ser reproducido total o parcialmente excepto cuando se haya obtenido permiso por escrito de Coodesuris

This certificate must not be partially or totally reproduced, except with Coodesuris permission.

Los resultados contenidos en el presente certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones.

The results of this certificate refer to the moment and condition in which the measurements were made.

El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos calibrados.

The issuing laboratory assumes no responsibility to the misuse of the calibrated instruments.

El usuario es responsable de la recalibración de sus instrumentos a intervalos apropiados

The user is responsible for having his instruments calibrated at appropriate intervals.

La calibración se realiza por el método de comparación con un patrón de referencia

Calibration is performed by the method of comparison with a reference pattern


La incertidumbre de calibración ha sido estimada con un nivel de confianza del 95% utilizando un factor de cobertura $k=2$

The calibration uncertainty has been estimated with a confidence level of 95% using a coverage factor $k = 2$

RESULTADOS DE LA MEDICIÓN

SATURACIÓN DE OXÍGENO

Valor de Referencia (Equipo Patrón)	Medición Promedio (Equipo Bajo Prueba)	ERROR	Incertidumbre Expandida	Unidad de la Medición
75	74.0	-1.0	± 2.27	%
85	86.0	1.0	± 2.27	
95	95.0	0.0	± 2.27	

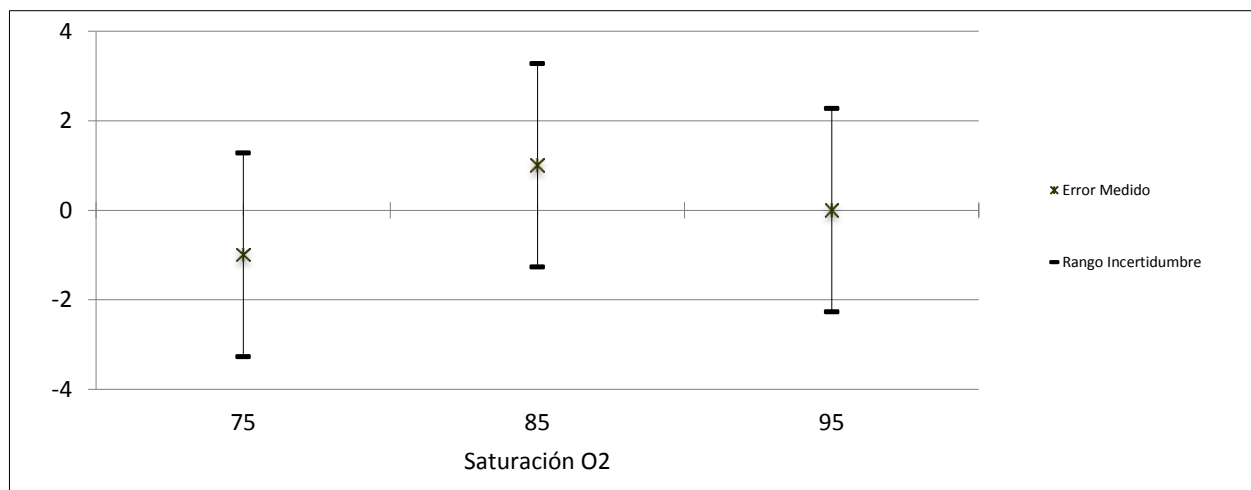

Av 30 de Agosto Nro 87- 298



prestacionservicios@coodesuris.com




(6) 35154 66

FRECUENCIA CARDIACA

Valor de Referencia (Equipo Patrón)	Medición Promedio (Equipo Bajo Prueba)	ERROR		Incertidumbre Expandida
60	60.0	0.0	±	0.88
120	120.0	0.0	±	0.88
180	180.0	0.0	±	0.88

Unidad de la Medición
Pulse/min

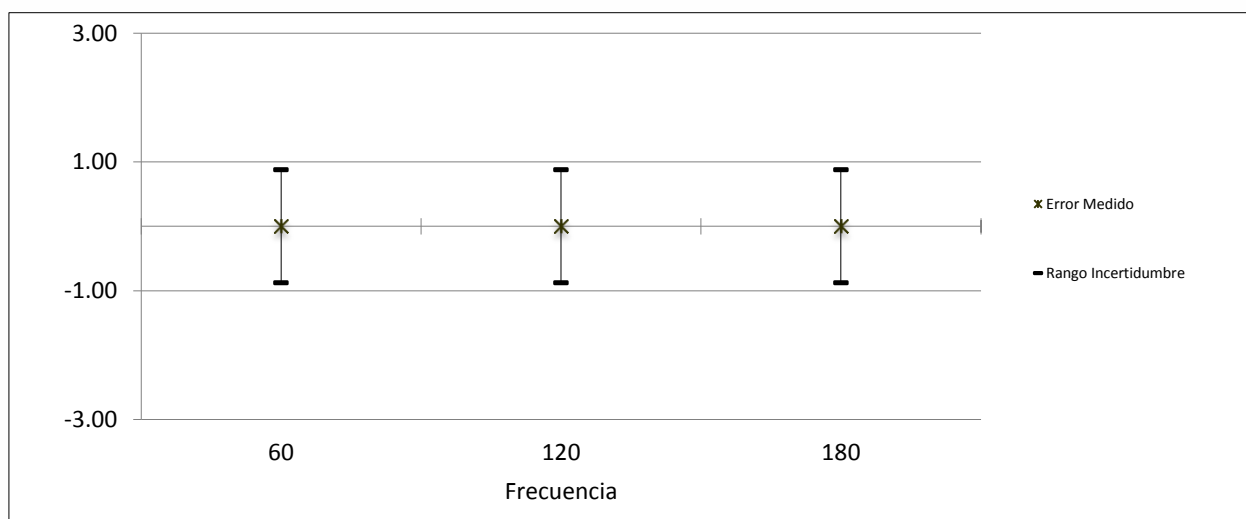

FIN DEL CERTIFICADO



Av 30 de Agosto Nro 87- 298



prestacionservicios@coodesuris.com



(6) 35154 66