

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
CALIBRATION CERTIFICATE

Certificado N° M0171025

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: FLUJÓMETRO
Device

MARCA: MEDILINE
Brand

MODELO: NO DEFINIDO
Model

SERIE: NO DEFINIDO
Serial

Inventario Institución: 546326
Institute Inventory

UBICACIÓN: URGENCIAS
Location:

PATRONES UTILIZADOS

Equipo	Marca	Modelo	Serie	Fecha de calibración
ANALIZADOR DE FLUJO DE GASES	FLUKE BIOMEDICAL	VT PLUS HF	147947	2025-01-07

CONDICIONES DE LA MEDICIÓN

Fecha Recepción: 2025-10-06
Date of Receipt

Fecha Calibración: 2025-10-06
Date of Calibration

TEMPERATURA Inicial: 26 °C **Final:** 26 °C
Temperature End

HUMEDAD Rel. Inicial: 62 % **Final:** 62 %
Humidity End

Lugar de Calibración: HOSPITAL SAN JORGE
Place of Calibration

DATOS DE LA INSTITUCIÓN

INSTITUCIÓN: HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE
Institution

TELÉFONO: (606)3119058
Telephone

CIUDAD: PEREIRA
City

DIRECCIÓN: CRA 4 # 24-88
Address

Correo: coordinacion.biomedicos@husj.gov.co
E-mail

COD: PS-FO002 - VERSION 01

Elaboró

Revisó



JORGE CARDONA IDARRAGA
Metrólogo
Metrologist



MARTÍN LÓPEZ BALLESTEROS
Coordinador de Prestación de Servicios
Service Delivery Coordinator

NOTAS ACLARATORIAS

Este certificado no podrá ser reproducido total o parcialmente excepto cuando se haya obtenido permiso por escrito de Coodesuris
This certificate must not be partially or totally reproduced, except with Coodesuris permission.

Los resultados contenidos en el presente certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones.
The results of this certificate refer to the moment and condition in which the measurements were made.

El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos calibrados.
The issuing laboratory assumes no responsibility to the misuse of the calibrated instruments.

El usuario es responsable de la recalibración de sus instrumentos a intervalos apropiados
The user is responsible for having his instruments calibrated at appropriate intervals.

La calibración se realiza por el método de comparación con un patrón de referencia
Calibration is performed by the method of comparison with a reference pattern


La incertidumbre de calibración ha sido estimada con un nivel de confianza del 95% utilizando un factor de cobertura $k=2$
The calibration uncertainty has been estimated with a confidence level of 95% using a coverage factor $k = 2$

RESULTADOS DE LA MEDICIÓN

FLUJO

Valor de Referencia (EQUIPO BAJO PRUEBA)	Medición Promedio (EQUIPO PATRÓN)	ERROR	Incertidumbre Expandida
1	1.39	0.39	$\pm$ 0.29
6	6.60	0.60	$\pm$ 0.29
12	13.00	1.00	$\pm$ 0.41

Unidad de la Medición
lpm

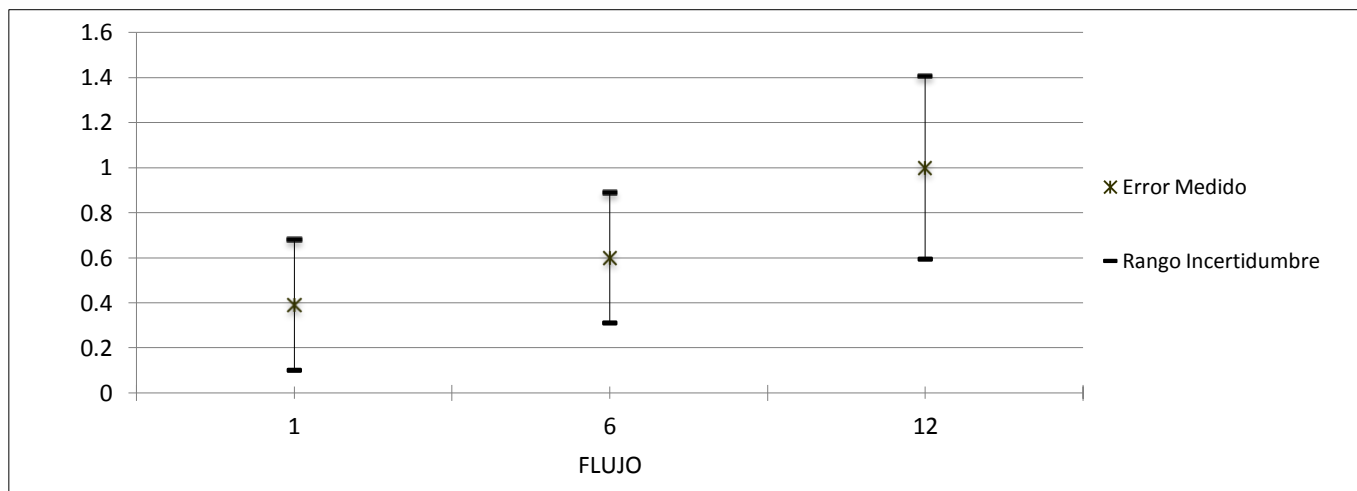

FIN DEL CERTIFICADO