

## CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

CALIBRATION CERTIFICATE

Certificado N°

M1830925

| DATOS DEL EQUIPO                                      |                 |                              |                           |  |
|-------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|---------------------------|--|
| <b>EQUIPO:</b><br>Device                              | TERMOHIGRÓMETRO | <b>MARCA:</b><br>Brand       | HTC                       |  |
| <b>MODELO:</b><br>Model                               | HTC-2           | <b>SERIE:</b><br>Serial      | 014                       |  |
| <b>Inventario Institución:</b><br>Institute Inventory | 548451          | <b>UBICACIÓN</b><br>Location | HOSPITALIZACIÓN PEDIATRÍA |  |

| PATRONES UTILIZADOS  |       |        |          |                      |
|----------------------|-------|--------|----------|----------------------|
| Equipo               | Marca | Modelo | Serie    | Fecha de calibración |
| TERMOHIGRÓMETRO      | FLUKE | 2626-S | B21815   | 2025-09-17           |
| SONDA DE TEMPERATURA | FLUKE | 179    | 18960429 | 2025-09-09           |

| CONDICIONES DE LA MEDICIÓN                           |                        |                                                  |            |  |
|------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------|------------|--|
| <b>Fecha Recepción:</b><br>Date of Receipt           | 2025-09-30             | <b>Fecha Calibración:</b><br>Date of Calibration | 2025-09-30 |  |
| <b>TEMPERATURA Inicial:</b><br>Temperature           | 20 °C                  | <b>Final:</b><br>End                             | 20 °C      |  |
| <b>HUMEDAD Rel. Inicial:</b><br>Humidity             | 61 %                   | <b>Final:</b><br>End                             | 61 %       |  |
| <b>Lugar de Calibración:</b><br>Place of Calibration | LABORATORIO COODESURIS |                                                  |            |  |

| DATOS DE LA INSTITUCIÓN            |                                  |                          |                                     |  |
|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--|
| <b>INSTITUCIÓN:</b><br>Institution | HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE |                          |                                     |  |
| <b>TELÉFONO:</b><br>Telephone      | (606)3119058                     | <b>CIUDAD:</b><br>City   | PEREIRA                             |  |
| <b>DIRECCIÓN:</b><br>Address       | CRA 4 # 24-88                    | <b>Correo:</b><br>E-mail | coordinacion.biomedicos@husj.gov.co |  |

COD: PS-F0002 - VERSION 01

Elaboró

Revisó

  
**JORGE CARDONA IDARRAGA**  
Metrologo  
Metrologist

  
**MARTÍN LÓPEZ BALLESTEROS**  
Coordinador de Prestación de Servicios  
Service Delivery Coordinator



Av 30 de Agosto Nro 87- 298



prestacionservicios@coodesuris.com



(6) 35154 66

## NOTAS ACLARATORIAS

Este certificado no podrá ser reproducido total o parcialmente excepto cuando se haya obtenido permiso por escrito de Coodesuris

This certificate must not be partially or totally reproduced, except with Coodesuris permission.

Los resultados contenidos en el presente certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones.

The results of this certificate refer to the moment and condition in which the measurements were made.

El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos calibrados.

The issuing laboratory assumes no responsibility to the misuse of the calibrated instruments.

El usuario es responsable de la recalibración de sus instrumentos a intervalos apropiados

The user is responsible for having his instruments calibrated at appropriate intervals.

La calibración se realiza por el método de comparación con un patrón de referencia

Calibration is performed by the method of comparison with a reference pattern


La incertidumbre de calibración ha sido estimada con un nivel de confianza del 95% utilizando un factor de cobertura k=2

The calibration uncertainty has been estimated with a confidence level of 95% using a coverage factor k = 2

## RESULTADOS DE LA MEDICIÓN


### TEMPERATURA

| Valor de Referencia<br>(Equipo Patrón) | Medición Promedio<br>(Equipo Bajo Prueba) | ERROR | Incertidumbre<br>Expandida |      | Unidad de la<br>Medición |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|-------|----------------------------|------|--------------------------|
| 20.36                                  | 20.19                                     | -0.17 | ±                          | 0.18 | °C                       |
| 28.65                                  | 28.75                                     | 0.10  | ±                          | 0.18 |                          |

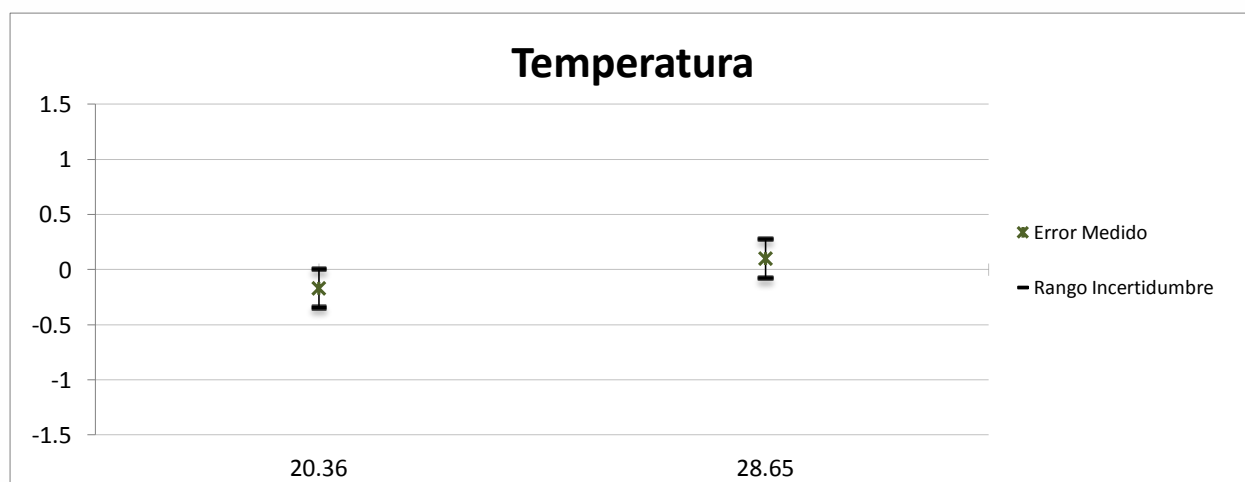


#### TEMPERATURA SONDA

| Valor de Referencia<br>(Equipo Patrón) | Medición Promedio<br>(Equipo Bajo Prueba) | ERROR | Incertidumbre<br>Expandida | Unidad de la<br>Medición |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|-------|----------------------------|--------------------------|
| 3.24                                   | 3.39                                      | 0.15  | ± 0.18                     | °C                       |
| 7.55                                   | 7.89                                      | 0.34  | ± 0.18                     |                          |

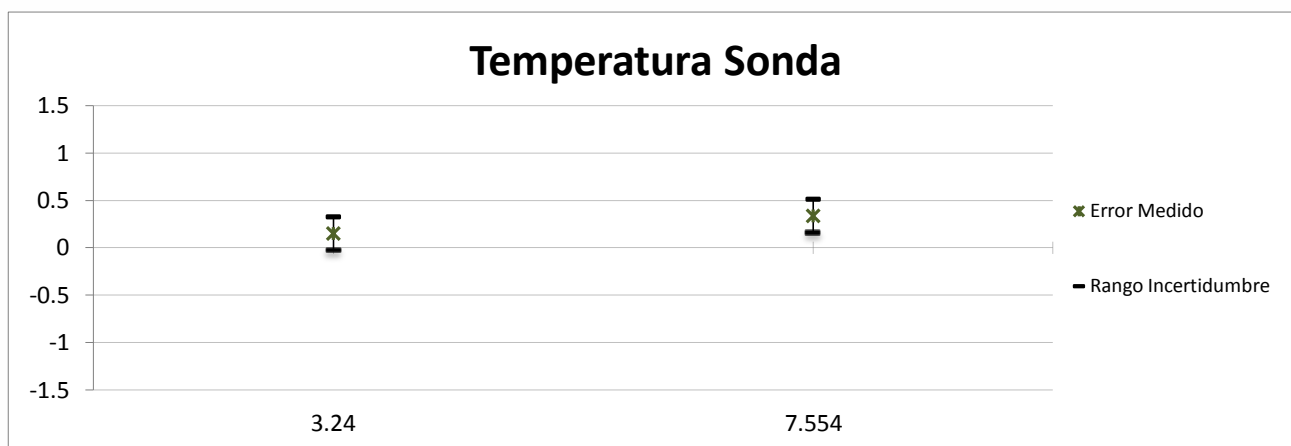

#### HUMEDAD RELATIVA

| Valor de Referencia<br>(Equipo Patrón) | Medición Promedio<br>(Equipo Bajo Prueba) | ERROR | Incertidumbre<br>Expandida | Unidad de la<br>Medición |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|-------|----------------------------|--------------------------|
| 54.98                                  | 52.58                                     | -2.40 | ± 1.72                     | %                        |
| 77.36                                  | 75.09                                     | -2.27 | ± 1.72                     |                          |

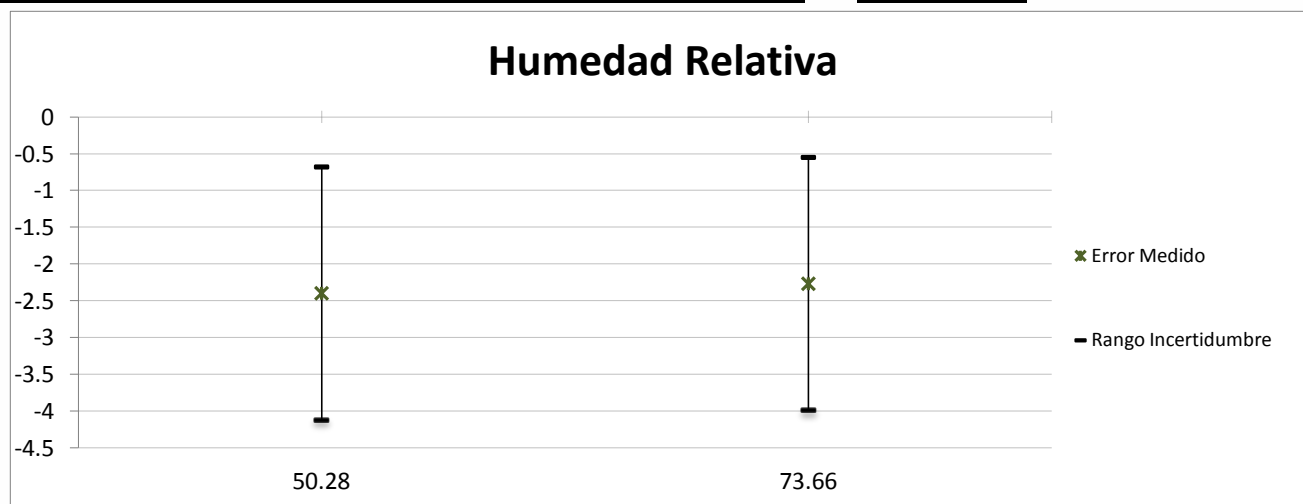

FIN DEL CERTIFICADO

