

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN CALIBRATION CERTIFICATE

Certificado N° 1660925

DATOS DEL EQUIPO				
EQUIPO:	VACUTRÓN	MARCA:	GENTEC	
Device		Brand		
MODELO:	NO DEFINIDO	SERIE:	13D0032	
Model		Serial		
NÚMERO ACTIVO:	545550	UBICACIÓN:	URGENCIAS PEDIATRÍA	
Institute Inventory		Location		

PATRONES UTILIZADOS				
Equipo	Marca	Modelo	Serie	Fecha de calibración
ANALIZADOR DE FLUJO DE GASES	FLUKE BIOMEDICAL	VT PLUS HF	147947	2025-01-07

CONDICIONES DE LA MEDICIÓN				
Fecha Recepción:	2025-09-29	Fecha Calibración:	2025-09-29	
Date of Receipt		Date of Calibration		
TEMPERATURA Inicial:	25 °C	Final:	25 °C	
Temperature		End		
HUMEDAD Rel. Inicial:	62 %	Final:	62 %	
Humidity		End		
Lugar de Calibración:	HOSPITAL SAN JORGE			
Place of Calibration				

DATOS DE LA INSTITUCIÓN				
INSTITUCIÓN:	HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE			
Institution				
TELÉFONO:	(606)3119058	CIUDAD:	PEREIRA	
Telephone		City		
DIRECCIÓN:	CRA 4 # 24-88	Correo:	coordinacion.biomedicos@husj.gov.co	
Address		E-mail		

COD: PS-F0002 - VERSION 01

Elaboró

Revisó



JORGE CARDONA IDARRAGA

 Metrólogo

 Metrologist



MARTÍN LÓPEZ BALLESTEROS

 Coordinador de Prestación de Servicios

 Service Delivery Coordinator

NOTAS ACLARATORIAS

Este certificado no podrá ser reproducido total o parcialmente excepto cuando se haya obtenido permiso por escrito de Coodesuris
 This certificate must not be partially or totally reproduced, except with Coodesuris permission.

Los resultados contenidos en el presente certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones.
 The results of this certificate refer to the moment and condition in which the measurements were made.

El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos calibrados.
 The issuing laboratory assumes no responsibility to the misuse of the calibrated instruments.

El usuario es responsable de la recalibración de sus instrumentos a intervalos apropiados.
 The user is responsible for having his instruments calibrated at appropriate intervals.

La calibración se realiza por el método de comparación con un patrón de referencia
 Calibration is performed by the method of comparison with a reference pattern


La incertidumbre de calibración ha sido estimada con un nivel de confianza del 95% utilizando un factor de cobertura $k=2$
 The calibration uncertainty has been estimated with a confidence level of 95% using a coverage factor $k = 2$

RESULTADOS DE LA MEDICIÓN

PRESIÓN DE VACÍO

Valor de Referencia (EQUIPO BAJO PRUEBA)	Medición Promedio (EQUIPO PATRÓN)	ERROR	Incertidumbre Expandida
100	103,40	3,40	$\pm$ 2,89
200	204,20	4,20	$\pm$ 2,89
300	304,40	4,40	$\pm$ 2,89

Unidad de la Medición
mmHg

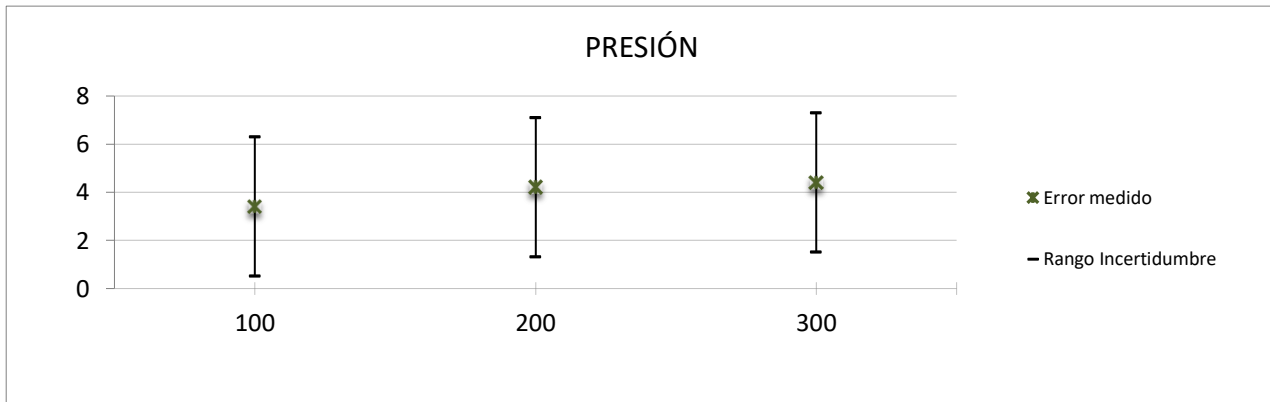

FIN DEL CERTIFICADO