

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

CALIBRATION CERTIFICATE

Certificado N°

J0771025

DATOS DEL EQUIPO			
EQUIPO: Device	VACUTRÓN	MARCA: Brand	GENTEC
MODELO: Model	882VR-760-CH-T	SERIE: Serial	15080179-021
NÚMERO ACTIVO: Institute Inventory	549929	UBICACIÓN: Location	UCO

PATRONES UTILIZADOS				
Equipo	Marca	Modelo	Serie	Fecha de calibración
ANALIZADOR DE FLUJO DE GASES	FLUKE BIOMEDICAL	VT PLUS HF	147947	2025-01-07

CONDICIONES DE LA MEDICIÓN					
Fecha Recepción: Date of Receipt	2025-10-14		Fecha Calibración: Date of Calibration	2025-10-14	
TEMPERATURA Inicial: Temperature	26 °C	Final: End	26 °C	HUMEDAD Rel. Inicial: Humidity	61 %
Lugar de Calibración: Place of Calibration	HOSPITAL SAN JORGE				
				Final: End	61 %

DATOS DE LA INSTITUCIÓN	
INSTITUCIÓN: Institution	HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE
TELÉFONO: Telephone	(606)3119058
DIRECCIÓN: Address	CRA 4 # 24-88
	CIUDAD: PEREIRA City
	Correo: coordinacion.biomedicos@husj.gov.co E-mail

COD: PS-FO002 - VERSION 01

Elaboró

Revisó


JORGE CARDONA IDARRAGA
 Metrólogo


MARTÍN LÓPEZ BALLESTEROS
 Coordinador de Prestación de Servicios

 Av 30 de Agosto Nro 87- 298

 prestacionservicio@husj.gov.co

 (6) 35154 66

NOTAS ACLARATORIAS

Este certificado no podrá ser reproducido total o parcialmente excepto cuando se haya obtenido permiso por escrito de Coodesuris
This certificate must not be partially or totally reproduced, except with Coodesuris permission.

Los resultados contenidos en el presente certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones.
The results of this certificate refer to the moment and condition in which the measurements were made.

El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos calibrados.
The issuing laboratory assumes no responsibility to the misuse of the calibrated instruments.

El usuario es responsable de la recalibración de sus instrumentos a intervalos apropiados
The user is responsible for having his instruments calibrated at appropriate intervals.

La calibración se realiza por el método de comparación con un patrón de referencia
Calibration is performed by the method of comparison with a reference pattern


La incertidumbre de calibración ha sido estimada con un nivel de confianza del 95% utilizando un factor de cobertura $k=2$
The calibration uncertainty has been estimated with a confidence level of 95% using a coverage factor $k = 2$

RESULTADOS DE LA MEDICIÓN

PRESIÓN DE VACÍO

Valor de Referencia (EQUIPO BAJO PRUEBA)	Medición Promedio (EQUIPO PATRÓN)	ERROR	Incertidumbre Expandida
100	107.55	7.55	± 2.89
200	207.90	7.90	± 2.89
300	308.05	8.05	± 2.90

Unidad de la Medición
mmHg

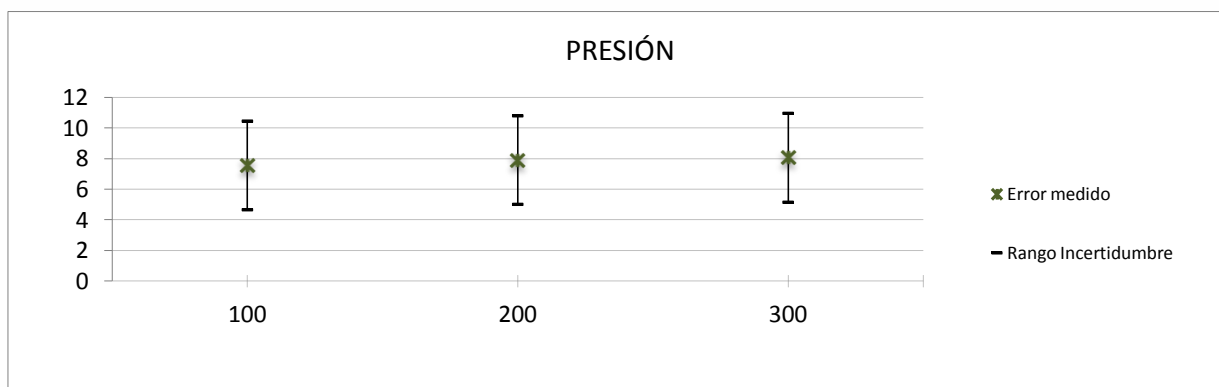

FIN DEL CERTIFICADO



Av 30 de Agosto Nro 87- 298



prestacionservicios@coodesuris.com



(6) 35154 66