

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

CALIBRATION CERTIFICATE

Certificado N°

J0911025

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: Device	VACUTRÓN	MARCA: Brand	GENTEC
MODELO: Model	882VR-760-CH-T	SERIE: Serial	16020091-005
NÚMERO ACTIVO: Institute Inventory	550016	UBICACIÓN: Location	UCO

PATRONES UTILIZADOS

Equipo	Marca	Modelo	Serie	Fecha de calibración
ANALIZADOR DE FLUJO DE GASES	FLUKE BIOMEDICAL	VT PLUS HF	147947	2025-01-07

CONDICIONES DE LA MEDICIÓN

Fecha Recepción: Date of Receipt	2025-10-15	Fecha Calibración: Date of Calibration	2025-10-15
TEMPERATURA Inicial: Temperature	25.8 °C	Final: End	25.8 °C
HUMEDAD Rel. Inicial: Humidity	61 %	Final: End	61 %
Lugar de Calibración: Place of Calibration	HOSPITAL SAN JORGE		

DATOS DE LA INSTITUCIÓN

INSTITUCIÓN: Institution	HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE		
TELÉFONO: Telephone	(606)3119058	CIUDAD: City	PEREIRA
DIRECCIÓN: Address	CRA 4 # 24-88	Correo: E-mail	coordinacion.biomedicos@husj.gov.co

COD: PS-FO002 - VERSION 01

Elaboró

Revisó


JORGE CARDONA IDARRAGA
 Metrólogo


MARTÍN LÓPEZ BALLESTEROS
 Coordinador de Prestación de Servicios

 Av 30 de Agosto Nro 87- 298

 prestacionservicio@husj.gov.co

 (6) 35154 66

NOTAS ACLARATORIAS

Este certificado no podrá ser reproducido total o parcialmente excepto cuando se haya obtenido permiso por escrito de Coodesuris
 This certificate must not be partially or totally reproduced, except with Coodesuris permission.

Los resultados contenidos en el presente certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones.
 The results of this certificate refer to the moment and condition in which the measurements were made.

El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos calibrados.
 The issuing laboratory assumes no responsibility to the misuse of the calibrated instruments.

El usuario es responsable de la recalibración de sus instrumentos a intervalos apropiados
 The user is responsible for having his instruments calibrated at appropriate intervals.

La calibración se realiza por el método de comparación con un patrón de referencia
 Calibration is performed by the method of comparison with a reference pattern


La incertidumbre de calibración ha sido estimada con un nivel de confianza del 95% utilizando un factor de cobertura $k=2$
 The calibration uncertainty has been estimated with a confidence level of 95% using a coverage factor $k = 2$

RESULTADOS DE LA MEDICIÓN

PRESIÓN DE VACÍO

Valor de Referencia (EQUIPO BAJO PRUEBA)	Medición Promedio (EQUIPO PATRÓN)	ERROR	Incertidumbre Expandida	
100	109.80	9.80	$\pm$	2.90
200	210.68	10.68	$\pm$	2.95
300	311.83	11.83	$\pm$	2.90

Unidad de la Medición
mmHg

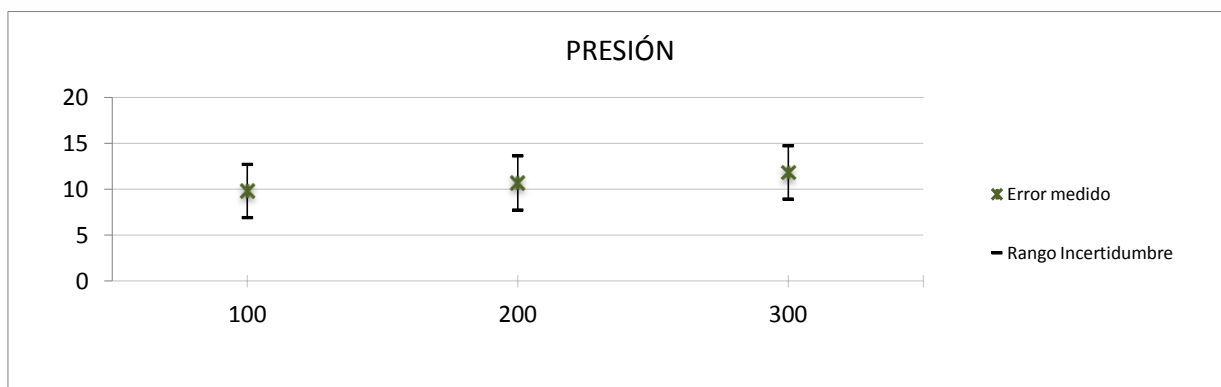

FIN DEL CERTIFICADO



Av 30 de Agosto Nro 87- 298



prestacionservicios@coodesuris.com



(6) 35154 66