

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
CALIBRATION CERTIFICATE

Certificado N°

M3661125

DATOS DEL EQUIPO				
EQUIPO:	VENTILADOR	MARCA:	HAMILTON	
Device		Brand		
MODELO:	C1	SERIE:	25190	
Model		Serial		
Inventario Institución:	573188	UBICACIÓN:	INTERMEDIOS PEDIATRIA	
Institute Inventory		Location		

PATRONES UTILIZADOS				
Equipo	Marca	Modelo	Serie	Fecha de calibración
ANALIZADOR DE FLUJO DE GASES	FLUKE BIOMEDICAL	VT PLUS HF	147947	2025-01-07

CONDICIONES DE LA MEDICIÓN				
Fecha Recepción:	2025-11-25	Fecha Calibración:	2025-11-25	
Date of Receipt		Date of Calibration		
TEMPERATURA Inicial:	22 °C	Final:	22 °C	
Temperature		End		
HUMEDAD Rel. Inicial:	61 %	Final:	61 %	
Humidity		End		
Lugar de Calibración:	HOSPITAL SAN JORGE			
Place of Calibration				

DATOS DE LA INSTITUCIÓN				
INSTITUCIÓN:	HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE			
Institution				
TELÉFONO:	(606)3119058	CIUDAD:	PEREIRA	
Telephone		City		
DIRECCIÓN:	CRA 4 # 24-88	Correo:	Coordinacion.biomedicos@husj.gov.co	
Address		E-mail		

COD: LM-FO002 - VERSION 01

Elaboró

Revisó


JORGE CARDONA IDARRAGA

Metrologist


MARTÍN LÓPEZ BALLESTEROS
Coordinador del Laboratorio
Laboratory Coordinator

NOTAS ACLARATORIAS

Este certificado no podrá ser reproducido total o parcialmente excepto cuando se haya obtenido permiso por escrito de Coodesuris
This certificate must not be partially or totally reproduced, except with Coodesuris permission.

Los resultados contenidos en el presente certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones.
The results of this certificate refer to the moment and condition in which the measurements were made.

El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos calibrados.
The issuing laboratory assumes no responsibility to the misuse of the calibrated instruments.

El usuario es responsable de la recalibración de sus instrumentos a intervalos apropiados.
The user is responsible for having his instruments calibrated at appropriate intervals.

La calibración se realiza por el método de comparación con un patrón de referencia
Calibration is performed by the method of comparison with a reference pattern


La incertidumbre de calibración ha sido estimada con un nivel de confianza del 95% utilizando un factor de cobertura $k=2$
The calibration uncertainty has been estimated with a confidence level of 95% using a coverage factor $k = 2$

Los error máximo permitido es tomado de: Service Manual
The maximum error allowed is taken from: Service Manual

RESULTADOS DE LA MEDICIÓN


VOLUMEN TIDAL

Valor de Referencia (Equipo Bajo Prueba)	Medición Promedio (Equipo Patrón)	ERROR	Incertidumbre Expandida		Unidad de la Medición
300	297.14	-2.86	$\pm$	2.83	
600	588.88	-11.12	$\pm$	1.42	mL
800	817.94	17.94	$\pm$	1.55	

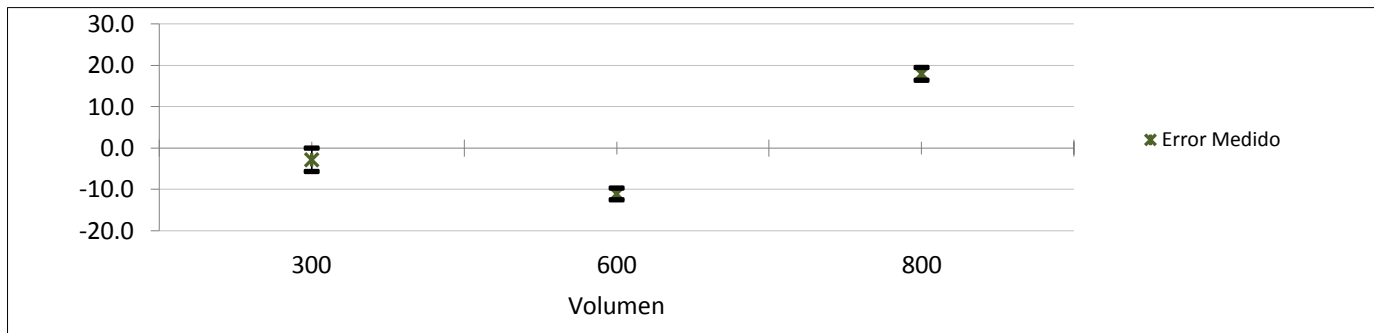

PEEP


Valor de Referencia (Equipo Bajo Prueba)	Medición Promedio (Equipo Patrón)	ERROR	Incertidumbre Expandida		Unidad de la Medición
5	5.05	0.05	$\pm$	0.16	
8	8.58	0.58	$\pm$	0.14	cmH ₂ O
15	15.13	0.13	$\pm$	0.28	

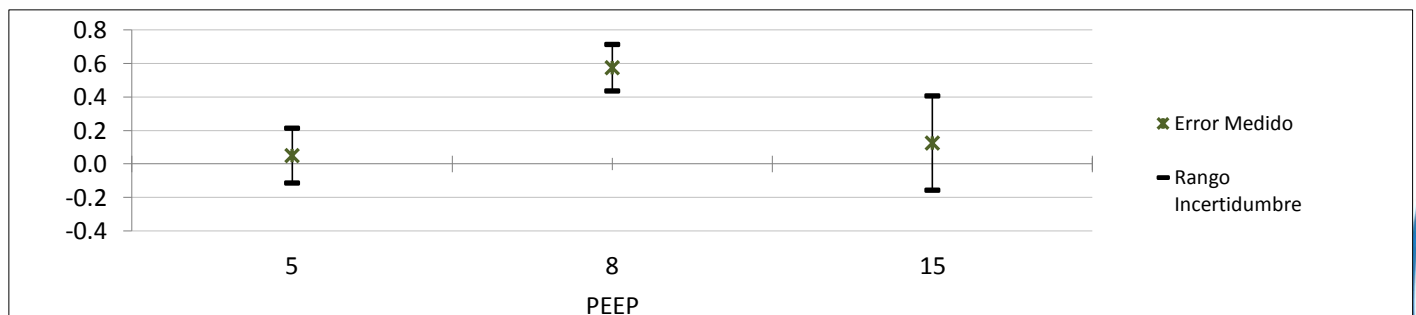

FRECUENCIA RESPIRATORIA

Valor de Referencia (Equipo Bajo Prueba)	Medición Promedio (Equipo Patrón)	ERROR	Incertidumbre Expandida	
10	10.00	0.00	±	0.59
20	20.08	0.08	±	0.63
30	30.18	0.18	±	0.68


Unidad de la Medición
Resp/min

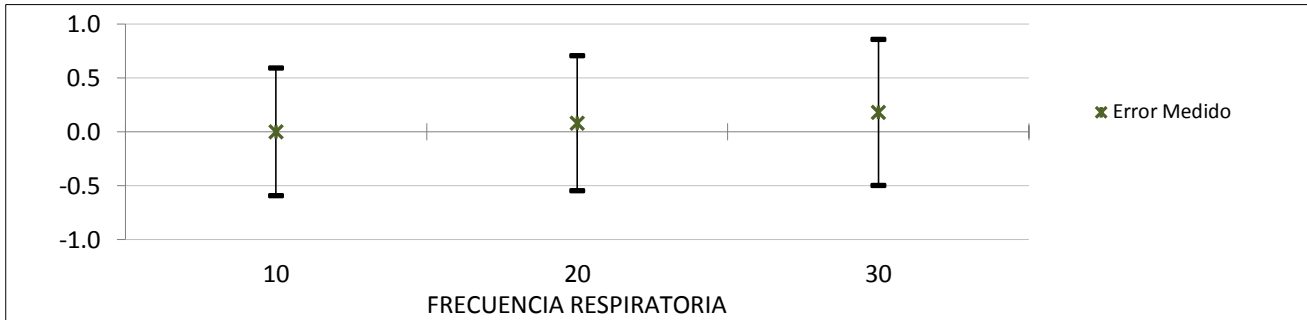

PIP

Valor de Referencia (Equipo Bajo Prueba)	Medición Promedio (Equipo Patrón)	ERROR	Incertidumbre Expandida	
11	11.10	0.10	±	0.59
24	25.48	1.48	±	0.59
40	43.04	3.04	±	0.60


Unidad de la Medición
cmH2O

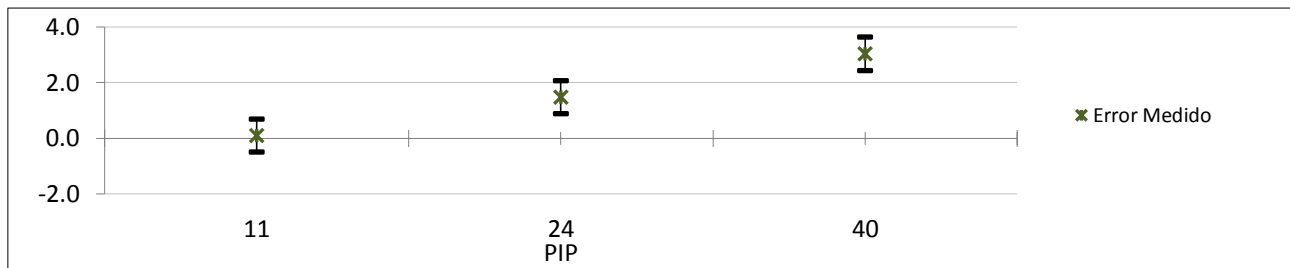

RELACIÓN I:E

Valor de Referencia (Equipo Bajo Prueba)	Medición Promedio (Equipo Patrón)	ERROR	Incertidumbre Expandida	
1	1.000	0.000	±	0.01
2	2.012	0.012	±	0.02
4	4.016	0.016	±	0.05

Unidad de la Medición
s

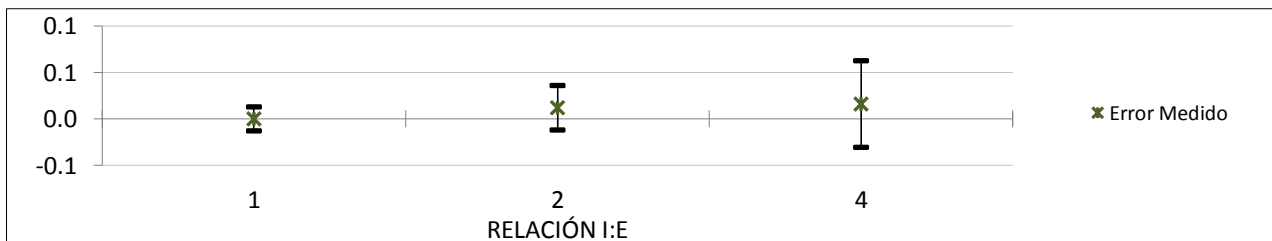

FI02

Valor de Referencia (Equipo Bajo Prueba)	Medición Promedio (Equipo Patrón)	ERROR	Incertidumbre Expandida	
21	20.08	-0.92	±	0.37
50	53.40	3.40	±	0.39
100	99.58	-0.43	±	0.37

Unidad de la Medición
%