

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
CALIBRATION CERTIFICATE

Certificado N°

M1321025

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: Device	VENTILADOR	MARCA: Brand	CAREFUSION/VYAIR
MODELO: Model	VELA COMPREHENSIVE 16532-08	SERIE: Serial	CAT02987
Inventario Institución: Institute Inventory	573967	UBICACIÓN: Location	INTERMEDIOS

PATRONES UTILIZADOS

Equipo	Marca	Modelo	Serie	Fecha de calibración
ANALIZADOR DE FLUJO DE GASES	FLUKE BIOMEDICAL	VT PLUS HF	2266044	2025-09-29

CONDICIONES DE LA MEDICIÓN

Fecha Recepción: Date of Receipt	2025-10-15	Fecha Calibración: Date of Calibration	2025-10-15
TEMPERATURA Inicial: Temperature	22.0 °C	Final: End	22 °C
HUMEDAD Rel. Inicial: Humidity	60 %	Final: End	60 %
Lugar de Calibración: Place of Calibration	HOSPITAL SAN JORGE		

DATOS DE LA INSTITUCIÓN

INSTITUCIÓN: Institution	HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE		
TELÉFONO: Telephone	(606)3119058	CIUDAD: City	PEREIRA
DIRECCIÓN: Address	CRA 4 # 24-88	Correo: E-mail	Coordinacion.biomedicos@husj.gov.co

COD: LM-F0002 - VERSION 01

Elaboró


JORGE CARDONA IDARRAGA
Metrólogo
Metrologist

Revisó


MARTIN LÓPEZ BALLESTEROS
Coordinador del Laboratorio
Laboratory Coordinator

NOTAS ACLARATORIAS

Este certificado no podrá ser reproducido total o parcialmente excepto cuando se haya obtenido permiso por escrito de Coodesuris
This certificate must not be partially or totally reproduced, except with Coodesuris permission.

Los resultados contenidos en el presente certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones.
The results of this certificate refer to the moment and condition in which the measurements were made.

El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos calibrados.
The issuing laboratory assumes no responsibility to the misuse of the calibrated instruments.

El usuario es responsable de la recalibración de sus instrumentos a intervalos apropiados
The user is responsible for having his instruments calibrated at appropriate intervals.

La calibración se realiza por el método de comparación con un patrón de referencia
Calibration is performed by the method of comparison with a reference pattern


La incertidumbre de calibración ha sido estimada con un nivel de confianza del 95% utilizando un factor de cobertura $k=2$
The calibration uncertainty has been estimated with a confidence level of 95% using a coverage factor $k = 2$

Los error máximo permitido es tomado de: Service Manual
The maximum error allowed is taken from: Service Manual

RESULTADOS DE LA MEDICIÓN


VOLUMEN TIDAL

Valor de Referencia (Equipo Bajo Prueba)	Medición Promedio (Equipo Patrón)	ERROR	Incertidumbre Expandida		Unidad de la Medición
300	292.30	-7.70	$\pm$	1.37	mL
600	589.40	-10.60	$\pm$	1.37	
800	785.30	-14.70	$\pm$	1.37	

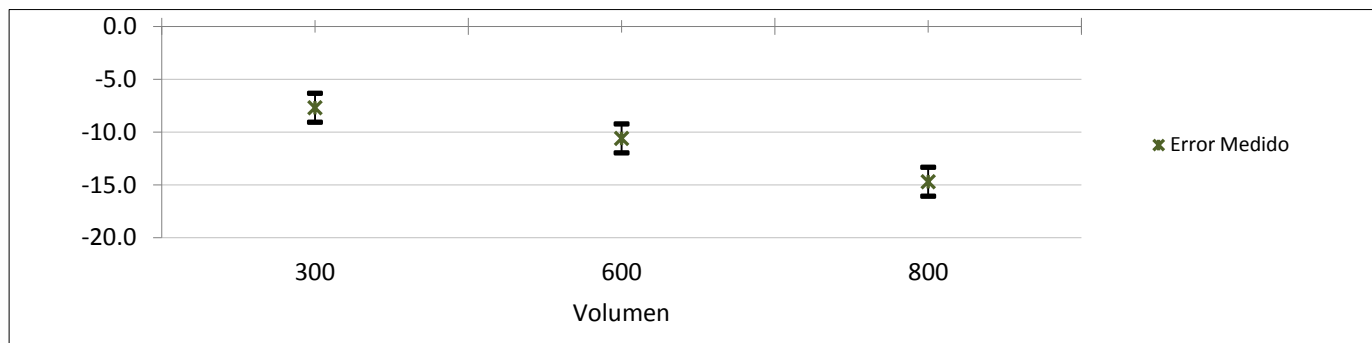

PEEP


Valor de Referencia (Equipo Bajo Prueba)	Medición Promedio (Equipo Patrón)	ERROR	Incertidumbre Expandida		Unidad de la Medición
5	4.90	-0.10	$\pm$	0.13	cmH ₂ O
8	8.00	0.00	$\pm$	0.13	
15	14.90	-0.10	$\pm$	0.13	

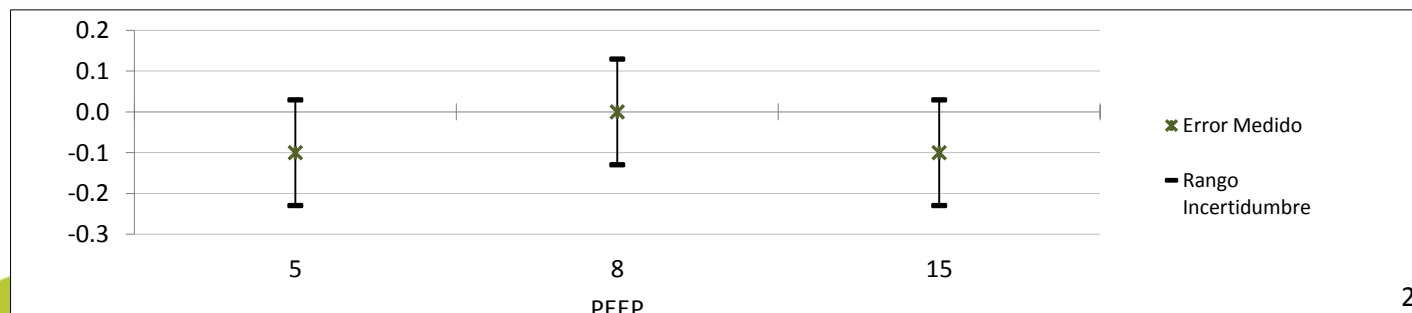

FRECUENCIA RESPIRATORIA

Valor de Referencia (Equipo Bajo Prueba)	Medición Promedio (Equipo Patrón)	ERROR	Incertidumbre Expandida	
10	10.00	0.00	±	0.59
20	20.10	0.10	±	0.62
30	30.00	0.00	±	0.68


Unidad de la Medición
Resp/min

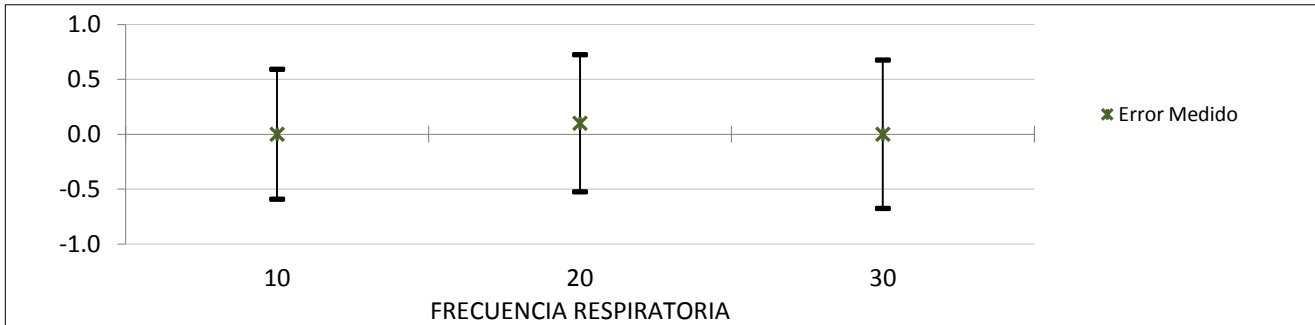

PIP

Valor de Referencia (Equipo Bajo Prueba)	Medición Promedio (Equipo Patrón)	ERROR	Incertidumbre Expandida	
11	11.30	0.30	±	0.59
24	24.20	0.20	±	0.59
40	41.00	1.00	±	0.59


Unidad de la Medición
cmH2O

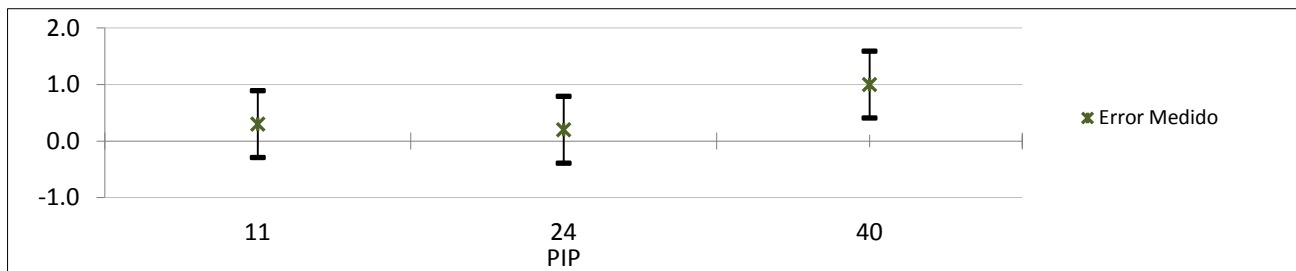

RELACIÓN I:E

Valor de Referencia (Equipo Bajo Prueba)	Medición Promedio (Equipo Patrón)	ERROR	Incertidumbre Expandida	
1	0.980	-0.020	±	0.01
2	1.990	-0.010	±	0.02
4	3.970	-0.030	±	0.05

Unidad de la Medición
s

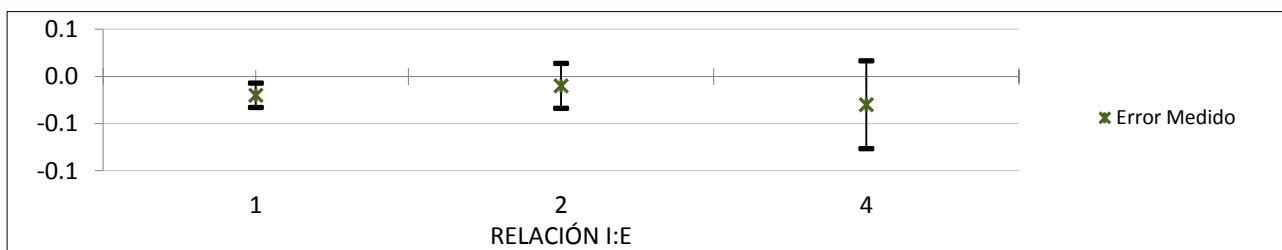

FI02

Valor de Referencia (Equipo Bajo Prueba)	Medición Promedio (Equipo Patrón)	ERROR	Incertidumbre Expandida	
21	20.20	-0.80	±	0.37
50	48.30	-1.70	±	0.37

Unidad de la Medición
%

100	99.40	-0.60	±	0.37
-----	-------	-------	---	------

FIN DEL CERTIFICADO

