

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
CALIBRATION CERTIFICATE

Certificado N°

M1341025

DATOS DEL EQUIPO				
EQUIPO: Device	VENTILADOR	MARCA: Brand	CAREFUSION/VYAIRE	
MODELO: Model	VELA COMPREHENSIVE 16532-08	SERIE: Serial	CAT02934	
Inventario Institución: Institute Inventory	574164	UBICACIÓN: Location	INTERMEDIOS	

PATRONES UTILIZADOS				
Equipo	Marca	Modelo	Serie	Fecha de calibración
ANALIZADOR DE FLUJO DE GASES	FLUKE BIOMEDICAL	VT PLUS HF	2266044	2025-09-29

CONDICIONES DE LA MEDICIÓN															
Fecha Recepción:		2025-10-15			Fecha Calibración:		2025-10-15								
Date of Receipt					Date of Calibration										
TEMPERATURA Inicial:		22.0 °C		Final:		22 °C		HUMEDAD Rel. Inicial:		60 %		Final:		60 %	
Temperature				End				Humidity				End			
Lugar de Calibración:		HOSPITAL SAN JORGE													
Place of Calibration															

DATOS DE LA INSTITUCIÓN	
INSTITUCIÓN: Institution	HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE
TELÉFONO: Telephone	(606)3119058
DIRECCIÓN: Address	CRA 4 # 24-88
CIUDAD: City	PEREIRA
Correo: E-mail	Coordinacion.biomedicos@husj.gov.co

COD: LM-FO002 - VERSION 01

Elaboró



JORGE CARDONA IDARRAGA

Metrologist

Revisó



MARTÍN LÓPEZ BALLESTEROS

Coordinador del Laboratorio

Laboratory Coordinator



Av 30 de Agosto Nro 87- 298



prestacionservicios@coodesuris.com



(6) 35154 66

NOTAS ACLARATORIAS

Este certificado no podrá ser reproducido total o parcialmente excepto cuando se haya obtenido permiso por escrito de Coodesuris
This certificate must not be partially or totally reproduced, except with Coodesuris permission.

Los resultados contenidos en el presente certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones.
The results of this certificate refer to the moment and condition in which the measurements were made.

El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos calibrados.
The issuing laboratory assumes no responsibility to the misuse of the calibrated instruments.

El usuario es responsable de la recalibración de sus instrumentos a intervalos apropiados
The user is responsible for having his instruments calibrated at appropriate intervals.

La calibración se realiza por el método de comparación con un patrón de referencia
Calibration is performed by the method of comparison with a reference pattern


La incertidumbre de calibración ha sido estimada con un nivel de confianza del 95% utilizando un factor de cobertura $k=2$
The calibration uncertainty has been estimated with a confidence level of 95% using a coverage factor $k = 2$

Los errores máximos permitidos son tomados de: Service Manual
The maximum errors allowed are taken from: Service Manual

RESULTADOS DE LA MEDICIÓN


VOLUMEN TIDAL

Valor de Referencia (Equipo Bajo Prueba)	Medición Promedio (Equipo Patrón)	ERROR	Incertidumbre Expandida		Unidad de la Medición
300	289.60	-10.40	$\pm$	1.37	
600	585.40	-14.60	$\pm$	1.37	mL
800	783.10	-16.90	$\pm$	1.37	

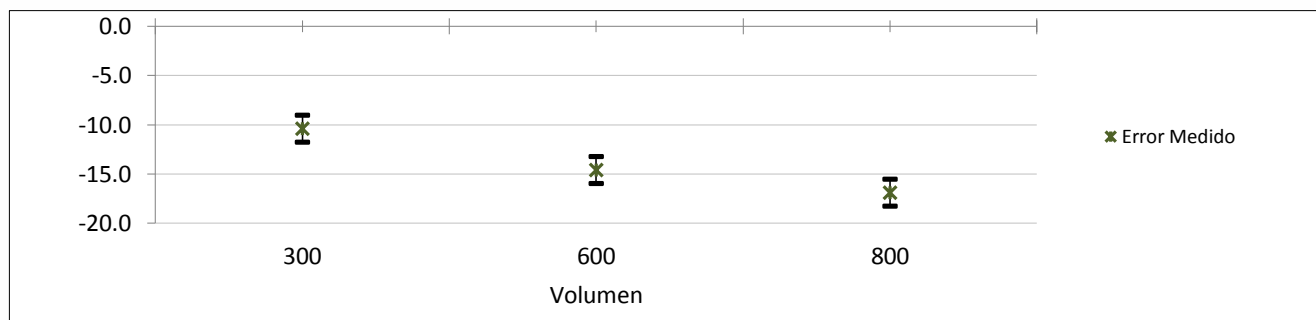

PEEP


Valor de Referencia (Equipo Bajo Prueba)	Medición Promedio (Equipo Patrón)	ERROR	Incertidumbre Expandida		Unidad de la Medición
5	4.90	-0.10	$\pm$	0.13	
8	8.00	0.00	$\pm$	0.13	cmH ₂ O
15	14.90	-0.10	$\pm$	0.13	

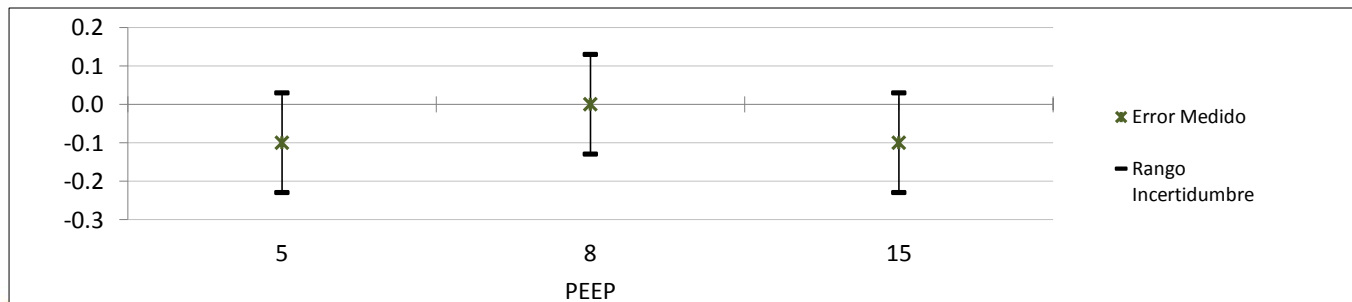

FRECUENCIA RESPIRATORIA

Valor de Referencia (Equipo Bajo Prueba)	Medición Promedio (Equipo Patrón)	ERROR	Incertidumbre Expandida	
10	10.00	0.00	±	0.59
20	20.00	0.00	±	0.62
30	30.00	0.00	±	0.68


Unidad de la Medición
Resp/min

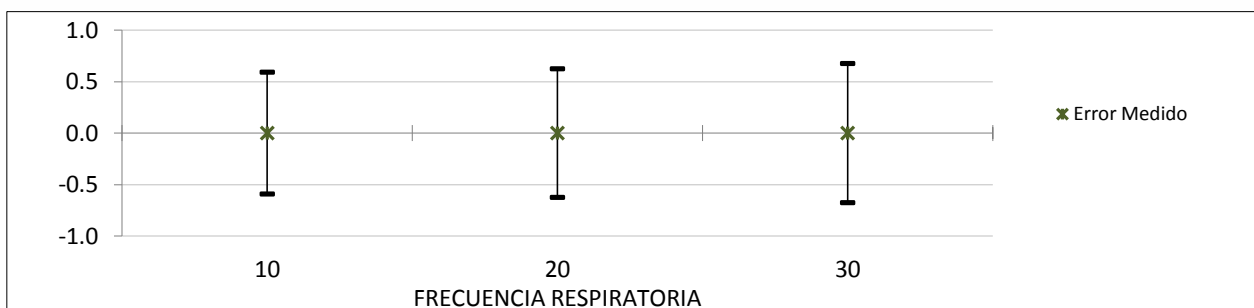

PIP

Valor de Referencia (Equipo Bajo Prueba)	Medición Promedio (Equipo Patrón)	ERROR	Incertidumbre Expandida	
11	11.20	0.20	±	0.59
24	24.10	0.10	±	0.59
40	40.80	0.80	±	0.59


Unidad de la Medición
cmH2O

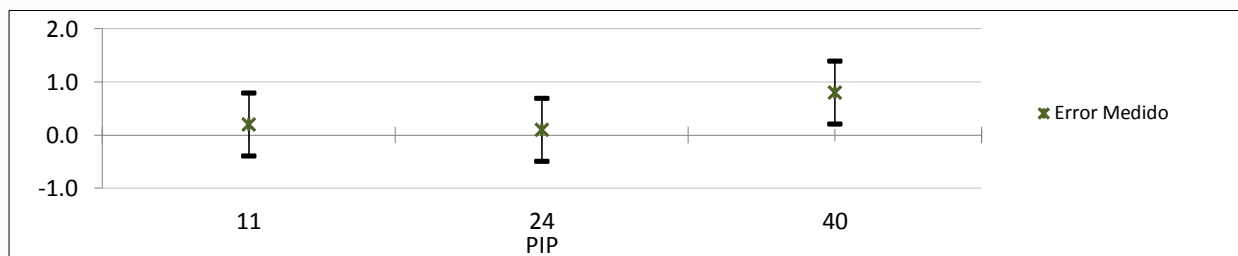

RELACIÓN I:E

Valor de Referencia (Equipo Bajo Prueba)	Medición Promedio (Equipo Patrón)	ERROR	Incertidumbre Expandida	
1	0.980	-0.020	±	0.01
2	1.990	-0.010	±	0.02
4	3.980	-0.020	±	0.05

Unidad de la Medición
s

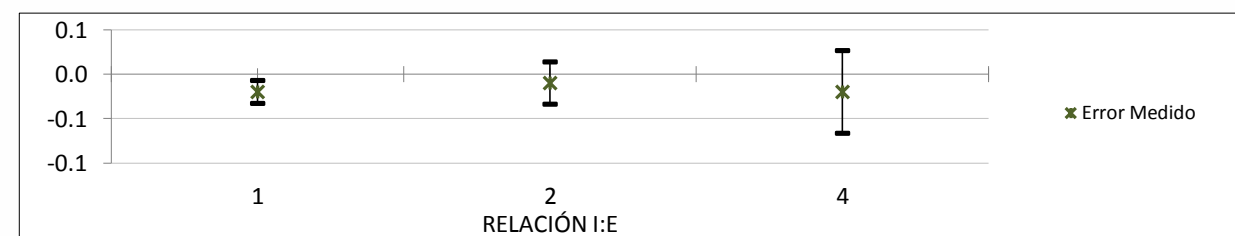

FIO2

Valor de Referencia (Equipo Bajo Prueba)	Medición Promedio (Equipo Patrón)	ERROR	Incertidumbre Expandida	
21	20.30	-0.70	±	0.37
50	48.60	-1.40	±	0.37
100	99.30	-0.70	±	0.37

Unidad de la Medición
%