

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
CALIBRATION CERTIFICATE

Certificado N° J1571125

DATOS DEL EQUIPO				
EQUIPO:	VENTILADOR	MARCA:	MONNAL	
Device		Brand		
MODELO:	T60	SERIE:	MT60-13327	
Model		Serial		
Inventario Institución:	574647	UBICACIÓN:	QUIRÓFANO	
Institute Inventory		Location		

PATRONES UTILIZADOS				
Equipo	Marca	Modelo	Serie	Fecha de calibración
ANALIZADOR DE FLUJO DE GASES	FLUKE BIOMEDICAL	VT PLUS HF	147947	2025-01-07

CONDICIONES DE LA MEDICIÓN									
Fecha Recepción:		2025-11-20		Fecha Calibración:		2025-11-20			
Date of Receipt				Date of Calibration					
TEMPERATURA Inicial:		25,5 °C	Final:	25,5 °C	HUMEDAD Rel. Inicial:		61 %	Final:	61 %
Temperature			End		Humidity			End	
Lugar de Calibración:		HOSPITAL SAN JORGE							
Place of Calibration									

DATOS DE LA INSTITUCIÓN	
INSTITUCIÓN:	HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE
Institution	
TELÉFONO:	(606)3119058
Telephone	
DIRECCIÓN:	CRA 4 # 24-88
Address	
CIUDAD:	PEREIRA
City	
Correo:	Coordinacion.biomedicos@husj.gov.co
E-mail	

COD: LM-FO002 - VERSION 01

Elaboró

Revisó


JORGE CARDONA IDARRAGA

Metrologist


MARTÍN LÓPEZ BALLESTEROS
Coordinador del Laboratorio
Laboratory Coordinator

NOTAS ACLARATORIAS

Este certificado no podrá ser reproducido total o parcialmente excepto cuando se haya obtenido permiso por escrito de Coodesuris
This certificate must not be partially or totally reproduced, except with Coodesuris permission.

Los resultados contenidos en el presente certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones.
The results of this certificate refer to the moment and condition in which the measurements were made.

El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos calibrados.
The issuing laboratory assumes no responsibility to the misuse of the calibrated instruments.

El usuario es responsable de la recalibración de sus instrumentos a intervalos apropiados.
The user is responsible for having his instruments calibrated at appropriate intervals.

La calibración se realiza por el método de comparación con un patrón de referencia
Calibration is performed by the method of comparison with a reference pattern


La incertidumbre de calibración ha sido estimada con un nivel de confianza del 95% utilizando un factor de cobertura $k=2$
The calibration uncertainty has been estimated with a confidence level of 95% using a coverage factor $k = 2$

Los errores máximos permitidos son tomados de: Service Manual
The maximum error allowed is taken from: Service Manual

RESULTADOS DE LA MEDICIÓN


VOLUMEN TIDAL

Valor de Referencia (Equipo Bajo Prueba)	Medición Promedio (Equipo Patrón)	ERROR	Incertidumbre Expandida		Unidad de la Medición
300	311,45	11,45	$\pm$	1,62	
600	621,73	21,72	$\pm$	1,99	mL
800	782,35	-17,65	$\pm$	1,85	

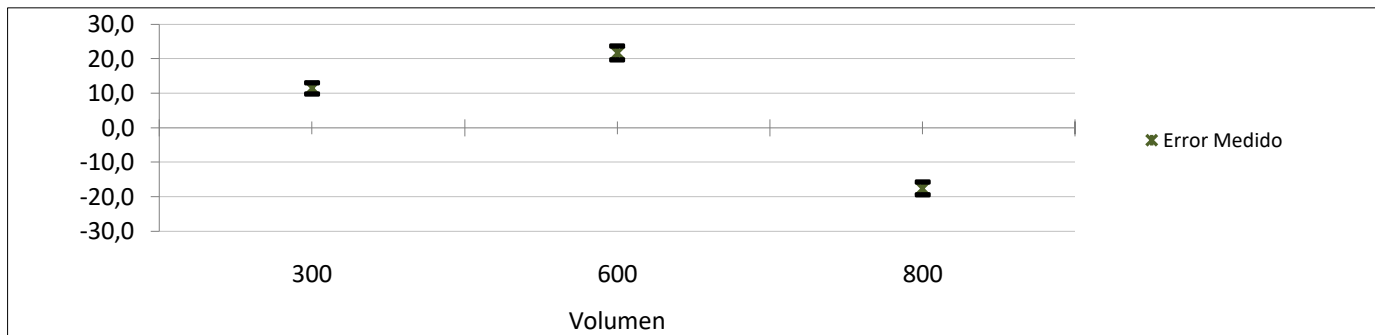

PEEP


Valor de Referencia (Equipo Bajo Prueba)	Medición Promedio (Equipo Patrón)	ERROR	Incertidumbre Expandida		Unidad de la Medición
5	4,25	-0,75	$\pm$	0,14	
8	7,33	-0,68	$\pm$	0,14	cmH2O
15	14,55	-0,45	$\pm$	0,14	

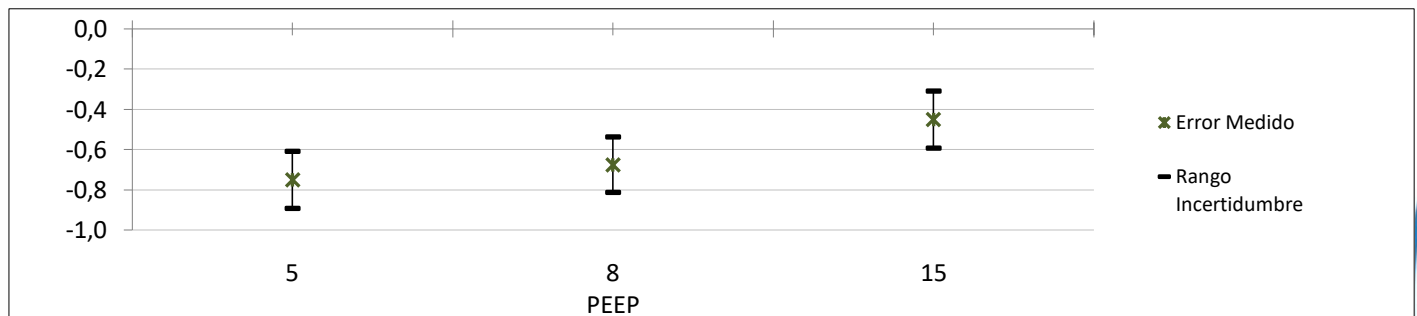

FRECUENCIA RESPIRATORIA

Valor de Referencia (Equipo Bajo Prueba)	Medición Promedio (Equipo Patrón)	ERROR	Incertidumbre Expandida	
10	10,00	0,00	±	0,59
20	19,90	-0,10	±	0,63
30	29,94	-0,06	±	0,68


Unidad de la Medición
Resp/min

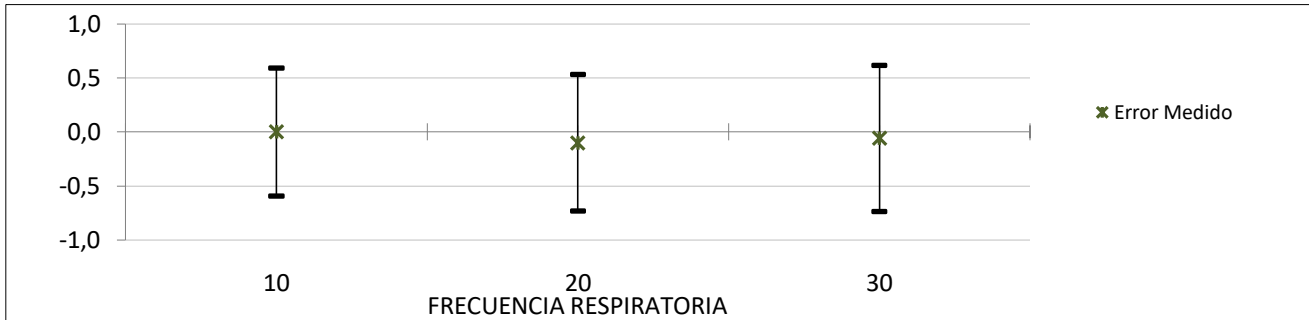

PIP

Valor de Referencia (Equipo Bajo Prueba)	Medición Promedio (Equipo Patrón)	ERROR	Incertidumbre Expandida	
11	11,64	0,64	±	0,59
24	25,26	1,26	±	0,60
40	42,42	2,42	±	0,64


Unidad de la Medición
cmH2O

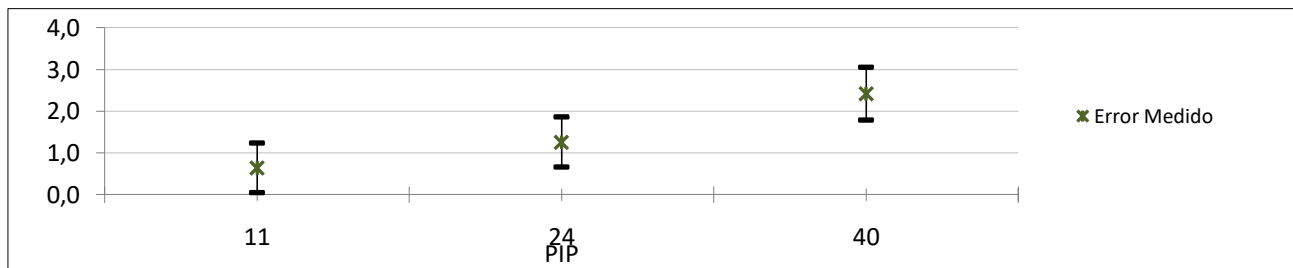

RELACIÓN I:E

Valor de Referencia (Equipo Bajo Prueba)	Medición Promedio (Equipo Patrón)	ERROR	Incertidumbre Expandida	
1	1,000	0,000	±	0,01
2	2,016	0,016	±	0,02
4	4,034	0,034	±	0,05

Unidad de la Medición
s

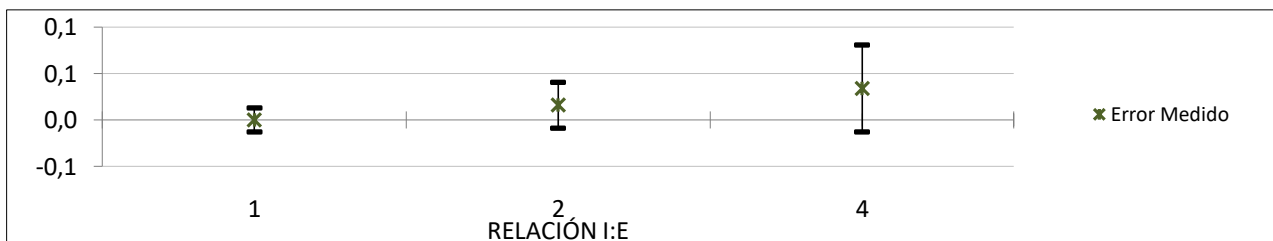

FI02

Valor de Referencia (Equipo Bajo Prueba)	Medición Promedio (Equipo Patrón)	ERROR	Incertidumbre Expandida	
21	20,75	-0,25	±	0,37
50	52,08	2,08	±	0,37
100	96,58	-3,43	±	0,46

Unidad de la Medición
%