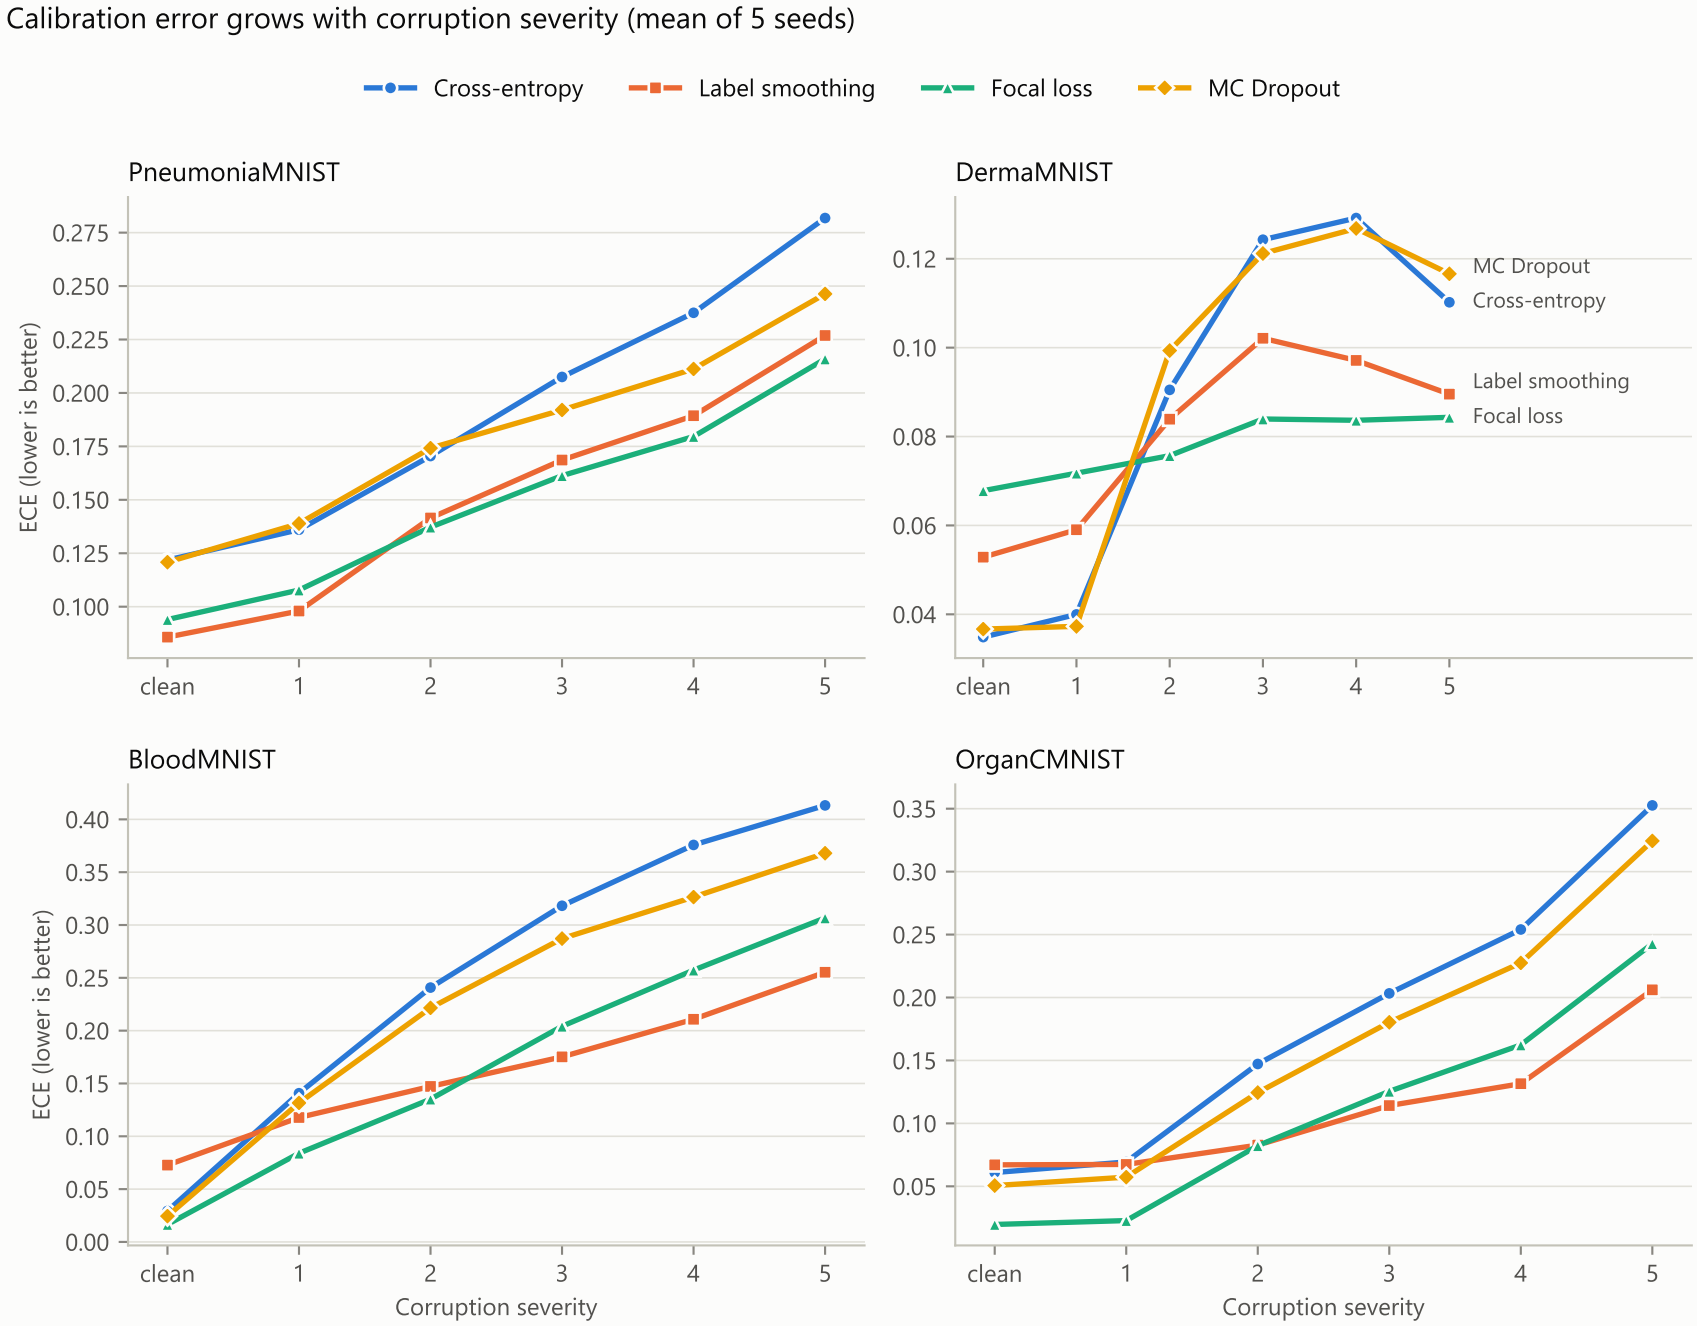
Calibration error grows with corruption severity (mean of 5 seeds)
Cross-entropy
Label smoothing
Focal loss
MC Dropout
PneumoniaMNIST
DermaMNIST
BloodMNIST
OrganCMNIST
ECE (lower is better)
Corruption severity
clean
1
2
3
4
5
0.100
0.125
0.150
0.175
0.200
0.225
0.250
0.275
0.04
0.06
0.08
0.10
0.12
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
0.40