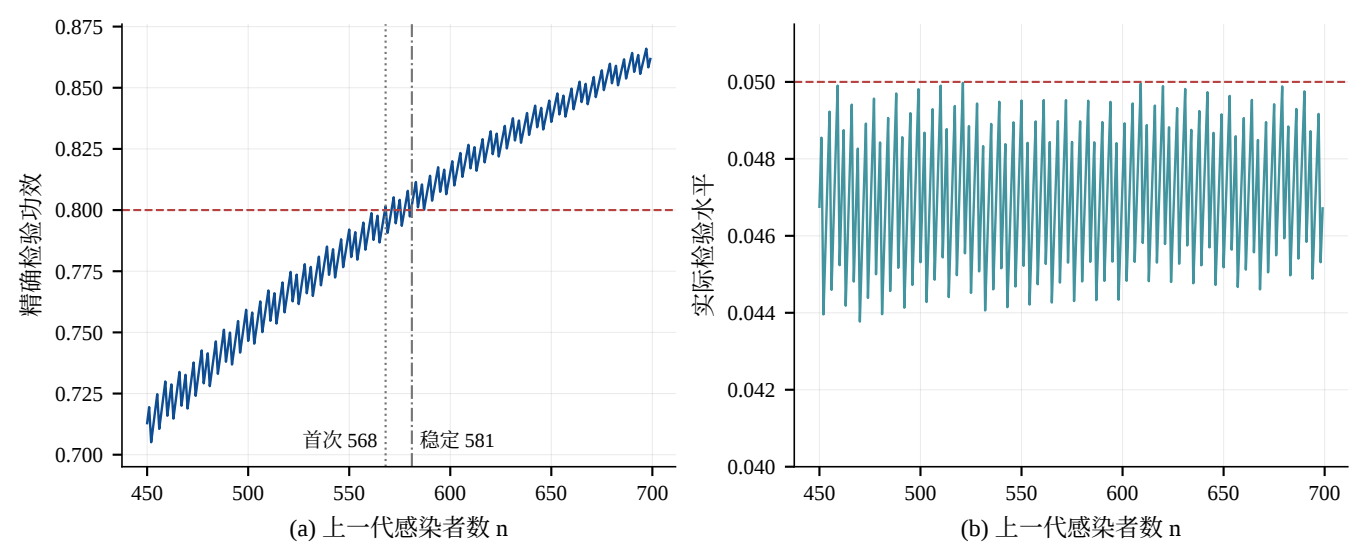
精确检验功效
0.875
0.850
0.825
0.800
0.775
0.750
0.725
0.700
首次 568
稳定 581
450
500
550
600
650
700
(a) 上一代感染者数 n
实际检验水平
0.050
0.048
0.046
0.044
0.042
0.040
450
500
550
600
650
700
(b) 上一代感染者数 n