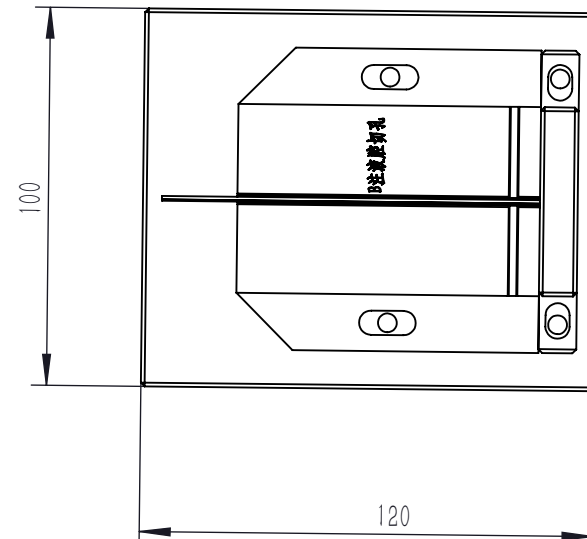
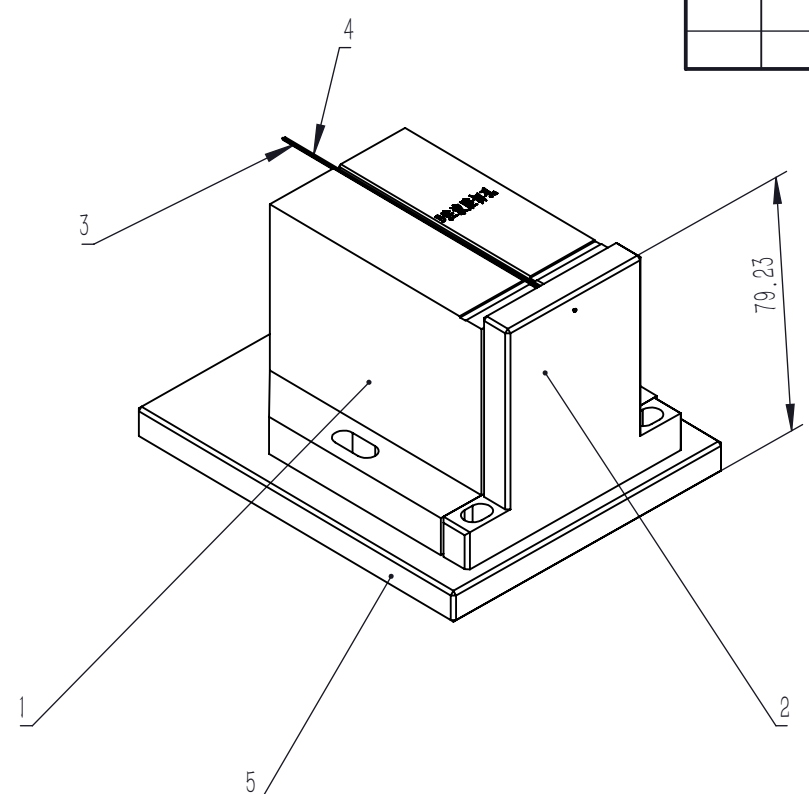

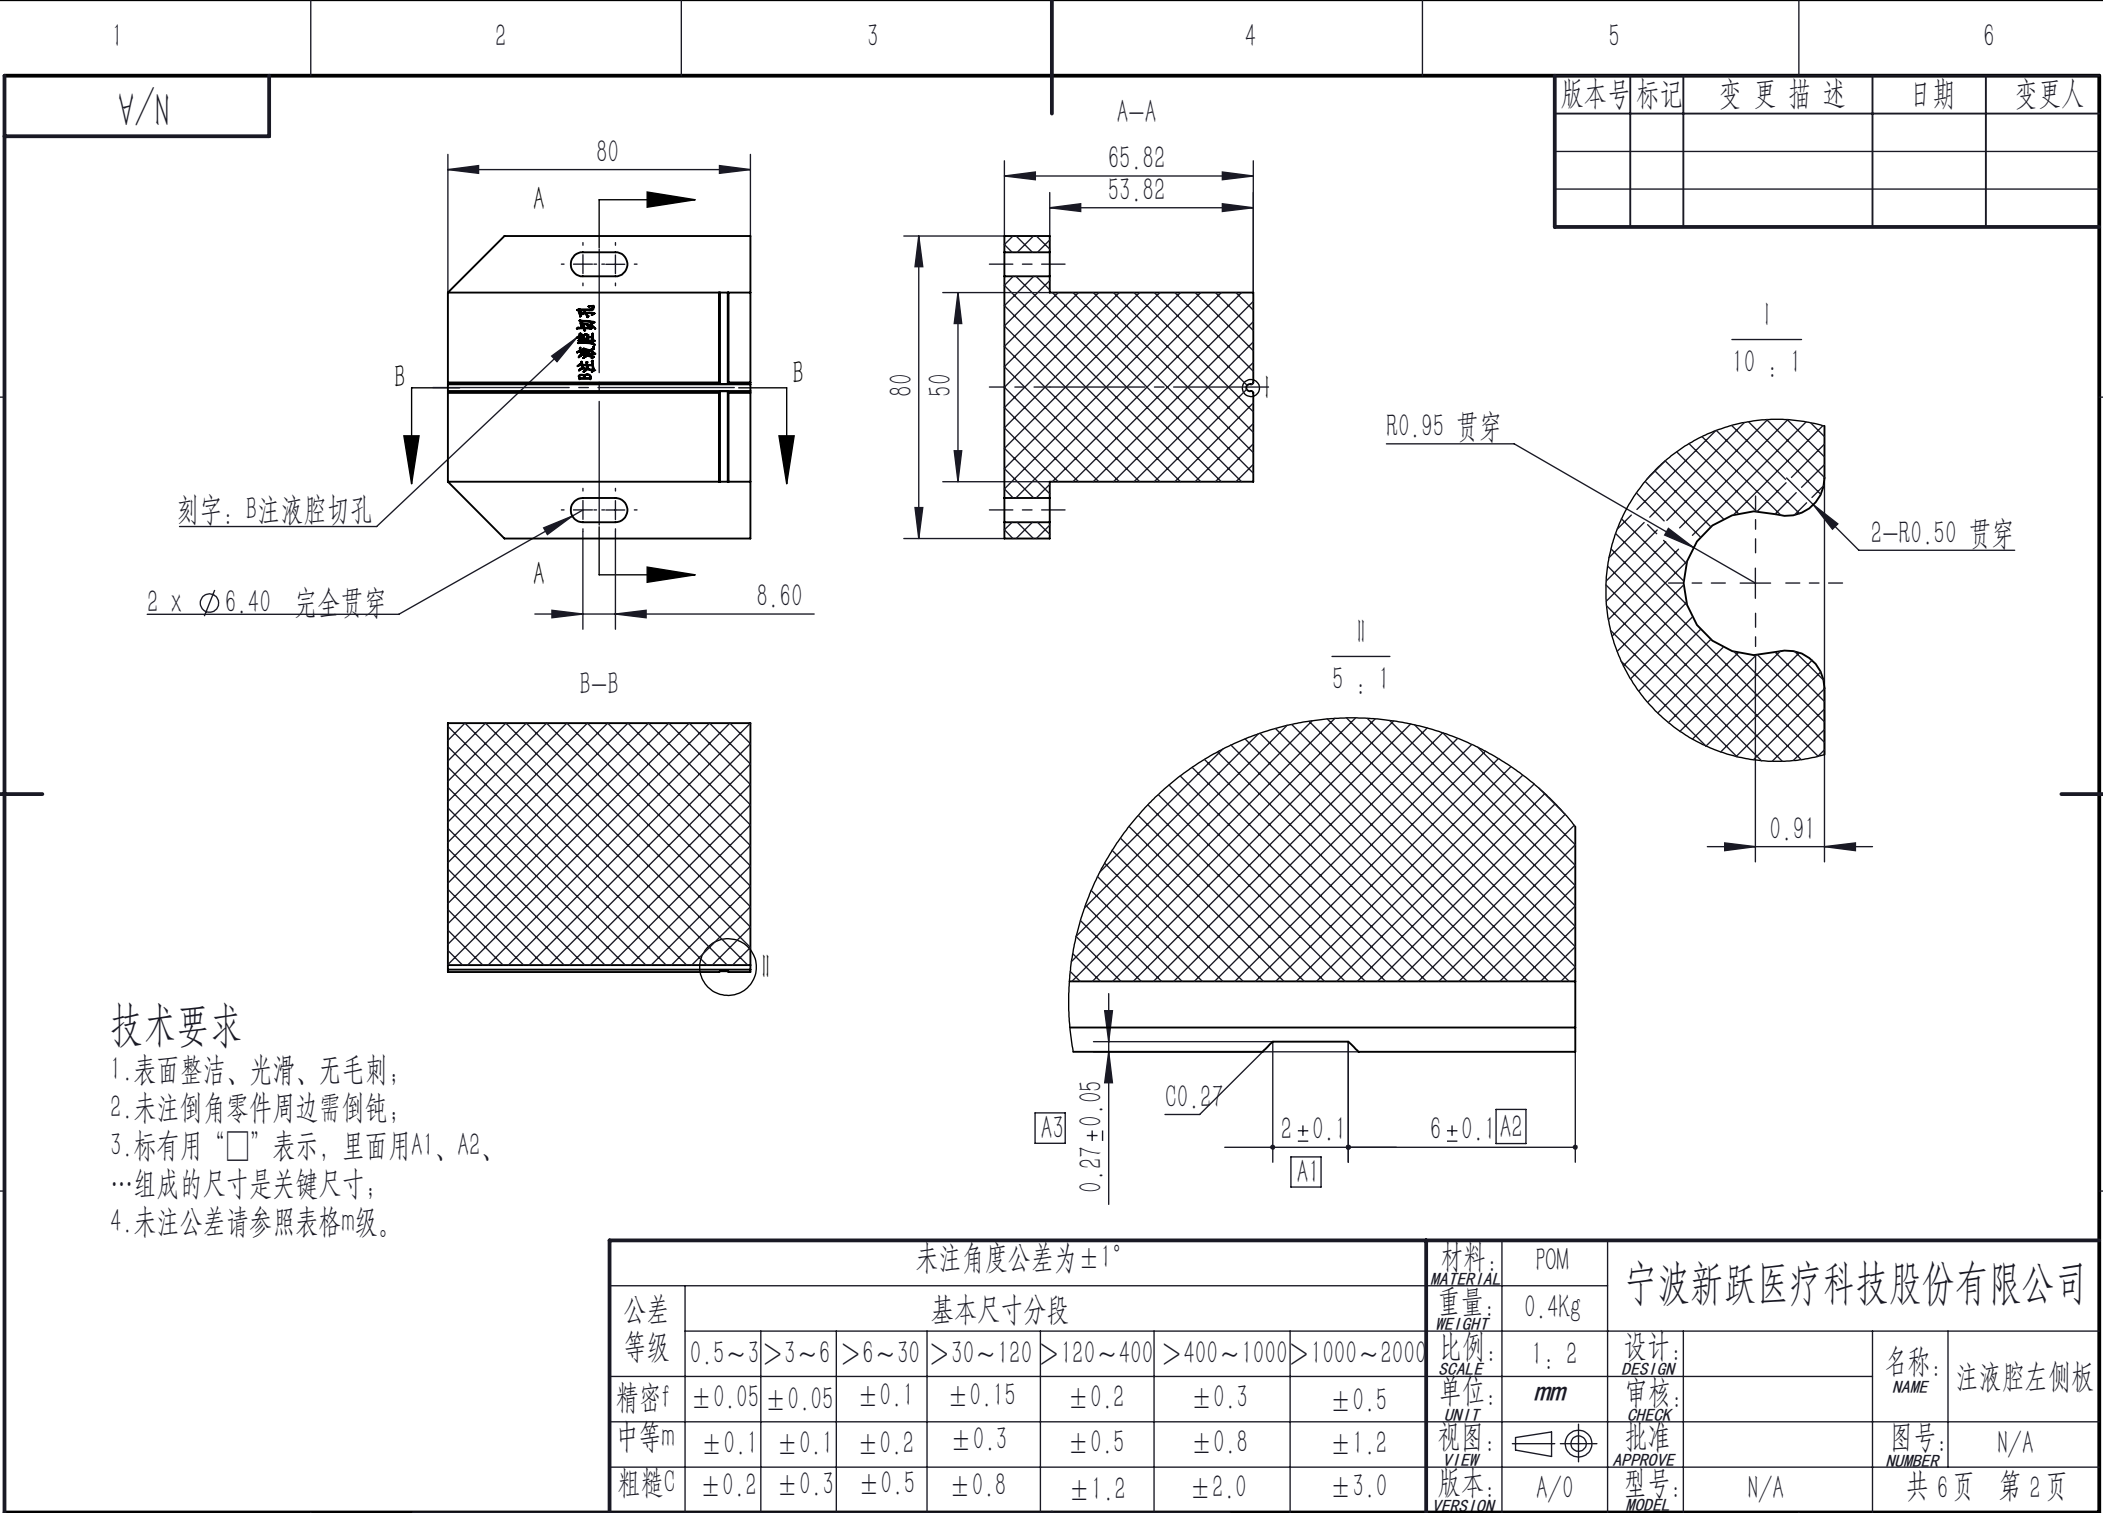
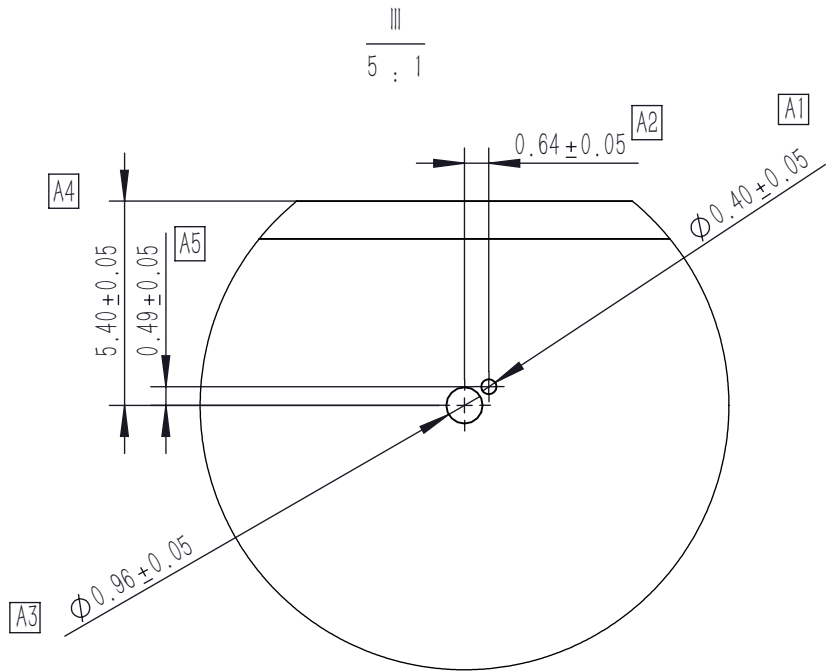
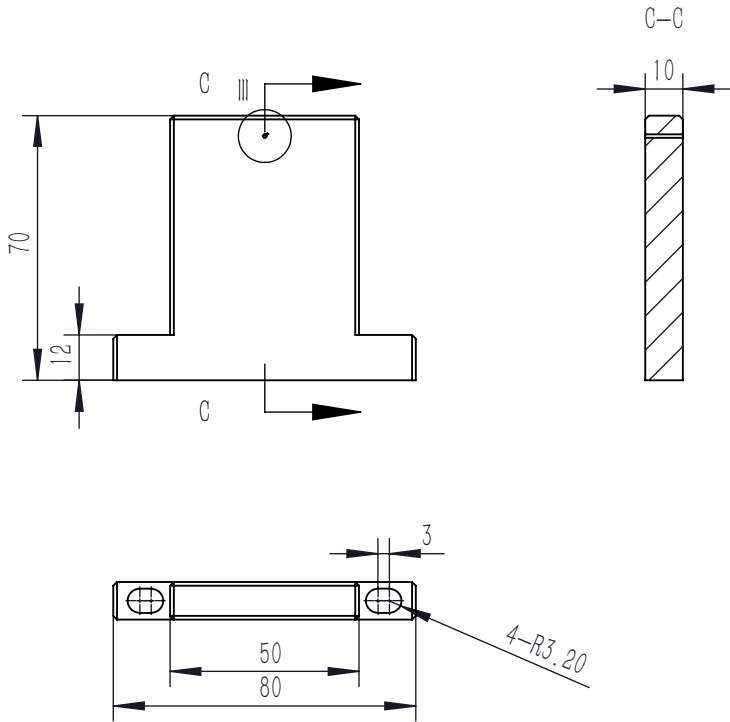


1		2		3		4		5		6																					
V/N		<table><tr><td>版本号</td><td>标记</td><td>变更描述</td><td>日期</td><td>变更人</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>										版本号	标记	变更描述	日期	变更人															
版本号	标记	变更描述	日期	变更人																											
																															
<p>技术要求:</p> <p>1.表面清洁，光滑，无毛刺；</p> <p>2.装配牢靠，气泡袋包裹包装；</p> <p>3.螺钉锁紧，根据实际情况选用螺钉型号。</p>																															
6	注液腔底座	1		未注角度公差为±1°				材料: MATERIAL	装配体	宁波新跃医疗科技股份有限公司																					
4	注液腔切孔0.89支撑丝	1		基本尺寸分段				重量: WEIGHT	1.1Kg																						
3	注液腔切孔0.35支撑丝	1		公差等级	0.5~3	>3~6	>6~30	>30~120	>120~400			>400~1000	>1000~2000	比例: SCALE	1:2	设计: DESIGN		名称: NAME	注液孔切孔工装												
2	注液腔切孔右侧板	1												精密f	±0.05	±0.05	±0.1	±0.15	±0.2	±0.3	±0.5	单位: UNIT	mm	审核: CHECK							
1	注液腔左侧板	1												中等m	±0.1	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	视图: VIEW		批准: APPROVE		图号: NUMBER	N/A				
项目号	零件号	数量	备注											粗糙C	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	±3.0	版本: VERSION	A/0	型号: MODEL		共6页	第1页				
1		2		3		4		5		6																					



1	2	3	4	5	6			
V/A				版本号	标记	变更描述	日期	变更人

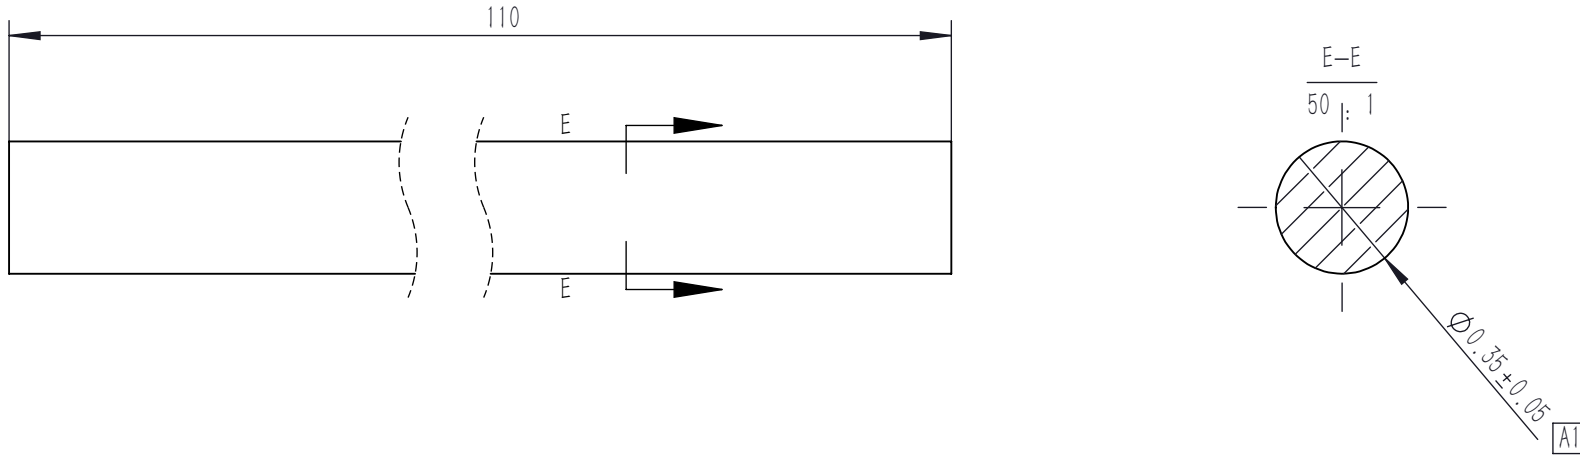


### 技术要求

- 表面整洁、光滑、无毛刺；
- 未注倒角零件周边需倒钝；
- 标有用“□”表示，里面用A1、A2、…组成的尺寸是关键尺寸；
- 未注公差请参照表格m级。

未注角度公差为±1°								材料:	304	宁波新跃医疗科技股份有限公司			
基本尺寸分段								重量:	0.3Kg				
公差等级	0.5~3	>3~6	>6~30	>30~120	>120~400	>400~1000	>1000~2000	比例:	1:2	设计:		名称:	注液腔切口右挡板
精密f	±0.05	±0.05	±0.1	±0.15	±0.2	±0.3	±0.5	单位:	mm	审核:		图号:	N/A
中等m	±0.1	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	视图:		批准:		型号:	N/A
粗糙C	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	±3.0	版本:	A/0	批准:		共 6 页	第 3 页

1		2		3		4		5		6		
V/N								版本号	标记	变更描述	日期	变更人

1		2		3		4		5		6		
V/N								版本号	标记	变更描述	日期	变更人
												
技术要求												
1.表面整洁、光滑、无毛刺；												
2.未注倒角零件周边需倒钝；												
3.标有用“□”表示，里面用A1、A2、												
…组成的尺寸是关键尺寸；												
4.未注公差请参照表格m级。												

