

1

2

3

4


5

6

Z06C00000302

版本号	标记	变更描述	日期	变更人

A

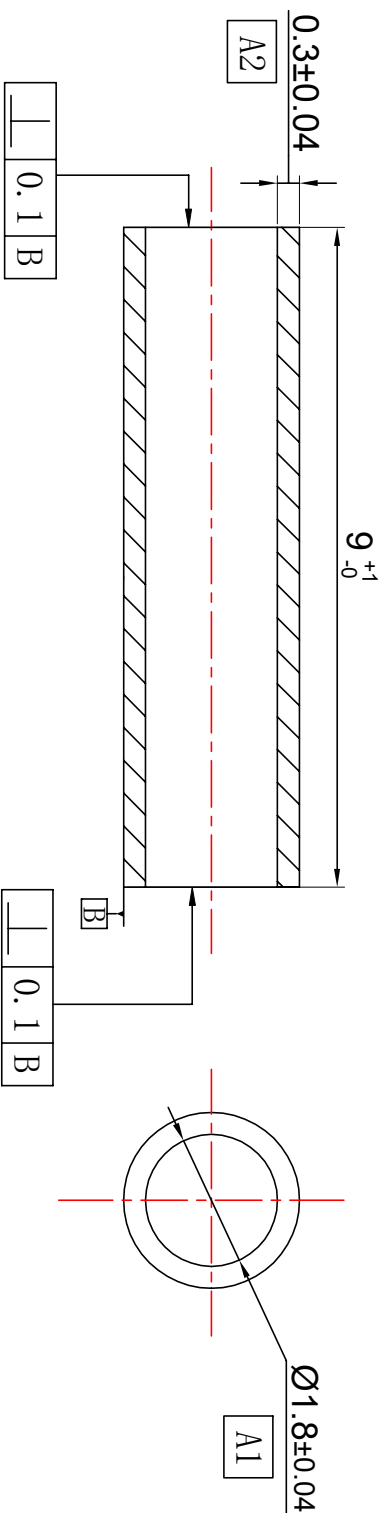

B

### 技术要求

- 材料为天然乳胶；
- 清洁度：产品内外表面应保证清洁，无任何粉尘油污等；
- 外观：室内光线下进行标准检验，要求膨胀前和注入5ml空气膨胀后（反复膨胀恢复10次）全长表面平整、均匀、无凸起、凹陷或孔洞等缺陷，两端切口平整，与外柱面垂直；
- 包装：囊体需双层包装供货，球囊需放在防紫外线的包装物中运输和存储；
- 存储：囊体存储环境温度需在 $25\pm 2^{\circ}\text{C}$ ，相对湿度需低于80%；
- 零件需在10万级及以上净化区环境清洗并采用双层密封包装；
- 图中带“A1、A2……”为关键尺寸；
- 物料编码为3000000302。

C

D

未注角度公差为 $\pm 1^{\circ}$						材料	天然乳胶	宁波新跃医疗科技股份有限公司			
基本尺寸分段						重量					
公差等级	0.5~3	>3~6	>6~30	>30~120	>120~400	>400~1000	>1000~2000	比例	10:1	设计	名称
精密f	$\pm 0.05$	$\pm 0.05$	$\pm 0.1$	$\pm 0.15$	$\pm 0.2$	$\pm 0.3$	$\pm 0.5$	单位	mm	审核	囊体 (15)
中等m	$\pm 0.1$	$\pm 0.1$	$\pm 0.2$	$\pm 0.3$	$\pm 0.5$	$\pm 0.8$	$\pm 1.2$	视图		批准	图号
粗糙c	$\pm 0.2$	$\pm 0.3$	$\pm 0.5$	$\pm 0.8$	$\pm 1.2$	$\pm 2$	$\pm 3$	版本号	A/0	型号	共 1 页
								VERSION		MODEL	第 1 页

C

B

A

D