

# 中山醫學大學附設醫院

| 主題名稱   | 腦室外引流管護理<br>Nursing Care of External Ventricular Drainage |     |        |      |                 |
|--------|-----------------------------------------------------------|-----|--------|------|-----------------|
| 編號     | A31000-Q02-W-C14                                          | 制定者 | SI 柯亦芳 | 公布日期 | 99 年 04 月 20 日  |
| 制定單位   | 護理部                                                       | 核准者 | 吳姿蓉    | 修正日期 | 108 年 06 月 18 日 |
| 版本/總頁數 | 第 3.4 版/6 頁                                               | 審查者 | 劉俞均    | 檢閱日期 | 114 年 06 月 05 日 |

## 一、目的

護理人員能正確操作腦室外引流管護理。

## 二、範圍

護理部各單位（含中興分院）。

## 三、說明

### （一）技術目的

- 1.監測腦脊髓液引流的量、顏色及性狀。
- 2.維持引流管的通暢及監測顱內壓。

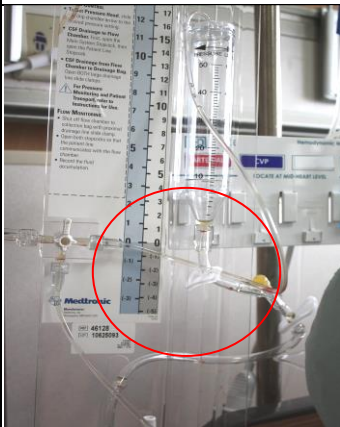
### （二）用物準備：

- 1.Pressure monitor、壓力模組及導線 1 套。
- 2.Pressure kit 1 套。
- 3.N/S 250ml 1 瓶。

### （三）步驟及要點說明

| 步驟                        | 說明                                   |
|---------------------------|--------------------------------------|
| 腦室引流的高度測量及固定              |                                      |
| 1.定出零點。                   | 眼框外緣至外耳道的中點，即側腦室位置，即零點對應位置。          |
| 2.依醫囑將引流管出口調整至所需高度。       |                                      |
| 引流液的測量                    |                                      |
| 1.每小時監測儲液管中腦脊髓液之量、顏色及性質。  | 正常腦脊髓液為澄清透明，若黃色或混濁考慮有感染，淡紅色則可能是顱內出血。 |
| 2.洗手。                     |                                      |
| 3.將引流管（3way(off)調至病人端）關閉。 | 以防止傾倒時引流液逆流，造成感染。                    |

|      |                  |      |         |        |     |
|------|------------------|------|---------|--------|-----|
| 主題名稱 | 腦室外引流管護理         | 制定單位 | 護理部     |        |     |
| 編號   | A31000-Q02-W-C14 | 版本   | 第 3.4 版 | 頁碼/總頁數 | 2/6 |

| 步驟                                | 說明                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.記錄儲液管中引流量並打開管夾使儲液管中引流液流入下方之引流袋。 |  <p>以利下一次的引流量的統計。</p>                                                                  |
| 5.每班統計腦脊髓液引流量（大夜班統計全日之引流量）。       |                                                                                                                                                                          |
| 6.記錄。                             | 記錄引流液之量、性狀、顏色。                                                                                                                                                           |
| 顱內壓監測                             |                                                                                                                                                                          |
| 1.準備用物。                           | <p>1.將 250ml 生理食鹽水（不加壓）接上壓力傳換組。</p> <p>2.接上壓力模組，並採無菌技術予以排氣。</p> <p>3.將空心蓋換上實心蓋。</p>  |
| 2.將壓力傳換組接上腦壓監測引流管版面。              |                                                                                      |

|      |                  |      |         |        |     |
|------|------------------|------|---------|--------|-----|
| 主題名稱 | 腦室外引流管護理         | 制定單位 | 護理部     |        |     |
| 編號   | A31000-Q02-W-C14 | 版本   | 第 3.4 版 | 頁碼/總頁數 | 3/6 |

| 步驟                                                                                                           | 說明                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 3.調整 dome（感應器）高度。                                                                                            | dome（感應器）高度需與腦壓監測引流管版面之零點及眼眶外緣與中耳道連線之中點（即側腦室）平行等高。 |
| 4.將壓力傳換組感應器的 3way(off)轉向病人端關閉，打开通大氣端活塞，讓感應器通大氣端歸零（按下 zero 鍵直到機器顯示出已歸零動作即可）將大氣端活塞關閉，並將 3way(off)轉向大氣端，使病人端通暢。 |                                                    |
| 5.觀察顱內壓的波形並記錄顱內壓數值。                                                                                          | 顱內壓(Intracranial Pressure;ICP)正常值：0-15mmHg。        |

#### （四）異常狀況處理說明

| 異常狀況                                                               | 處理對策                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 滑脫：<br>腦室外引流管滑脫（包含自拔）可能原因：因病人意識不清、躁動、不適等因素造成滑脫或自拔，或不小心拉扯、膠布固定不佳引起。 | 1. 評估病人狀況，並於傷口處以紗布加壓。<br>2. 通知醫師。<br>3. 醫師評估腦室外引流管是否重新放置。<br>4. 評估病人是否有相關合併症及生命徵象、<br>5. 血壓及意識變化。<br>6. 評估約束的必要性。<br>7. 於 HIS 系統完成異常事件通報。 |
| 阻塞：<br>腦室外引流管阻塞可能原因：血塊塞住，三路活塞病人端未開。                                | 1. 檢查整條管路開關是否正確，如正確可能為血塊塞住，則立即通知醫師。<br>2. 如三路活塞病人端未開，則給予打開並須時常注意三路活塞之開關處。                                                                 |
| 折曲：<br>腦室外引流管折曲可能原因：反折和纏繞。                                         | 1. 評估是否病人壓迫到，重新調整位置。<br>2. 評估是否為包紮傷口時反折和纏繞在紗布裡，重新調整位置並包紮。                                                                                 |
| 拔錯：<br>可能原因為：未使用兩種以上方式執行病人辨識，造成拔錯管路。                               | 1. 評估病人狀況，是否需做立即處理。<br>2. 評估是否需重新放置。<br>3. 於 HIS 系統完成異常事件通報。                                                                              |
| 感染：可能原因為手術時感染、密閉系統被破壞。                                             | 1. 如病人有發燒應立即報告醫師並處理。<br>2. 醫師評估是否拔除。                                                                                                      |

#### （五）注意事項

- 1.引流袋不可擠壓或腦壓監測引流管裝置低於頭部，以免造成逆行性感染。
- 2.病人改變床頭高度時，務必將開關關上或調整腦壓監測引流管裝置，以免造成引流量過多或引流液逆流。

|      |                  |      |         |        |     |
|------|------------------|------|---------|--------|-----|
| 主題名稱 | 腦室外引流管護理         | 制定單位 |         | 護理部    |     |
| 編號   | A31000-Q02-W-C14 | 版本   | 第 3.4 版 | 頁碼/總頁數 | 4/6 |

#### (六) 實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

### 四、使用表單

(略)

### 五、流程圖

(略)

### 六、參考資料

- (一) 周守民、陳真瑗(2005)·神經外科專科護理·台北：匯華。
- (二) 林素玉、周翠蓉、陳蕙玲(2012)·照顧一位車禍導致頭部創傷引發蜘蛛膜下腔出血個案之加護護理經驗·澄清醫護管理雜誌，(8)2，45-53。
- (三) 劉雅絃、蘇桂榛、黃惠美、張嘉貞(2013)·提升加護病房護理人員腦室外引流裝置護理及顱內壓測量法的完整率·安泰醫護雜誌，(19)4，39-49。

### 七、附件

(略)

|      |                  |      |         |        |     |
|------|------------------|------|---------|--------|-----|
| 主題名稱 | 腦室外引流管護理         | 制定單位 | 護理部     |        |     |
| 編號   | A31000-Q02-W-C14 | 版本   | 第 3.4 版 | 頁碼/總頁數 | 5/6 |

## 八、文件修正紀錄

| 修正日期      | 版本  | 修正說明                                                                                      | 備註                                                                                             |
|-----------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 99.04.20  | 1.0 | 新制定。                                                                                      | 99 年 04 月 20 日<br>護理部照護標準<br>委員會通過。                                                            |
| 99.08.31  | 2.0 | 配合本院 SOP 格式改版。                                                                            |                                                                                                |
| 101.06.06 | 2.1 | 增加步驟及要點說明與修辭。                                                                             | 101 年 06 月 06 日<br>護理部照護標準<br>委員會通過。                                                           |
| 102.02.26 | 3.0 | 配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行年度臨時檢閱。                                                               |                                                                                                |
| 102.06.05 | 3.1 | 目的部份修辭。                                                                                   | 102 年 06 月 05 日<br>護理部照護標準<br>委員會通過。                                                           |
| 103.06.30 | 3.1 | 年度檢閱，無修正。版本不變動。                                                                           |                                                                                                |
| 104.06.02 | 3.2 | 1. 第三項第（四）目異常狀況處理說明刪除：填寫異常處置表及病安通報、填寫管路自拔／滑脫意外事件收集表；改為~於 HIS 系統完成異常事件通報。<br>2. 新增第六項參考資料。 | 104 年 06 月 02 日<br>護理部照護標準<br>委員會通過。                                                           |
| 105.06.07 | 3.3 | 1. 第三項第（四）目異常狀況處理說明部份內容修正。<br>2. 引流液測量 3.圖示改至 4.圖示。<br>3. 顱內壓監測 4.圖示刪除。                   | 105 年 06 月 07 日<br>護理部照護標準<br>委員會通過。                                                           |
| 106.06.05 | 3.3 | 年度檢閱，無修正。版本不變動。                                                                           |                                                                                                |
| 107.06.04 | 3.3 | 年度檢閱，無修改。版本不變動。                                                                           |                                                                                                |
| 108.06.06 | 3.4 | 1. 第二項新增（含中興分院）。<br>2. 第三項第六目本辦法經委員會通過後公布實施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。                      | 108 年 06 月 06 日<br>照護標準組會議<br>通過；108 年 06<br>月 12 日護理長會<br>議通過；108 年<br>06 月 18 日督導會<br>議通過公布。 |

|      |                  |      |         |        |     |
|------|------------------|------|---------|--------|-----|
| 主題名稱 | 腦室外引流管護理         | 制定單位 |         | 護理部    |     |
| 編號   | A31000-Q02-W-C14 | 版本   | 第 3.4 版 | 頁碼/總頁數 | 6/6 |

| 修正日期      | 版本  | 修正說明            | 備註 |
|-----------|-----|-----------------|----|
| 109.06.04 | 3.4 | 年度檢閱，無修正。版本不變動。 |    |
| 110.07.08 | 3.4 | 年度檢閱，無修正。版本不變動。 |    |
| 111.06.02 | 3.4 | 年度檢閱，無修正。版本不變動。 |    |
| 112.06.08 | 3.4 | 年度檢閱，無修正。版本不變動。 |    |
| 113.04.30 | 3.4 | 年度檢閱，無修正。版本不變動。 |    |
| 114.06.05 | 3.4 | 年度檢閱，無修正。版本不變動。 |    |
|           |     |                 |    |
|           |     |                 |    |
|           |     |                 |    |
|           |     |                 |    |
|           |     |                 |    |
|           |     |                 |    |
|           |     |                 |    |
|           |     |                 |    |
|           |     |                 |    |
|           |     |                 |    |