

高质量 / 高精度 / 高可靠性的比较测量工具

- 刻度值为 0.01mm 的标准刻度盘带有一个外径为 $\varnothing 57\text{mm}$ 的前框。所有的标准型都带有限值爪和锁紧装置。
- 锁紧装置和测杆提升杆 (选件) 可装在左侧或右侧, 这些零件可轻易组装而不需要借助工具。
- 表盘和表蒙使用 O 型圈紧密黏合, 可保证表盘面有效防水及防油。
- 高强度淬火不锈钢测杆, 适于高强度测量。
- 硬质合金测针。
- 不锈钢冠形齿轮不易损坏和变形。
- 表蒙采用加硬涂层, 具有良好的高度防划和耐化学腐蚀性能。



2046S

2046S-09



2047S



29025



A Mitutoyo dial indicator with a circular scale ranging from 0 to 100 divisions. The main scale has markings every 10 divisions (0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 0). The dial face includes the Mitutoyo logo and the text "DIAL INDICATOR". The needle is positioned at approximately 45 divisions.

2310S-10

 宝石轴承型



The image shows the dial of a Mitutoyo vernier caliper. The main scale is graduated in degrees from 0 to 90. The vernier scale is graduated in minutes of an arc. The reading is 0.02 mm.

2044S

☞ 防震型




2045S



三丰公司秉承持续创新向客户提供最新技术体验的理念。因此保留对产品的技术规格进行变更的权利。规格如有变更，恕不另行通知。

尺寸

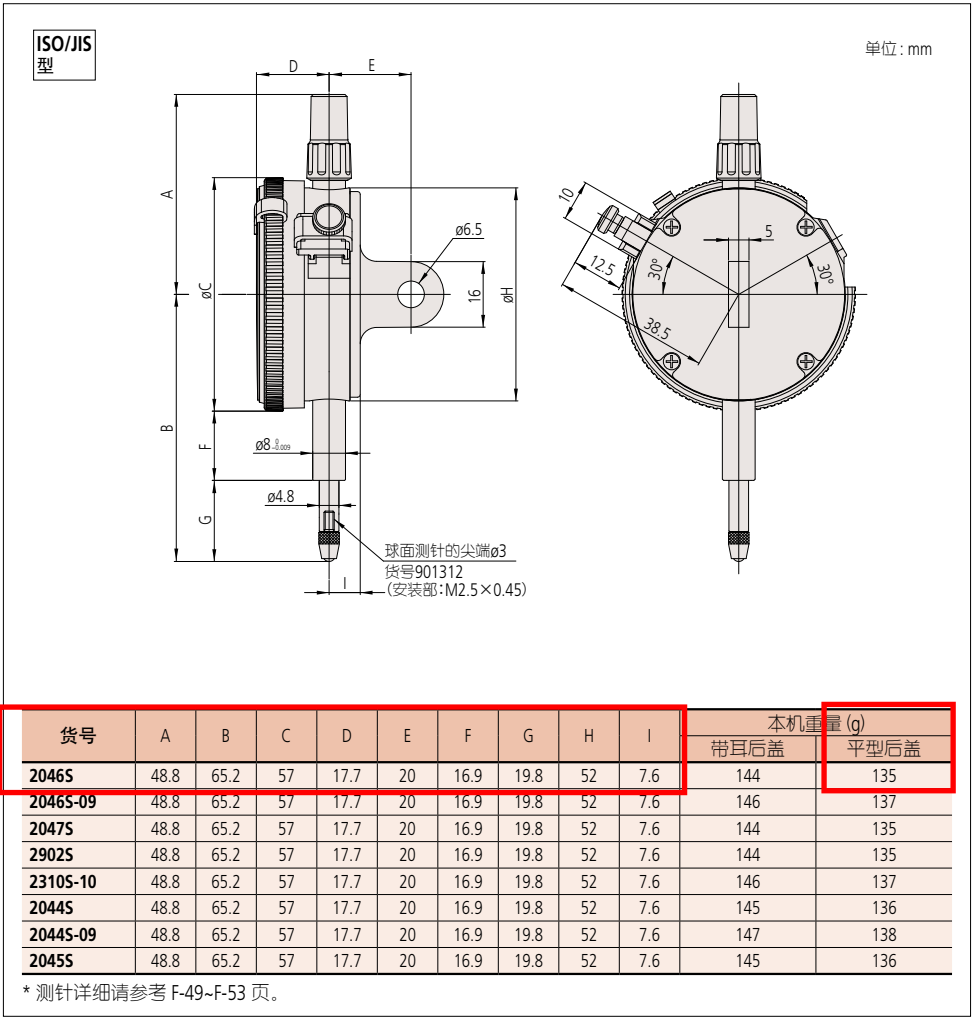

特点

货号									
带耳后盖	平型后盖								
2046S	2046SB	✓	—	—	—	—	—	—	✓
2046S-09	2046SB-09	✓	—	—	✓	—	—	—	—
2047S	2047SB	—	✓	—	—	—	—	—	✓
2902S	2902SB	—	—	✓	—	—	—	—	✓
2310S-10	2310SB-10	✓	—	—	—	—	✓	✓	—
2044S	2044SB	✓	—	—	—	—	—	—	—
2044S-09	2044SB-09	✓	—	—	✓	—	—	—	—
2045S	2045SB	—	✓	—	—	—	—	—	—

规格

货号		分度值	测量范围 (测量范围 / 每圈行程)	指示误差				重复精度	表盘 读数	测力
带耳后盖	平型后盖			全量程	返回	1/10 圈 行程	1 圈 行程			
2046S	2046SB	0.01mm	10mm (1mm)	13μm	3μm	5μm	10μm	3μm	±0-100	1.4N 以下
2046S-09	2046SB-09	0.01mm	10mm (1mm)	15μm	3μm	5μm	10μm	3μm	±0-100	1.4N 以下
2047S	2047SB	0.01mm	10mm (1mm)	13μm	3μm	5μm	10μm	3μm	0-50-0	1.4N 以下
2902S	2902SB	0.01mm	10mm (1mm)	13μm	3μm	5μm	10μm	3μm	100-0	1.4N 以下
2310S-10	2310SB-10	0.01mm	10mm (1mm)	15μm	3μm	5μm	10μm	3μm	±0-100	1.4N 以下
2044S	2044SB	0.01mm	5mm (1mm)	12μm	3μm	5μm	10μm	3μm	±0-100	1.4N 以下
2044S-09	2044SB-09	0.01mm	5mm (1mm)	12μm	3μm	5μm	10μm	3μm	±0-100	1.4N 以下
2045S	2045SB	0.01mm	5mm (1mm)	12μm	3μm	5μm	10μm	3μm	0-50-0	1.4N 以下

* 成品检查为纵向位置 (测针向下的位置) 进行可以保证精度。