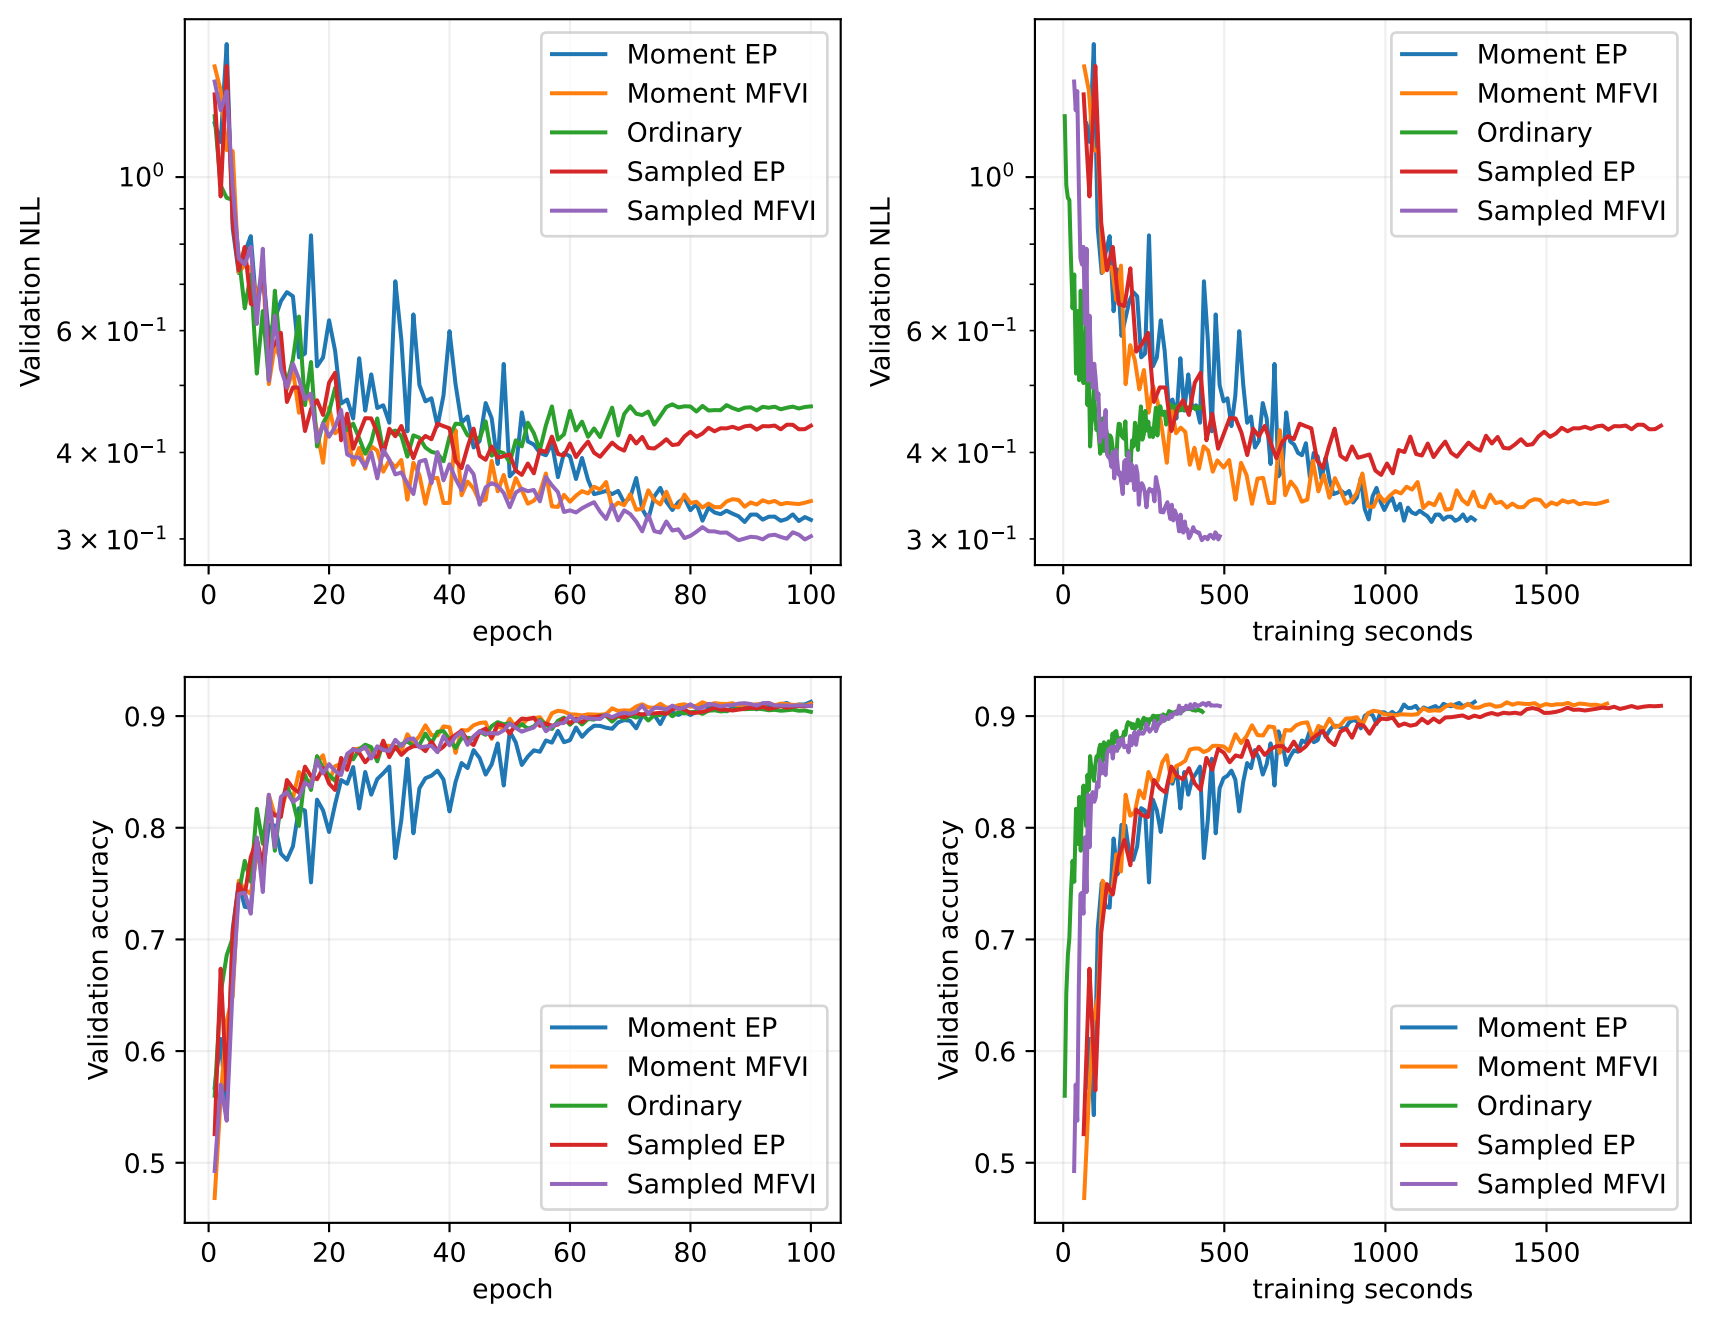
Validation NLL
10^0
6×10^{-1}
4×10^{-1}
3×10^{-1}
0
20
40
60
80
100
epoch
Moment EP
Moment MFVI
Ordinary
Sampled EP
Sampled MFVI
Validation NLL
10^0
6×10^{-1}
4×10^{-1}
3×10^{-1}
0
500
1000
1500
training seconds
Moment EP
Moment MFVI
Ordinary
Sampled EP
Sampled MFVI
Validation accuracy
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0
20
40
60
80
100
epoch
Moment EP
Moment MFVI
Ordinary
Sampled EP
Sampled MFVI
Validation accuracy
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0
500
1000
1500
training seconds
Moment EP
Moment MFVI
Ordinary
Sampled EP
Sampled MFVI