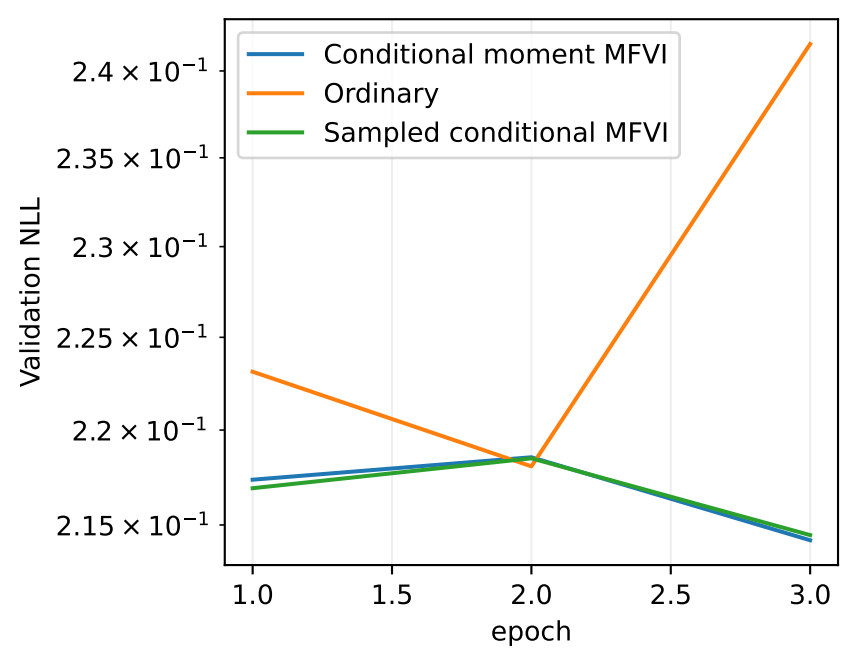
Conditional moment MFVI
Ordinary
Sampled conditional MFVI
Validation NLL
2.4×10^{-1}
2.35×10^{-1}
2.3×10^{-1}
2.25×10^{-1}
2.2×10^{-1}
2.15×10^{-1}
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
epoch

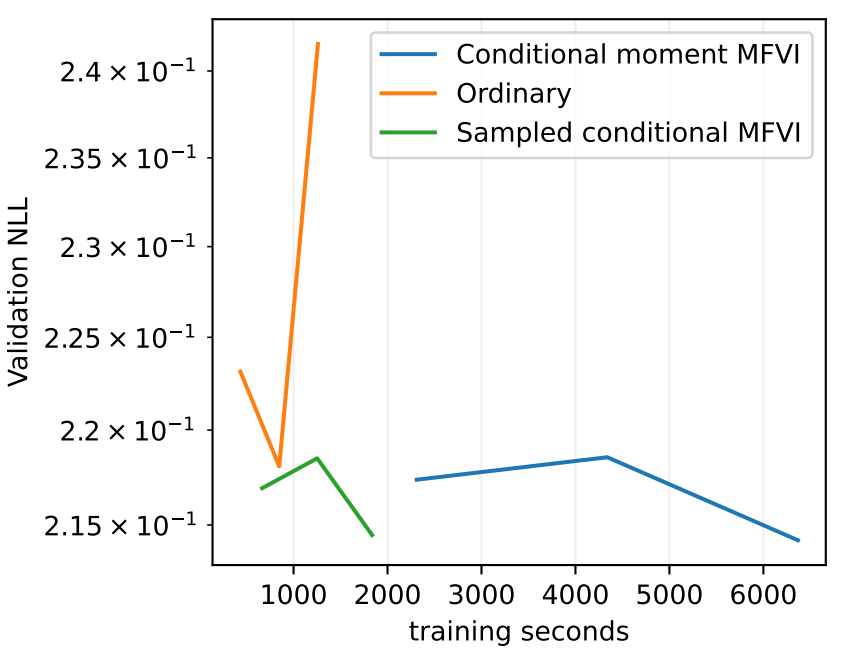
Conditional moment MFVI
Ordinary
Sampled conditional MFVI
Validation NLL
2.4×10^{-1}
2.35×10^{-1}
2.3×10^{-1}
2.25×10^{-1}
2.2×10^{-1}
2.15×10^{-1}
1000
2000
3000
4000
5000
6000
training seconds

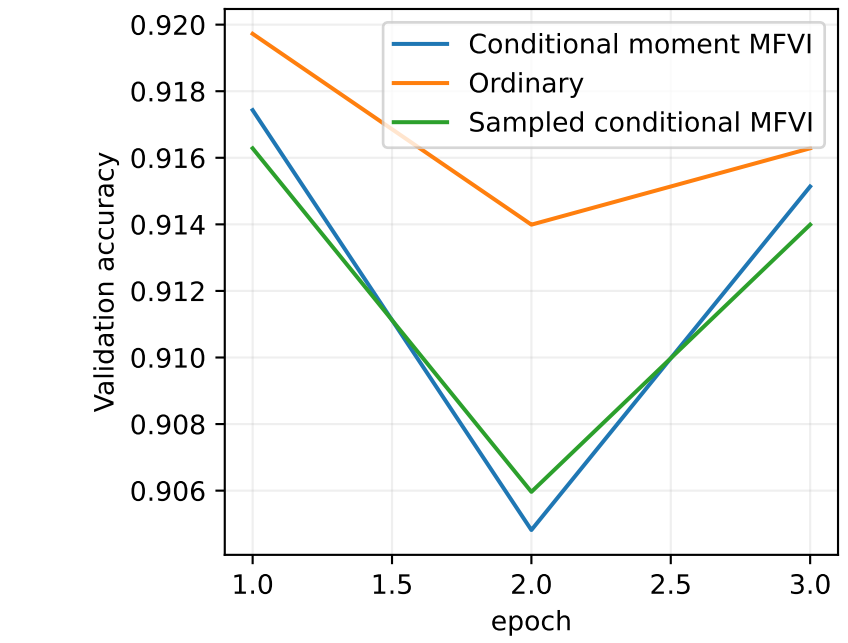
Conditional moment MFVI
Ordinary
Sampled conditional MFVI
Validation accuracy
0.920
0.918
0.916
0.914
0.912
0.910
0.908
0.906
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
epoch

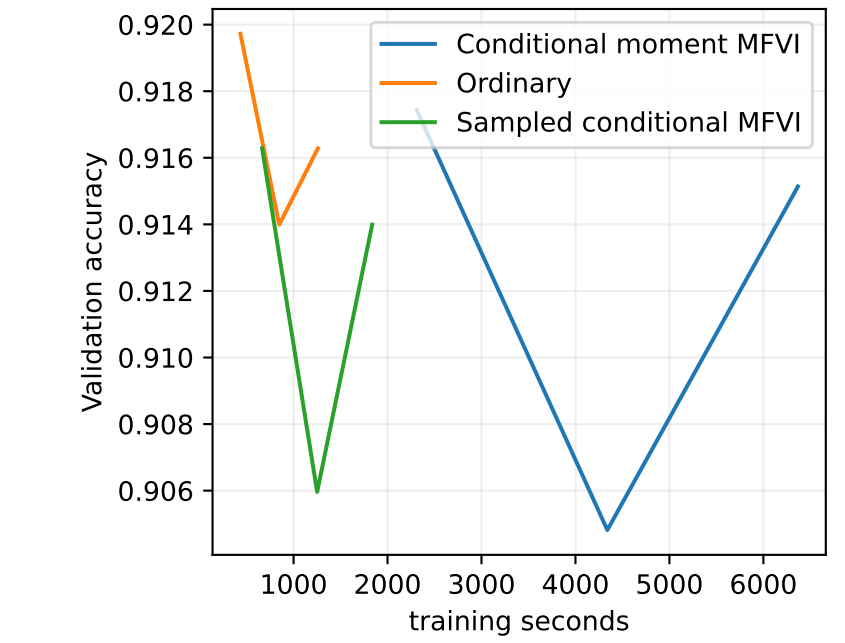
Conditional moment MFVI
Ordinary
Sampled conditional MFVI
Validation accuracy
0.920
0.918
0.916
0.914
0.912
0.910
0.908
0.906
1000
2000
3000
4000
5000
6000
training seconds