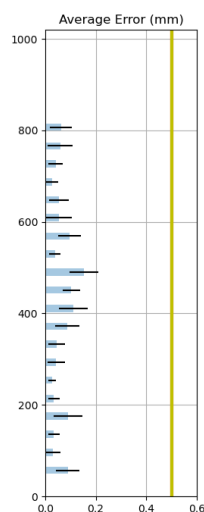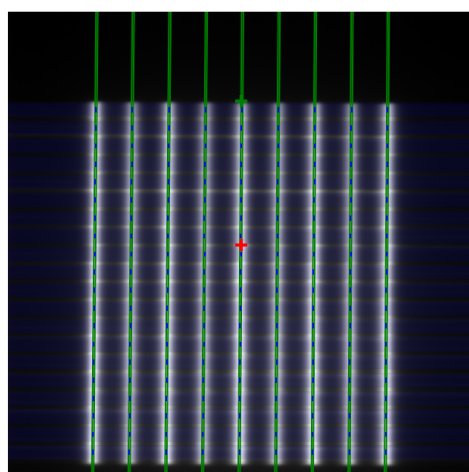# Picket Fence Analysis

Metadata:
Unidade: ICESP
Acelerador Linear: AL02
Modelo do MLC: MLCi2
Data do teste: 28/07/2020
Realizado por: William
Conferido por:

Picket Fence results:
Magnification factor (SID/SAD): 1.60
Tolerance (mm): 0.5
Leaves passing (%): 100.0
Absolute median error (mm): 0.046
Mean picket spacing (mm): 20.2
Max Error: 0.267 mm on Picket: 2, Leaf: 12
Gantry Angle: 0.00
Collimator Angle: 0.00

Notes:
Teste de deslocamento do painel■