





Picket Fence Analysis

Metadata:

Autor: William A. P. dos Santos
 Função: Físico
 Unidade: Hospital
 Acelerador Linear: Synergy Platform
 Modelo MLC: MLCi2

Picket Fence results:

Magnification factor (SID/SAD): 1.60
 Tolerance (mm): 0.5
 Leaves passing (%): 100.0
 Absolute median error (mm): 0.044
 Mean picket spacing (mm): 20.4
 Max Error: 0.167 mm on Picket: 1, Leaf: 24
 Gantry Angle: 0.00
 Collimator Angle: 0.00

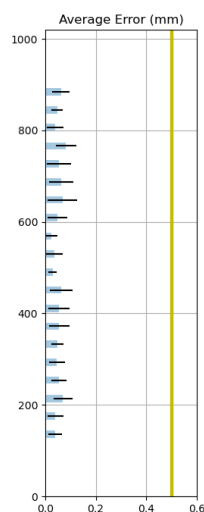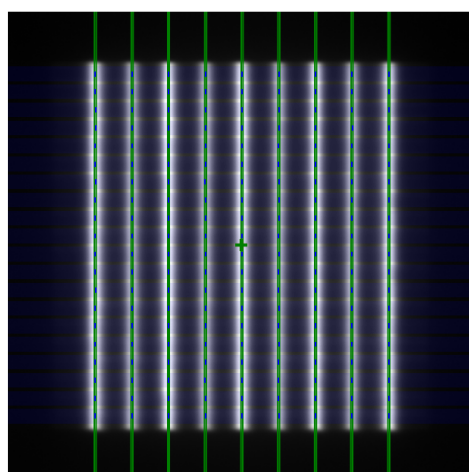

Notes:

Testando análise variação de MU e largura da faixa
 Campo 20 cm X 20 cm
 Largura da faixa = 5mm
 3MU