



Picket Fence Analysis

Metadata:

Autor: William A. P. dos Santos
Função: Físico
Unidade: Hospital
Acelerador Linear: Synergy Platform
Modelo MLC: MLCi2

Picket Fence results:

Magnification factor (SID/SAD): 1.60
Tolerance (mm): 1
Leaves passing (%): 100.0
Absolute median error (mm): 0.051
Mean picket spacing (mm): 20.3
Maximum error (mm): 0.258 on Picket 8, Leaf 14
Gantry Angle: 0.00
Collimator Angle: 0.00

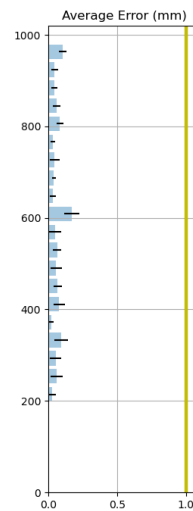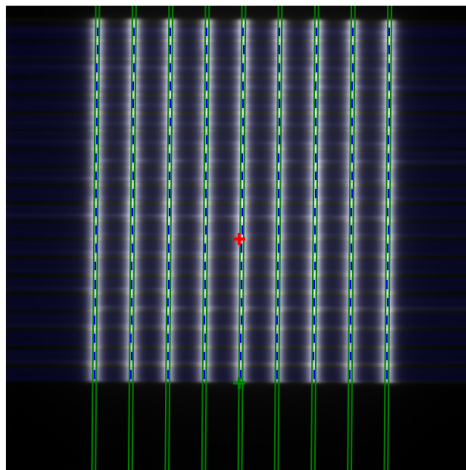

Notes:

Testando análise com deslocamento do painel
Análise da Imagem: 0Y2-20Y1
Deslocamento do painel em Y: 8.0 cm