





Picket Fence Analysis

Metadata:

Autor: William A. P. dos Santos
Função: Físico
Unidade: Hospital
Acelerador Linear: Synergy Platform
Modelo MLC: MLCi2

Picket Fence results:

Magnification factor (SID/SAD): 1.60
Tolerance (mm): 0.5
Leaves passing (%): 100.0
Absolute median error (mm): 0.042
Mean picket spacing (mm): 20.4
Max Error: 0.147 mm on Picket: 2, Leaf: 23
Gantry Angle: 0.00
Collimator Angle: 0.00

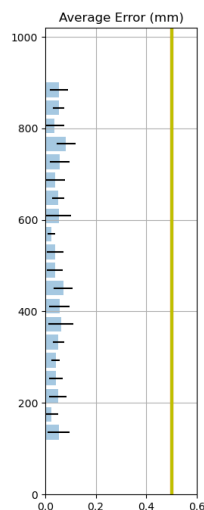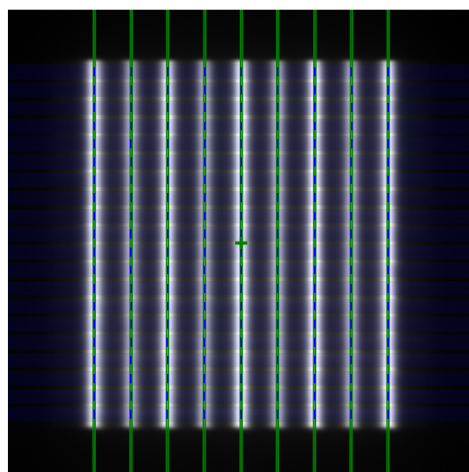

Notes:

Testando análise variação de MU e largura da faixa
Campo 20 cm X 20 cm
Largura da faixa = 6mm
3MU