

Picket Fence Analysis

Metadata:

Autor: William A. P. dos Santos

Função: Físico

Unidade: Hospital

Acelerador Linear: Synergy Platform

Modelo MLC: MLCi2

Picket Fence results:

Magnification factor (SID/SAD): 1.60

Tolerance (mm): 1

Leaves passing (%): 100.0

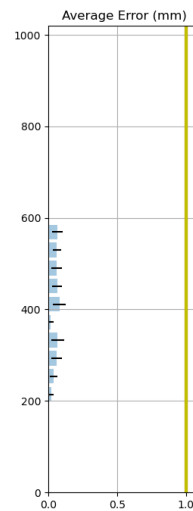
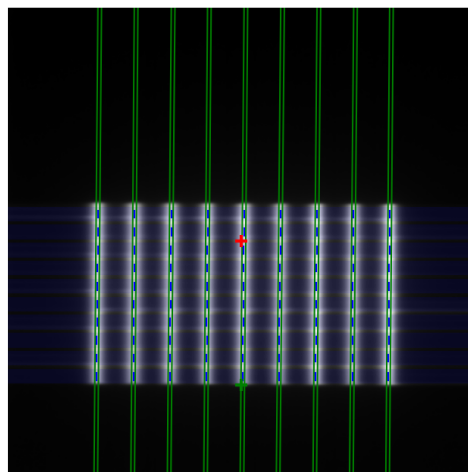
Absolute median error (mm): 0.047

Mean picket spacing (mm): 20.2

Maximum error (mm): 0.148 on Picket 8, Leaf 19

Gantry Angle: 0.00

Collimator Angle: 0.00

**Notes:**

Testando análise com deslocamento do painel

Análise da Imagem: 0Y2-10Y1

Deslocamento do painel em Y: 8.0 cm