


## Metadata:

Autor: William A. P. dos Santos  
Função: Físico  
Unidade: Hospital  
Acelerador Linear: Synergy Platform  
Modelo MLC: MLCi2

## Picket Fence results:

Magnification factor (SID/SAD): 1.60  
Tolerance (mm): 0.285  
Leaves passing (%): 99.5  
Absolute median error (mm): 0.056  
Mean picket spacing (mm): 20.3  
Maximum error (mm): 0.286 on Picket 1, Leaf 15  
Gantry Angle: 0.00  
Collimator Angle: 0.00

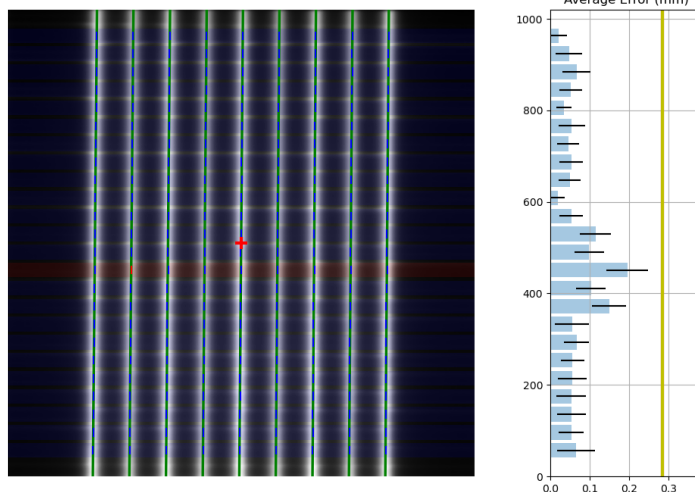

## Notes:

Testando análise com deslocamento do painel  
Campo 26 cm X 6 cm - Assimétrico em Y  
Y1 = 6 cm e Y2 = 20 cm  
Lâminas 1 e 26 não foram incluídas na análise