





Picket Fence Analysis

Metadata:

Unidade: ICESP
Acelerador Linear: AL02
Modelo do MLC: MLCi2
Data do teste: 28/07/2020
Realizado por: William
Conferido por:

Picket Fence results:

Magnification factor (SID/SAD): 1.60
Tolerance (mm): 0.5
Leaves passing (%): 98.1
Absolute median error (mm): 0.070
Mean picket spacing (mm): 20.3
Max Error: 3.332 mm on Picket: 3, Leaf: 20
Gantry Angle: 0.00
Collimator Angle: 0.00

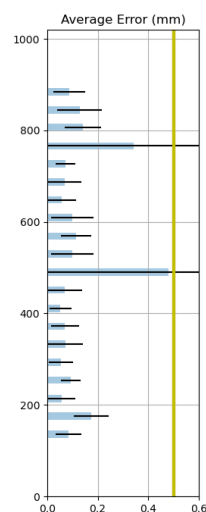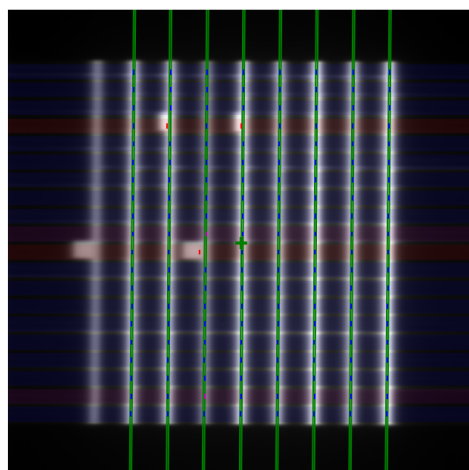

Notes:

Teste de deslocamento do painel