



# Picket Fence Analysis

## Metadata:

Autor: William A. P. dos Santos

Função: Físico

Unidade: Hospital

Acelerador Linear: Synergy Platform

Modelo MLC: MLCi2

## Picket Fence results:

Magnification factor (SID/SAD): 1.60

Tolerance (mm): 0.5

Leaves passing (%): 100.0



Absolute median error (mm): 0.042

Mean picket spacing (mm): 20.4

Max Error: 0.169 mm on Picket: 2, Leaf: 26

Gantry Angle: 0.00

Collimator Angle: 0.00

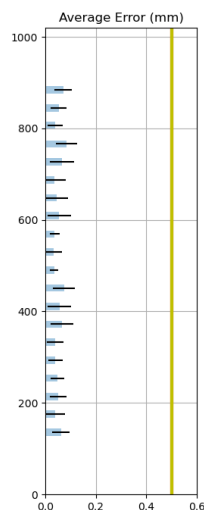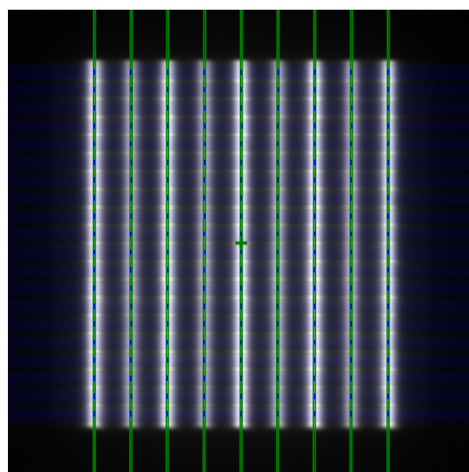

## Notes:

Testando análise variação de MU e largura da faixa

Campo 20 cm X 20 cm

Largura da faixa = 6mm

2MU