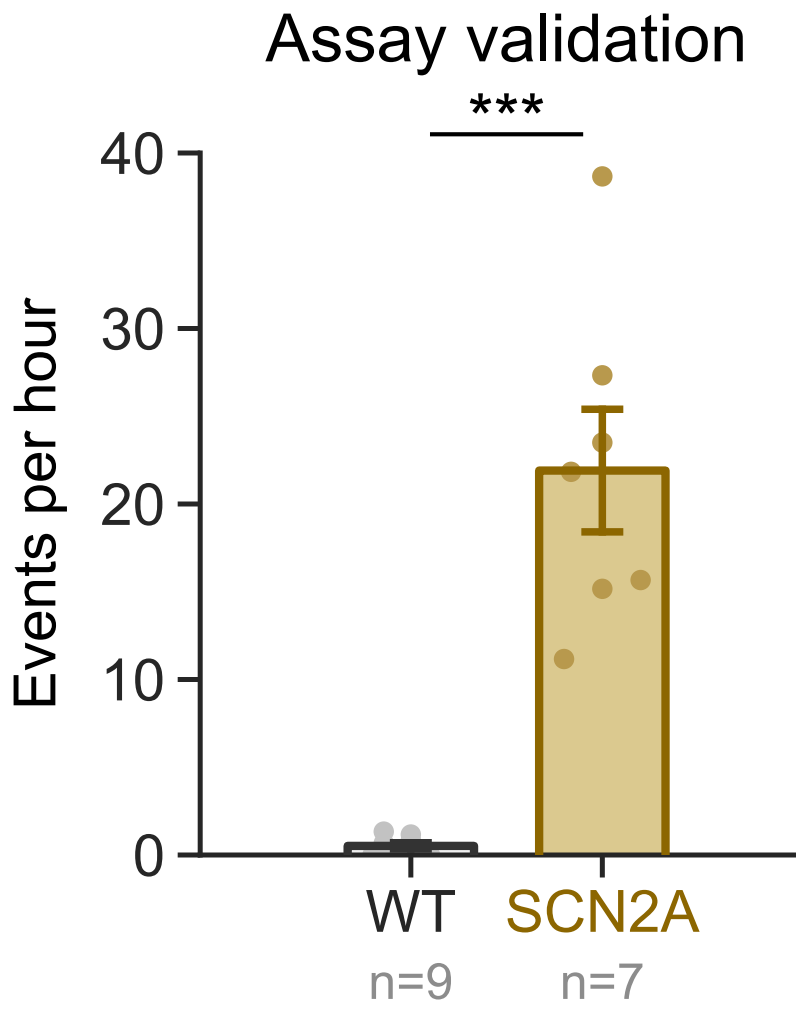
Assay validation
***
40
30
20
10
0
Events per hour
WT
SCN2A
n=9
n=7