

	GESTIÓN DE LA CALIDAD CERTIFICADO DE MANTENIMIENTO Y VERIFICACIÓN	PS – Fo – 06 VERSIÓN No. 2
---	--	---

San Pedro, Mayo 22 del 2024

No. 180-05-2024

CERTIFICADO DE MANTENIMIENTO Y VERIFICACIÓN:

Mediante la presente: **ELECTROBÁSCULAS Y BALANZAS S.A.S**, hace constar que se le realizó procedimientos de mantenimiento y verificación y ajuste de los pesos a todas las básculas de planta de piso, de pesaje bulto y bajo perfil hasta de 3 toneladas de la empresa : **CALFERQUIM Nit. 815.000.541-1**.
Estas básculas se ajustaron con pesas patrón certificadas.


Se realizan pruebas de :

- Repetibilidad
- Error de indicación
- Excentricidad

Se entrega orden de trabajo PS-Fo-01 No. 910-05-2024 y formato guía Sim PS-Fo-05, con los datos tomados.

Es de anotar que estas básculas quedaron en óptimas condiciones de Pesaje y se ajustó su peso con pesas patrón certificadas por un laboratorio avalado por la ONAC. Código de pesas: 57094-C, 58808-C, 59417-C.

Cordialmente

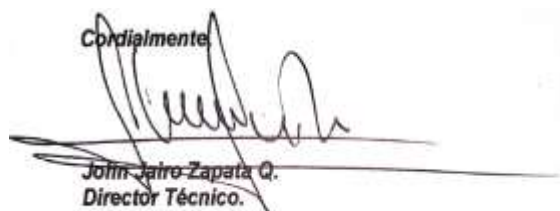

John Jairo Zapata Q.
Director Técnico.

	GESTIÓN DE LA CALIDAD FORMATO GUIA SIM	PS – Fo – 05 VERSIÓN No. 7
--	--	--------------------------------------

Fecha: 22 de mayo del 2024. Orden de Trabajo N°: 910-05- 2024
 Empresa: CALFERQUIM Dirección: SAN PEDRO - VALLE
 Indicador de Medida: DIGITAL ☒ ANÁLOGO DIGITAL ☐
 Sistema de Funcionamiento: MECÁNICO ☐ ELECTRÓNICO ☒ ELECTROMECAÁNICO ☐
 Instrumento: Báscula de Piso Cap.Máxima : 30000 kg Cap.Mínima: 10 kg División: 500 g
 AF: N.A Código: 0463 Marca: PROMETÁLICOS Modelo: PRO-2010 Serie: N.I
 Desviación Estándar: 500 g Desviación Lineal: 500 g EMP(Ex): 1Kg
 Ubicación: PLANTA PRODUCCIÓN BIG BAG Patrón (clase): _____
 Códigos Pesas Patrón Utilizados: 57094-C , 58808-C , 59417-C , _____ , _____ , _____

REVISIÓN TÉCNICA									
Condiciones Estructura		CONDICIONES SISTEMA DE SUSPENSIÓN				CONDICIONES TRASMISIÓN DE PESO E INDICACIÓN			
Puertas ()	Parales ()	Soportes ()	Tornillería (B)		Indicador Digital (B)	Cables (B)			
Marco ()	Topes ()	Patás (B)	Zapatás ()		Brazo Mecánico ()	Celdas (B)			
Perfiles ()	Corrajea ()	Bastidor ()	Trapecios ()		Conectores (B)	Otros ()			
Empalmes ()	Plataforma (B)	Ventanas ()	Balines ()		Palancas Principales ()				
		Bancos ()	Cojinetes ()		Palancas centrales ()				
Bueno (B) Regular (R) Malo (M)									
ALIMENTACIÓN REGULADOR	CARGADORES EXTERNOS	Medición Milivoltajes de Celdas							
	V dc 9vdc	Celda #1	Celda#2	Celda#3	Celda#4	Celda#5	Celda #6	Celda #7	Celda #8
	V ac								
	Estado (B)								

PRUEBAS DE AJUSTE Y VERIFICACIÓN:

1. PRUEBA DE EXCENRICIDAD DE CARGA

Punto	Indicación Kg g mg	Error Kg g mg
1	300.0	0
2	300.0	0
3	300.0	0
4	300.0	0
5	300.0	0

CUMPLE: SI ☒ NO ☐



2.PRUEBA DE REPETIBILIDAD

Carga	400 Kg
Repetición	Indicación Kg g mg
1	400.0
2	400.0
3	400.0
4	400.0


CUMPLE: SI ☒ NO ☐



3.PRUEBA DE LINEALIDAD

Cargas Kg g mg	Indicación Kg g mg	Error Kg g mg
10	10.0	0
20	20.0	0
100	100.0	0
200	200.0	0
300	300.0	0
400	400.0	0

CUMPLE: SI ☒ NO ☐



Informe Estado del Equipo :

Se ajusta peso con pesas patrón Certificadas, básculas queda en óptimas condiciones de pesaje.
Limpieza general. Se ajusta -500g en 420kg. Se instalan 6metros de cable de celda nuevo y conector nuevo.
Suministro de cargador 9v.
Técnico: <u>John Jairo Zapata Lozano c.c.94.520.888</u>

	GESTIÓN DE LA CALIDAD FORMATO GUIA SIM	PS – Fo – 05 VERSIÓN No. 7
--	--	--------------------------------------

Fecha: 22 DE MAYO DEL 2024 Orden de Trabajo N°: 910 -05- 2024

Empresa: CALFERQUIM Dirección: SAN PEDRO - VALLE

Indicador de Medida: DIGITAL ☒ ANÁLOGO DIGITAL ☐

Sistema de Funcionamiento: MECÁNICO ☐ ELECTRÓNICO ☒ ELECTROMECAÁNICO ☐

Instrumento: Báscula de Piso Cap.Máxima : 600 kg Cap.Mínima: 2 kg División: 100 g

AF: N.A Código: 0465 Marca: SUPER SS Modelo: XK3101SS Serie: N.I

Desviación Estándar: 100 g Desviación Lineal: 100 g EMP(Ex): 200g

Ubicación: MEZCLAS Patrón (clase): M1

Códigos Pesas Patrón Utilizados: 57094-C , 58808-C , 59417-C , _____ , _____ , _____

REVISIÓN TÉCNICA									
Condiciones Estructura		CONDICIONES SISTEMA DE SUSPENSIÓN		CONDICIONES TRASMISIÓN DE PESO E INDICACIÓN					
Puertas ()	Parales ()	Soportes ()	Tornillería (B)	Indicador Digital (B)	Cables (B)				
Marco ()	Topes ()	Patas (B)	Zapatas ()	Brazo Mecánico ()	Celdas (B)				
Perfiles ()	Corrales ()	Bastidor ()	Trapezoides ()	Conectores (B)	Otros ()				
Empalmes ()	Plataforma (B)	Ventanas ()	Balines ()	Palancas Principales ()					
		Bancos ()	Cojinetes ()	Palancas centrales ()					
Bueno (B) Regular (R) Malo (M)									
ALIMENTACION REGULADOR	CARGADORES EXTERNOS	Medición Milivoltajes de Celdas							
110 a.c	V dc	Celda #1	Celda#2	Celda#3	Celda#4	Celda#5	Celda #6	Celda #7	Celda #8
	V ac								
	Estado (B)								

PRUEBAS DE AJUSTE Y VERIFICACIÓN:

1. PRUEBA DE EXCENRICIDAD DE CARGA

Punto	Indicación Kg g mg	Error Kg g mg
1	40.0	0
2	40.0	0
3	40.0	0
4	40.0	0
5	40.0	0


CUMPLE: SI ☒ NO ☐



2.PRUEBA DE REPETIBILIDAD

Carga	100 Kg
Repetición	Indicación Kg g mg
1	100.0
2	100.0
3	100.0
4	100.0


CUMPLE: SI ☒ NO ☐



3.PRUEBA DE LINEALIDAD

Cargas Kg g mg	Indicación Kg g mg	Error Kg g mg
5	5.0	0
20	20.0	0
40	40.0	0
60	60.0	0
80	80.0	0
100	100.0	0

CUMPLE: SI ☒ NO ☐



Informe Estado del Equipo :

Se verifica báscula de piso con pesas patrón. Se realiza ajuste de peso con pesas patrón certificadas.
Quedando en óptimas condiciones de pesaje. Se realiza limpieza interna. Se ajusta +100g en 100kg.
Técnico que realiza mantenimiento: <u>John Jairo Zapata Lozano c.c.94.520.888</u>

	GESTIÓN DE LA CALIDAD FORMATO GUIA SIM	PS – Fo – 05 VERSIÓN No. 7
--	--	--------------------------------------

Fecha: 22 DE MAYO DEL 2024
Orden de Trabajo N°: 910-05- 2024

Empresa: CALFERQUIM
Dirección: SAN PEDRO - VALLE

Indicador de Medida: DIGITAL ☒ ANÁLOGO DIGITAL ☐

Sistema de Funcionamiento: MECÁNICO ☐ ELECTRÓNICO ☒ ELECTROMECAÁNICO ☐

Instrumento: Báscula de Piso
Cap.Máxima : 100 kg
Cap.Mínima: 2 kg
División: 100 g

AF: N.A
Código: 0464
Marca: SUPER SS
Modelo: XK3101SS
Serie: N.I

Desviación Estándar: 100 g
Desviación Lineal: 100 g
EMP(Ex): 200g

Ubicación: MEZCLAS
Patrón (clase): M1

Códigos Pesas Patrón Utilizados: 57094-C , 58808-C , 59417-C , _____ , _____ , _____

REVISIÓN TÉCNICA									
Condiciones Estructura		CONDICIONES SISTEMA DE SUSPENSIÓN				CONDICIONES TRASMISIÓN DE PESO E INDICACIÓN			
Puertas ()	Parales ()	Soportes ()	Tornillería (B)		Indicador Digital (B)	Cables (B)			
Marco ()	Topes ()	Patás (B)	Zapatás ()		Brazo Mecánico ()	Celdas (B)			
Perfiles ()	Corraleja ()	Bastidor ()	Trapeacios ()		Conectores (B)	Otros ()			
Empalmes ()	Plataforma (B)	Ventanas ()	Balines ()		Palancas Principales ()				
		Bancos ()	Cojinetes ()		Palancas centrales ()				
Bueno (B) Regular (R) Malo (M)									
ALIMENTACION REGULADOR	CARGADORES EXTERNOS	Medición Milivoltajes de Celdas							
110 a.c	V dc	Celda #1	Celda#2	Celda#3	Celda#4	Celda#5	Celda #6	Celda #7	Celda #8
	V ac								
	Estado (B)								

PRUEBAS DE AJUSTE Y VERIFICACIÓN:

1. PRUEBA DE EXCENRICIDAD DE CARGA

Punto	Indicación Kg g mg	Error Kg g mg
1	20.0	0
2	20.0	0
3	20.0	0
4	20.0	0
5	20.0	0


CUMPLE: SI ☒ NO ☐



2.PRUEBA DE REPETIBILIDAD

Carga	100 Kg
Repetición	Indicación Kg g mg
1	100.0
2	100.0
3	100.0
4	100.0


CUMPLE: SI ☒ NO ☐



3.PRUEBA DE LINEALIDAD

Cargas Kg g mg	Indicación Kg g mg	Error Kg g mg
5	5.0	0
20	20.0	0
40	40.0	0
60	60.0	0
80	80.0	0
100	100.0	0

CUMPLE: SI ☒ NO ☐



Informe Estado del Equipo :

Se verifica báscula de piso con pesas patrón. Se realiza ajuste de peso con pesas patrón certificadas.
Quedando en óptimas condiciones de pesaje. Limpieza interna. Se ajustó -200g en 60kg.
Técnico: <u>John Jairo Zapata Lozano c.c.94.520.888</u>

	GESTIÓN DE LA CALIDAD FORMATO GUIA SIM	PS – Fo – 05 VERSIÓN No. 7
--	--	--------------------------------------

Fecha: 22 DE MAYO DEL 2024
Orden de Trabajo N°: 910-05- 2024

Empresa: CALFERQUIM
Dirección: SAN PEDRO - VALLE

Indicador de Medida: DIGITAL ☒ ANÁLOGO DIGITAL ☐

Sistema de Funcionamiento: MECÁNICO ☐ ELECTRÓNICO ☒ ELECTROMECAÁNICO ☐

Instrumento: Báscula de Piso
Cap.Máxima : 100 kg
Cap.Mínima: 2 kg
División: 100 g

AF: N.A
Código: N.I
Marca: NABA
Modelo: MAXTER SS
Serie: N.I

Desviación Estándar: 100 g
Desviación Lineal: 100 g
EMP(Ex): 200g

Ubicación: ALISTAMIENTO
Patrón (clase): M1

Códigos Pesas Patrón Utilizados: 57094-C , 58808-C , 59417-C , _____ , _____ , _____

REVISIÓN TÉCNICA											
Condiciones Estructura		CONDICIONES SISTEMA DE SUSPENSIÓN		CONDICIONES TRASMISIÓN DE PESO E INDICACIÓN							
Puertas ()	Parales ()	Soportes ()	Tornilleria (B)	IndicadorDigital (B)		Cables (B)					
Marco ()	Topes ()	Patás (B)	Zapatás ()	Brazo Mecánico ()		Celdas (B)					
Perfiles ()	Corraleja ()	Bastidor ()	Trapecios ()	Conectores (B)		Otros ()					
Empalmes()	Plataforma(B)	Ventanas ()	Balines ()	Palancas Principales ()							
		Bancos ()	Cojinetes ()	Palancas centrales ()							
Bueno (B) Regular (R) Malo (M)											
ALIMENTACION REGULADOR		CARGADORES EXTERNOS		Medición Milivoltajes de Celdas							
110 a.c		V dc		Celda #1	Celda#2	Celda#3	Celda#4	Celda#5	Celda #6	Celda #7	Celda #8
		V ac									
		Estado (B)									

PRUEBAS DE AJUSTE Y VERIFICACIÓN:

1. PRUEBA DE EXCENRICIDAD DE CARGA

Punto	Indicación Kg g mg	Error Kg g mg
1	40.0	0
2	40.0	0
3	40.0	0
4	40.0	0
5	40.0	0


CUMPLE: SI ☒ NO ☐



2.PRUEBA DE REPETIBILIDAD

Carga	100 Kg
Repetición	Indicación Kg g mg
1	100.0
2	100.0
3	100.0
4	100.0


CUMPLE: SI ☒ NO ☐



3.PRUEBA DE LINEALIDAD

Cargas Kg g mg	Indicación Kg g mg	Error Kg g mg
5	5.0	0
20	20.0	0
40	40.0	0
60	60.0	0
80	80.0	0
100	100.0	0

CUMPLE: SI ☒ NO ☐



Informe Estado del Equipo :

Se verifica báscula de piso con pesas patrón. Se realiza ajuste de peso con pesas patrón certificadas.
Quedando en óptimas condiciones de pesaje. Limpieza interna. Se suministra cargador nuevo.
Técnico: <u>John Jairo Zapata Lozano c.c.94.520.888</u>

	GESTIÓN DE LA CALIDAD FORMATO GUIA SIM	PS – Fo – 05 VERSIÓN No. 7
--	--	--------------------------------------

Fecha: 22 DE MAYO DEL 2024 Orden de Trabajo N°: 910 - 05- 2024
 Empresa: CALFERQUIM Dirección: SAN PEDRO - VALLE
 Indicador de Medida: DIGITAL ☒ ANÁLOGO DIGITAL ☐
 Sistema de Funcionamiento: MECÁNICO ☐ ELECTRÓNICO ☒ ELECTROMECAÁNICO ☐
 Instrumento: Báscula de Piso Cap.Máxima : 1500 kg Cap.Mínima: 10 kg División: 500 g
 AF: N.A Código: 0293 Marca: LP Modelo: 7510A Serie: N.I
 Desviación Estándar: 500 g Desviación Lineal: 500 g EMP(Ex): 1Kg
 Ubicación: DESPACHOS BIG BAG Patrón (clase): _____
 Códigos Pesas Patrón Utilizados: 57094-C , 58808-C , 59417-C , _____ , _____ , _____

REVISION TECNICA										
Condiciones Estructura		CONDICIONES SISTEMA DE SUSPENSIÓN				CONDICIONES TRASMISIÓN DE PESO E INDICACIÓN				
Puertas ()	Parales ()	Soportes ()	Tornilleria (B)		IndicadorDigital (B)		Cables (B)			
Marco ()	Topes ()	Patas ()	Zapatas ()		Brazo Mecánico ()		Celdas (B)			
Perfiles ()	Corraleja ()	Bastidor ()	Trapecios ()		Conectores (B)		Otros ()			
Empalmes()	Plataforma(B)	Ventanas ()	Balines ()		Palancas Principales ()					
		Bancos ()	Cojinetes ()		Palancas centrales ()					
Bueno (B) Regular (R) Malo (M)										
ALIMENTACION REGULADOR	CARGADORES EXTERNOS		Medición Milivoltajes de Celdas							
	V dc	9vdc	Celda #1	Celda#2	Celda#3	Celda#4	Celda#5	Celda #6	Celda #7	Celda #8
	V ac									
	Estado (B)									

PRUEBAS DE AJUSTE Y VERIFICACIÓN:

1. PRUEBA DE EXCENRICIDAD DE CARGA

Punto	Indicación Kg g mg	Error Kg g mg
1	300.0	0
2	300.0	0
3	300.0	0
4	300.0	0
5	300.0	0


CUMPLE: SI ☒ NO ☐



2.PRUEBA DE REPETIBILIDAD

Carga	300 Kg
Repetición	Indicación Kg g mg
1	300.0
2	300.0
3	300.0
4	300.0


CUMPLE: SI ☒ NO ☐



3.PRUEBA DE LINEALIDAD

Cargas Kg g mg	Indicación Kg g mg	Error Kg g mg
5	5.0	0
20	20.0	0
100	100.0	0
200	200.0	0
300	300.0	0
420	420.0	0

CUMPLE: SI ☒ NO ☐



Informe Estado del Equipo :

Se verifica báscula de piso con pesas patrón. Se realiza ajuste de peso con pesas patrón certificadas.
Limpieza general. Se ajustó -1kg en 420kg y se renueva conector redondo.
Técnico: <u>John Jairo Zapata Lozano c.c.94.520.888</u>

	GESTIÓN DE LA CALIDAD FORMATO GUIA SIM	PS – Fo – 05 VERSIÓN No. 7
--	--	--------------------------------------

Fecha: 22 DE MAYO DEL 2024 Orden de Trabajo N°: 910 – 05 - 2024
 Empresa: CALFERQUIM Dirección: SAN PEDRO - VALLE
 Indicador de Medida: DIGITAL ☒ ANÁLOGO DIGITAL ☐
 Sistema de Funcionamiento: MECÁNICO ☐ ELECTRÓNICO ☒ ELECTROMECAÁNICO ☐
 Instrumento: Báscula de Piso Cap.Máxima : 1500 kg Cap.Mínima: 10 kg División: 500 g
 AF: N.A Código: 0294 Marca: TRUMAX Modelo: MATRIX Serie: N.I
 Desviación Estándar: 500 g Desviación Lineal: 500 g EMP(Ex): 1Kg
 Ubicación: BODEGA Patrón (clase): M1
 Códigos Pesas Patrón Utilizados: 57094-C , 58808-C , 59417-C , _____ , _____ , _____

REVISIÓN TÉCNICA											
Condiciones Estructura		CONDICIONES SISTEMA DE SUSPENSIÓN				CONDICIONES TRASMISIÓN DE PESO E INDICACIÓN					
Puertas ()	Parales ()	Soportes ()	Tornillería (B)		Indicador Digital (B)	Cables (B)					
Marco ()	Topes ()	Patás (B)	Zapatás ()		Brazo Mecánico ()	Celdas (B)					
Perfiles ()	Corraleja ()	Bastidor ()	Trapecios ()		Conectores (B)	Otros ()					
Empalmes ()	Plataforma (B)	Ventanas ()	Balines ()		Palancas Principales ()						
		Bancos ()	Cojinetes ()		Palancas centrales ()						
Bueno (B) Regular (R) Malo (M)											
ALIMENTACION REGULADOR		CARGADORES EXTERNOS		Medición Milivoltajes de Celdas							
110 a.c		V dc		Celda #1	Celda#2	Celda#3	Celda#4	Celda#5	Celda #6	Celda #7	Celda #8
		V ac									
		Estado (B)									

PRUEBAS DE AJUSTE Y VERIFICACIÓN:

1. PRUEBA DE EXCENRICIDAD DE CARGA

Punto	Indicación Kg g mg	Error Kg g mg
1	260.0	0
2	260.0	0
3	260.0	0
4	260.0	0
5	260.0	0


CUMPLE: SI ☒ NO ☐



2.PRUEBA DE REPETIBILIDAD

Carga	300 Kg
Repetición	Indicación Kg g mg
1	300.0
2	300.0
3	300.0
4	300.0

CUMPLE: SI ☒ NO ☐



3.PRUEBA DE LINEALIDAD

Cargas Kg g mg	Indicación Kg g mg	Error Kg g mg
20	20.0	0
100	100.0	0
200	200.0	0
300	300.0	0
420	420.0	0

CUMPLE: SI ☒ NO ☐



Informe Estado del Equipo :

Se realiza ajuste de peso con pesas patrón certificadas, quedando en óptimas condiciones de pesaje.
Se ajusta -500g en 420kg.
Técnico: <u>John Jairo Zapata Lozano c.c.94.520.888</u>