

生产任务通知单

任务编号：TS20221102

1，订单类型：

☒客户订单（荧飒内部订单号：SIN17622）☐自用研发项目☐样机☐其它

2，配置类型：

类别（销售勾选）	<input type="checkbox"/> 标准品	<input checked="" type="checkbox"/> 标准品修改	<input type="checkbox"/> 非标品
非标品选项	（商务申请后勾选） <input type="checkbox"/> 邱亚 <input type="checkbox"/> 郑留念		
	（出厂时设计人员及测试人员 提供数据给梦瑶，更新至公盘）	尺寸：	
		重量：	
		其他说明：	

3，任务信息

录入日期	2022-11-2	答交时间	2022-12-20
客户名称	北京科瑞泰德有限公司	销售姓名	王伟
合同号码	ISP20221102	产 品 线	中红外
生产型号	FOLI20(对应 IR-9000 MAX)	数 量	1
序 列 号	MSN220060	是否出口	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是

4，设备外观说明（他方定制类要求需填写《INSA-JL04-12 客户定制化外观平面设计需求单 A1》）

1) LOGO 要求：	
2) 机身型号：	IR-9000 MAX
3) 铭牌打印型号：	IR-9000 MAX
4) 其他说明：	和第一台的外形、颜色相同，详细见后，黄磊有固定色号

5，硬件生产配置

序号	型号/物料号	数量	描述	备注
1)	FOLI20	1	红外主机（KBr 分束器，DLaTGS 检测器，分辨率 0.4cm-1	Spectral Range: 8,000-350cm-1 Wavenumber precision: Better than 0.01cm-1 Photometric precision: Better than 0.1 % T Signal to Noise: 40000:1

				Main Size: 850×590×316mm Sample Compartment Size:255×255×168mm
2)	XD105/2	1	Switch of the second detector for Foli20, DLaTGS 和 MCT 检测器自动切换	
3)	D-MCT-LN-16	1	液氮 MCT, Range:12,000-600cm-1	
4)	PMC-ATR-G-1	1	Metal plate with Ge crystal	和第一台金刚石 ATR 晶体盘互换使用

## 6, 软件

序号	物料号	数量	描述	备注
1)	S-IR	1	标准的采集软件	所有界面均为英文 20220828, 软件上得写上公司名称 "Siberian Analytical Systems LLC"
2)	Lib-Poly	1	Polymers and Polymer Additives library	我来准备

## 7, 仪器操作说明书

☐ 标准版（型号：                      ）                      ☒ 非标版（出厂前需生产部编制）

## 8, 配套国内/国际成品采购


序号	物料号	数量	描述	备注
1)	PMC-DR-800	1	高温原位漫反射附件, 800 度, (适合于 Foli10-R, Foli20), 包含制样工具	王斌老师有现货, 他准备一个底座, F20 主机做好后, 通知他来上海, 实际安装和录制视频。
2)				

## 9, 打包要求（可多选）

- ☐ 常规包装  
☒ 中性包装（去 LOGO 包装，箱子和胶带都去 logo）  
☒ 定制包装（详细说明：免熏蒸的木箱包装，用于出口，提前定制）  
☒ 防潮铝箔包装（由于是 KBr 系统）

## 10, 其他

主机的外型：

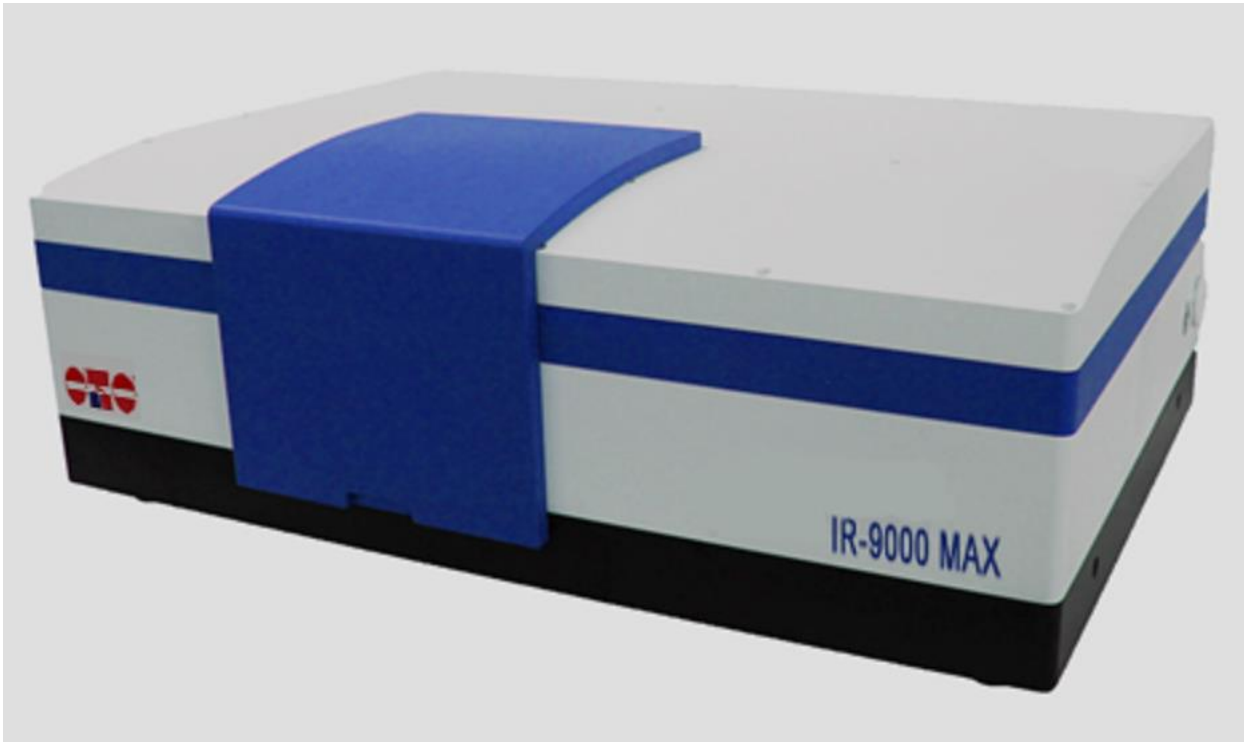

LOGO 的颜色和色号：

