

生产任务通知单

任务编号：TS2022011001

1，任务类型：

☒ 客户订单（订单号：SIN07922） ☐ 研发项目 ☐ 样机 ☐ 其它

2，任务信息

录入日期	2022-6-10	答交时间	2022-8-25
客户名称	北京科瑞泰德有限公司	销售姓名	王伟
合同号码		产 品 线	中红外
生产型号	FOLI20 (对应 IR-9000 MAX)	数 量	1
序 列 号	CSN220001	特殊配置	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是（详见第 4 部分）

3，外观说明

1) 机身丝印型号：	IR-9000 MAX
2) 机身铭牌打印型号：	IR-9000 MAX
3) 其他说明	关于机身颜色、型号和 LOGO，没有具体的蓝色和红色色号要求（我们固定一个色号值即可）。字母和 LOGO 的大小和位置，我们来定，效果图见后。第一台一定注意产品质量，体现 INSA 的品牌和品质！

4，硬件配置

序号	型号/物料号	数量	描述	备注
1)	FOLI20	1	红外主机 (KBr 分束器, DLaTGS 检测器, 分辨率 0.4cm-1	Spectral Range: 8,000-350cm-1 Wavenumber precision: Better than 0.01cm-1 Photometric precision: Better than 0.1 % T Signal to Noise: 40000:1 Main Size: 850×590×316mm Sample Compartment Size:255×255×168mm
2)	XD105/2	1	Switch of the second detector for Foli20, DLaTGS 和 MCT 检测器自动切换	
3)	D-MCT-LN-16	1	液 氮 MCT , Range:12,000-600cm-1	
4)	PMC-ATR-D	1	金刚石晶体 ATR 附件, 安装于样品仓中使用	
5)	PMC-DR-100	1	漫反射附件, 安装于样品仓中使用	包含制样工具


5，软件

序号	物料号	数量	描述	备注
1)		1	标准的采集软件	所有界面均为英文 英文谱图我来准备一些。
2)				按照俄罗斯仪器认证的要求， 软件上得写上公司名称 “ Siberian Analytical Systems LLC”

6，配套成品采购

序号	物料号	数量	描述	备注
1)				
2)				

7，包装要求等
主机的外型：

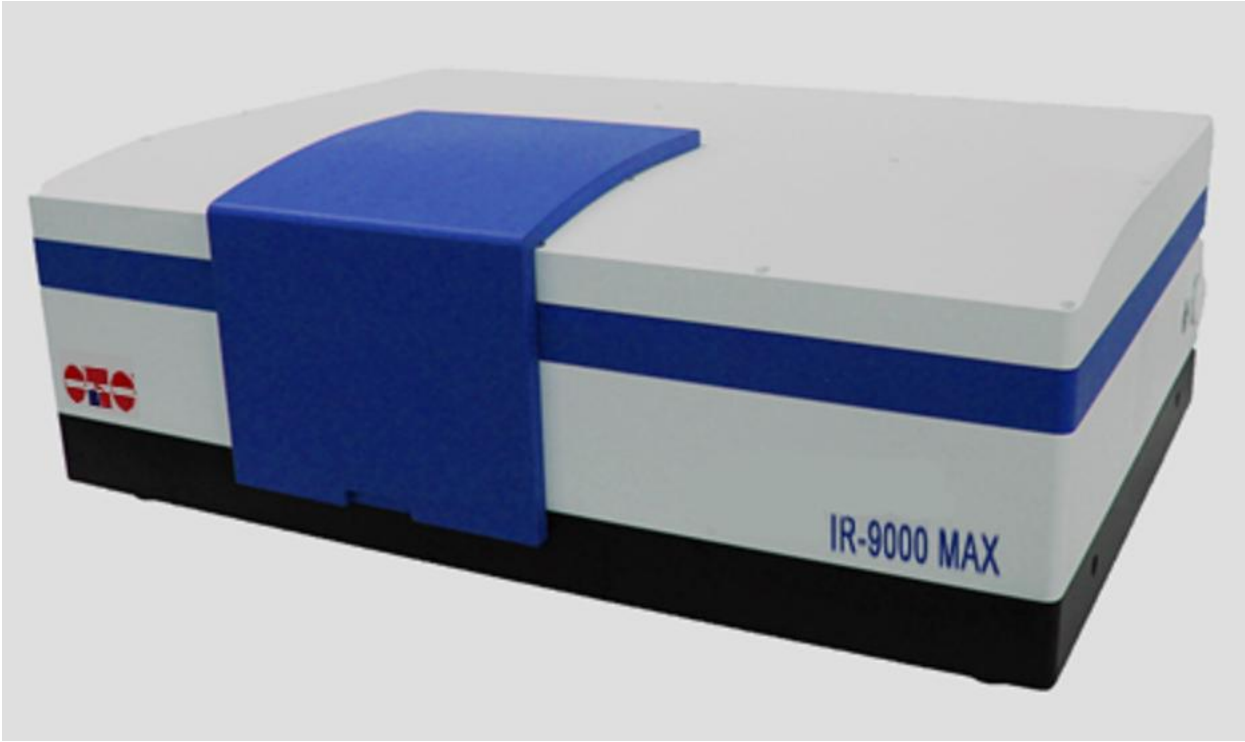

LOGO 的颜色和色号：

