

# Transacciones

Se explican las transacciones que componen el submódulo de Activos.



Escrito por WIN Software

## Transacciones

### Modificar Masivamente

A esta opción se llega al sobreponer el cursor del mouse sobre el módulo de Activos y en la parte inferior del título se despliega el conjunto de transacciones disponibles que componen el submódulo de Activos.

A continuación se elige la transacción “**Modificar Masivamente**”.

Infraestructura	Activos	Almacén	Kárdex	Programas	Solicitudes	Paros	Órdenes	Historia	Administración	⋮
<span style="font-size: 2em; color: #0070C0;">█</span> Activo										
Código ^	<span style="color: #0070C0;">█</span> Modificar Masivamente	<span style="color: #0070C0;">█</span> Actualizar contadores	<span style="color: #0070C0;">█</span> DashBoard Activos							
** FT NKR **										
** FT NPR ***										
0001bomillo										
0013673										
001maquidore033										
001recubridora...										
01hid										
123466										
Equipo de contingencia										
200.232.01INT	INTERRUPTOR 1 MT MOTOR PPAL									
200.232.02INT	INTERRUPTOR 2 MT MOTOR PPAL									
2101	SISTEMA DE TRANSPORTE 2101									
210101	TRANSPORTADOR 1 DE TORTA DE FIP									
2101M01	MOTOR DEL TRANSPORTADOR 1 DE TORTA DE ...									
2101M02	MOTOR DEL TRANSPORTADOR 2 DE TORTA DE ...									
2101M03	MOTOR DEL TRANSPORTADOR 3 DE TORTA DE ...									
2101M04	MOTOR DEL TRANSPORTADOR 4 DE TORTA DE ...									
2101RD	REDUCTOR TRANSPORTADOR 1 DE TORTA DE FIP									
2105	SISTEMA DE RECIRCULACION FIP									
2105P1	BOMBA RECIRCULACION N1 FIP									
300.303.01INT	INTERRUPTOR 1 MOTOR MT PRIMERA ETAPA									
3201	CALDERA N.1									
3201B0	BOMBA ALIM. CALDERA N.1									
3201PM	PROGRAMADOR CALDERA N.1									
3201QM	QUEMADOR CALDERA N.1									
3203	CALDERA N.3									
3203B0	BOMBA ALIM. CALDERA N.3									
3221	CALDERA N.21									
35900	LINEA DE FRITURA									
35901	LINEA DE FRITURA Y SABORIZACION									
35901.13	TANQUE FRITURA LINEA DE F Y S									

**Imagen 20. Activos - Modificar Masivamente**

Esta transacción permite cambiar masivamente el Estado, Descripción, Ubicación Física, Centro de Costos, Encargado, Comentarios, Proveedor y Fabricante, Marca, Modelo, Grupo de los registros previamente seleccionados en un filtro o subgrupo o aquellos que se encuentran en el

Visor. Para ello se debe dar clic al link en azul **Modificar Masivamente** ubicado al lado superior izquierdo de la ventana, seguidamente se muestra el conjunto de opciones de modificación masiva disponibles.

Infraestructura    Activos    Almacén    Kárdex    Programas    Solicitudes    Paros    Órdenes    Historia    ...

Activos » Modificar Masivamente

Activos » Modificación Masiva

MODIFICAR

Modificar solamente este Activo       Modificar todos los Activos en el visor (555)

Ficha Técnica

- Modificar Descripción
- Modificar Referencia Externa (Proveedor)
- Modificar Activo Padre
- Modificar Centro de Costo
- Modificar Ubicación Física
- Modificar Clasificación por Proceso
- Modificar Confiabilidad Subjetiva
- Modificar Proveedor
- Modificar Fabricante
- Modificar Marca
- Modificar Modelo
- Modificar Tipo
- Modificar Encargado
- Modificar Estado
- Modificar Componente Intercambiable
- Modificar Ruta
- Modificar Grupo del Activo
- Modificar Comentarios

Vida Útil

- Modificar FF Registro
- Modificar FF Fabricación
- Modificar FF Ingreso Inventory
- Modificar FF Instalación
- Modificar FF Inicio Operación
- Modificar FF Dado de Baja
- Modificar FF Adquisición
- Modificar Tipo Adquisición
- Modificar Contrato
- Modificar Número de Póliza
- Modificar FF Ingreso de Póliza
- Modificar FF Retiro de Póliza

Info. Biomédica

- Modificar Registro Sanitario Invima o Permiso Comercialización
- Modificar Impacto en el Proceso
- Modificar Clasificación por Riesgo

- Modificar Clasificación por Uso
- Modificar Proceso Realizado por el Equipo

### **Imagen 21. Activos - Criterios Modificación Masiva**

En la gráfica anterior, Modificar Masivamente, se aprecian sus componentes y sus respectivos contenidos.

A continuación se describen los campos que componen esta transacción:

**Modificar Solamente Este Activo:** Al escoger esta opción, se ejecutan los cambios marcados (Ficha Técnica, Vida Útil e Info. Biomédica) al Activo/Equipo que se encuentre seleccionado en el visor.

**Modificar Todos los Activos en el Visor:** Al escoger esta opción, se ejecutan los cambios marcados (Ficha Técnica, Vida Útil e Info. Biomédica) a todos los Activos/Equipos que se encuentren en el visor.

## **FICHA TÉCNICA**

**Modificar Descripción:** Se Modifica Masivamente la Descripción del o los Activos que están previamente seleccionados en el visor.

The screenshot shows a software interface for modifying asset descriptions. At the top, there are two radio buttons: one for modifying the selected asset only and another for modifying all assets in the viewer (555). Below these are several checkboxes for modifying various asset details. The 'Modificar Descripción' checkbox is checked, and a new description 'Nueva Descripción' is entered in the input field. Other available options include modifying external references, parent assets, cost centers, physical locations, classification by process, subjective reliability, suppliers, manufacturers, brands, models, types, assigned agents, states, and interchangeable components.

**Imagen 22.** Activos - *Modificar Descripción*

**Modificar Referencia Externa (Proveedor):** Se Modifica Masivamente la referencia externa proveedor del o los Equipos que están previamente seleccionados en el visor.

This screenshot shows the same modification interface as above, but with the 'Modificar Referencia Externa (Proveedor)' checkbox checked. A new external reference 'Nueva Referencia Externa (Proveedor)' is entered in the input field. The other modification options remain the same as in Image 22.

**Imagen 23.** Activos - *Modificar Referencia Externa*

**Modificar Activo Padre:** Se Modifica Masivamente el Activo/Equipo Padre de los registros que están previamente seleccionados en el visor. Al seleccionar el Activo Padre, se asigna automáticamente el Centro de Costo y la Ubicación Física asociados al Activo Padre seleccionado.

Modificar solamente este Activo  Modificar todos los Activos en el visor (555)

Ficha Técnica

Modificar Descripción

Modificar Referencia Externa (Proveedor)

Modificar Activo Padre

Nuevo Activo Padre  
0013673

Modificar Centro de Costo

Nuevo Centro de Costo  
0104

Modificar Ubicación Física

Ubicación Física Actual  
Patio Anexo

Nueva Ubicación Física  
Adm.-Gerencia

OT Asociada

Modificar Clasificación por Proceso

Modificar Confiabilidad Subjetiva

Modificar Proveedor

**Imagen 24.** Activos - Modificar Activo Padre

**Modificar Centro de Costo:** Se Modifica Masivamente el Centro de Costo de los Equipos que están previamente seleccionados en el visor.

Modificar solamente este Activo  Modificar todos los Activos en el visor (555)

Ficha Técnica

Modificar Descripción

Modificar Referencia Externa (Proveedor)

Modificar Activo Padre

Modificar Centro de Costo

Nuevo Centro de Costo  
0104

Modificar Ubicación Física

Modificar Clasificación por Proceso

Modificar Confiabilidad Subjetiva

Modificar Proveedor

Modificar Fabricante

Modificar Marca

Modificar Modelo

Modificar Tipo

Modificar Encargado

Modificar Estado

Modificar Componente Intercambiable

**Imagen 25.** Activos - Modificar Centro de Costo

**Modificar Ubicación Física:** Se Modifica Masivamente la Ubicación Física de los Equipos que están previamente seleccionados en el visor.

The screenshot shows the 'Activos - Modificación Masiva' (Assets - Bulk Modification) interface. In the top navigation bar, 'Activos' is selected. The main area has a blue header 'MODIFICAR'. Below it, there are two radio button options: 'Modificar solamente este Activo' (Modify only this Asset) and 'Modificar todos los Activos en el visor (548)' (Modify all Assets in the viewer (548)). A checkbox 'Ficha Técnica' is checked. Underneath are several unchecked checkboxes: 'Modificar Descripción', 'Modificar Referencia Externa (Proveedor)', 'Modificar Activo Padre', 'Modificar Centro de Costo', and 'Modificar Ubicación Física', which is checked. A dropdown menu for 'Ubicación Física Actual' shows 'Planta del Corrugador'. Another dropdown for 'Nueva Ubicación Física' shows 'Adm.-Co-mpr-as'. A text input field for 'OT Asociada' is empty. At the bottom, there is a list of unchecked checkboxes: 'Modificar Clasificación por Proceso', 'Modificar Confiabilidad Subjetiva', 'Modificar Proveedor', 'Modificar Fabricante', 'Modificar Marca', and 'Modificar Modelo'.

**Imagen 26.** Activos - Modificar Ubicación Física

**Modificar Clasificación por Proceso:** Se Modifica Masivamente la Clasificación por Proceso de los Equipos que están previamente seleccionados en el visor.

The screenshot shows the same 'Activos - Modificación Masiva' interface. The 'Modificar Clasificación por Proceso' checkbox is checked. A dropdown menu for 'Nueva Clasificación por Proceso' shows 'Fácil Reemplazo'. A sub-menu is open, listing: 'Clave o Crítico', 'Detiene el proceso', 'Fácil Reemplazo' (which is highlighted in blue), 'No afecta el proceso', 'Poco uso', 'Ninguno', and 'Modificar Marca'. Below this, there is a list of unchecked checkboxes: 'Modificar Modelo', 'Modificar Tipo', 'Modificar Encargado', 'Modificar Estado', and 'Modificar Componente Intercambiable'.

**Imagen 27.** Activos - Modificar Clasificación por Proceso

**Modificar Confiabilidad Subjetiva:** Se Modifica Masivamente la Confiabilidad Subjetiva de los Equipos que están previamente seleccionados en el visor.

Activos » Modificación Masiva

Modificar solamente este Activo  Modificar todos los Activos en el visor (548)

Ficha Técnica

Modificar Descripción

Modificar Referencia Externa (Proveedor)

Modificar Activo Padre

Modificar Centro de Costo

Modificar Ubicación Física

Modificar Clasificación por Proceso

Modificar Confiabilidad Subjetiva

Nueva Confiabilidad Subjetiva  
100

Modificar Proveedor

Modificar Fabricante

Modificar Marca

Modificar Modelo

Modificar Tipo

Modificar Encargado

Modificar Estado

Modificar Componente Intercambiable

**Imagen 28.** Activos - Modificar Confiabilidad Subjetiva

**Modificar Proveedor:** Se modifica Masivamente el Proveedor de los equipos que están previamente seleccionados en el visor.

Activos » Modificación Masiva

Modificar solamente este Activo  Modificar todos los Activos en el visor (555)

Ficha Técnica

Modificar Descripción

Modificar Referencia Externa (Proveedor)

Modificar Activo Padre

Modificar Centro de Costo

Modificar Ubicación Física

Modificar Clasificación por Proceso

Modificar Confiabilidad Subjetiva

Modificar Proveedor

Nuevo Proveedor  
EUROTEX

Modificar Fabricante

Modificar Marca

Modificar Modelo

Modificar Tipo

Modificar Encargado

Modificar Estado

Modificar Componente Intercambiable

**Imagen 29.** Activos - Modificar Proveedor

**Modificar Fabricante:** Se modifica Masivamente el Fabricante de los equipos que están previamente seleccionados en el visor.

The screenshot shows the 'Activos » Modificación Masiva' (Assets » Mass Modification) interface. At the top, there are two radio button options: 'Modificar solamente este Activo' (Modify only this Asset) and 'Modificar todos los Activos en el visor (555)' (Modify all Assets in the viewer (555)). Below these are several checkboxes for modifying asset details. The 'Modificar Fabricante' checkbox is checked, and a dropdown menu labeled 'Nuevo Fabricante' contains the value 'KALLEY TAIWAN'. Other unchecked checkboxes include: Modificar Descripción, Modificar Referencia Externa (Proveedor), Modificar Activo Padre, Modificar Centro de Costo, Modificar Ubicación Física, Modificar Clasificación por Proceso, Modificar Confiabilidad Subjetiva, Modificar Proveedor, and Modificar Componente Intercambiable.

**Imagen 30.** Activos - Modificar Fabricante

**Modificar Marca:** Se modifica Masivamente la Marca de los equipos que están previamente seleccionados en el visor.

The screenshot shows the 'Activos » Modificación Masiva' (Assets » Mass Modification) interface. The 'Modificar Marca' checkbox is checked, and a dropdown menu labeled 'Nueva Marca' contains the value 'YORK'. Other checkboxes in the list are: Modificar Descripción, Modificar Referencia Externa (Proveedor), Modificar Activo Padre, Modificar Centro de Costo, Modificar Ubicación Física, Modificar Clasificación por Proceso, Modificar Confiabilidad Subjetiva, Modificar Proveedor, Modificar Fabricante, and Modificar Componente Intercambiable.

**Imagen 31.** Activos - Modificar Marca

**Modificar Modelo:** Se Modifica Masivamente el Modelo de los Equipos que están previamente seleccionados en el visor.

Infraestructura Activos Almacén Kárdex Programas Solicitudes Paros Órdenes Historia Administración

Activos » Modificación Masiva

Modificar solamente este Activo  Modificar todos los Activos en el visor (555)

Ficha Técnica

Modificar Descripción  
 Modificar Referencia Externa (Proveedor)  
 Modificar Activo Padre  
 Modificar Centro de Costo  
 Modificar Ubicación Física  
 Modificar Clasificación por Proceso  
 Modificar Confiabilidad Subjetiva  
 Modificar Proveedor  
 Modificar Fabricante  
 Modificar Marca  
 Modificar Modelo

Nuevo Modelo: Jhonest controls

Modificar Tipo  
 Modificar Encargado  
 Modificar Estado  
 Modificar Componente Intercambiable

**Imagen 32.** Activos - Modificar Modelo

**Modificar Tipo:** Se Modifica Masivamente el Tipo de los Equipos que están previamente seleccionados en el visor.

Infraestructura Activos Almacén Kárdex Programas Solicitudes Paros Órdenes Historia Administración

Activos » Modificación Masiva

Modificar solamente este Activo  Modificar todos los Activos en el visor (555)

Ficha Técnica

Modificar Descripción  
 Modificar Referencia Externa (Proveedor)  
 Modificar Activo Padre  
 Modificar Centro de Costo  
 Modificar Ubicación Física  
 Modificar Clasificación por Proceso  
 Modificar Confiabilidad Subjetiva  
 Modificar Proveedor  
 Modificar Fabricante  
 Modificar Marca  
 Modificar Modelo  
 Modificar Tipo

Nuevo Tipo: vapor

Modificar Encargado  
 Modificar Estado  
 Modificar Componente Intercambiable

**Imagen 33.** Activos - Modificar Tipo

**Modificar Encargado:** Se Modifica Masivamente el Encargado de los Equipos que están previamente seleccionados en el visor.

Modificar solamente este Activo  Modificar todos los Activos en el visor (555)

Ficha Técnica  
 Modificar Descripción  
 Modificar Referencia Externa (Proveedor)  
 Modificar Activo Padre  
 Modificar Centro de Costo  
 Modificar Ubicación Física  
 Modificar Clasificación por Proceso  
 Modificar Confiabilidad Subjetiva  
 Modificar Proveedor  
 Modificar Fabricante  
 Modificar Marca  
 Modificar Modelo  
 Modificar Tipo  
 Modificar Encargado

Nuevo Encargado: Alexander Cabrera F FF 14/01/2022

Modificar Estado  
 Modificar Componente Intercambiable

**Imagen 34.** Activos - Modificar Encargado

**Modificar Estado:** Se Modifica Masivamente el estado Activo – Inactivo de los Equipos que están previamente seleccionados en el visor.

Modificar solamente este Activo  Modificar todos los Activos en el visor (555)

Ficha Técnica  
 Modificar Descripción  
 Modificar Referencia Externa (Proveedor)  
 Modificar Activo Padre  
 Modificar Centro de Costo  
 Modificar Ubicación Física  
 Modificar Clasificación por Proceso  
 Modificar Confiabilidad Subjetiva  
 Modificar Proveedor  
 Modificar Fabricante  
 Modificar Marca  
 Modificar Modelo  
 Modificar Tipo  
 Modificar Estado

Nuevo Estado: A - En Operación

Modificar Componente Intercambiable

**Imagen 35.** Activos - Modificar Estado

**Modificar Componente Intercambiable:** Se Modifica Masivamente el Componente Intercambiable de los Equipos que están previamente seleccionados en el visor.

**Imagen 36.** Activos - Modificar Modificar Componente Intercambiable

**Modificar Ruta:** Se Modifica Masivamente la Ruta de los Equipos que están previamente seleccionados en el visor.

**Imagen 37.** Activos - Modificar Ruta

**Modificar Grupo del Activo:** Se Modifica Masivamente el grupo de los Equipos que están previamente seleccionados en el visor.

The screenshot shows a software interface for managing assets. At the top, there's a navigation bar with links like Infraestructura, Activos, Almacén, Kárdex, Programas, Solicitudes, Paros, Órdenes, Historia, Administración, and a three-dot menu. Below the navigation is a header with a pencil icon and the text "Activos » Modificación Masiva". A blue button labeled "MODIFICAR" with a checkmark is visible. The main area contains a list of checkboxes for modifying asset details, with the last one checked: "Modificar Grupo del Activo". A dropdown menu for selecting a group is open, showing options like "Apoyo administrativo", "Apoyo operacional" (which is highlighted in blue), "Infraestructura", "Producción", and "Info. Biomédica".

**Imagen 38.** Activos - Modificar Grupo del Activo

**Modificar Comentarios:** Se Modifican Masivamente los Comentarios, que están previamente seleccionados en el visor

Infraestructura    Activos    Almacén    Kárdex    Programas    Solicitudes    Paros    Órdenes    Historia    ...

## Activos » Modificar Masivamente

### Activos » Modificación Masiva

MODIFICAR / X

Modificar solamente este Activo       Modificar todos los Activos en el visor (555)

Ficha Técnica

Modificar Descripción

Modificar Referencia Externa (Proveedor)

Modificar Activo Padre

Modificar Centro de Costo

Modificar Ubicación Física

Modificar Clasificación por Proceso

Modificar Confiabilidad Subjetiva

Modificar Proveedor

Modificar Fabricante

Modificar Marca

Modificar Modelo

Modificar Tipo

Modificar Encargado

Modificar Estado

Modificar Componente Intercambiable

Modificar Ruta

Modificar Grupo del Activo

Modificar Comentarios

Nuevo Comentario  
Use medidas de seguridad

Vida Útil

Info. Biomédica



**Imagen 39.** Activos - Modificar Comentarios

## VIDA ÚTIL

**Modificar FF Registro:** Se Modifica Masivamente la fecha de registro ubicada en la pestaña de Vida Útil de los equipos que están previamente seleccionados en el visor.

Infraestructura    Activos    Almacén    Kárdex    Programas    Solicitudes    Paros    Órdenes    Historia    Administración

Activos » Modificación Masiva

**MODIFICAR**

Modificar solamente este Activo       Modificar todos los Activos en el visor (555)

Ficha Técnica  
 Vida Útil  
 Modificar FF Registro  
Nueva FF Registro  
01/01/2022

Modificar FF Fabricación  
 Modificar FF Ingreso Inventario  
 Modificar FF Instalación  
 Modificar FF Inicio Operación  
 Modificar FF Dado de Baja  
 Modificar FF Adquisición  
 Modificar Tipo Adquisición  
 Modificar Contrato  
 Modificar Número de Póliza  
 Modificar FF Ingreso de Póliza  
 Modificar FF Retiro de Póliza  
 Info. Biomédica

**Imagen 40.** Activos - Modificar FF Registro

**Modificar FF Fabricación:** Modifica Masivamente la fecha de fabricación ubicada en la pestaña de Vida Útil de los equipos que están previamente seleccionados en el visor.

Activos » Modificación Masiva

Modificar solamente este Activo  Modificar todos los Activos en el visor (555)

Ficha Técnica  
 Vida Útil  
 Modificar FF Registro  
 Modificar FF Fabricación  
 Nueva FF Fabricación  
 05/04/2021

Modificar FF Ingreso Inventario  
 Modificar FF Instalación  
 Modificar FF Inicio Operación  
 Modificar FF Dado de Baja  
 Modificar FF Adquisición  
 Modificar Tipo Adquisición  
 Modificar Contrato  
 Modificar Número de Póliza  
 Modificar FF Ingreso de Póliza  
 Modificar FF Retiro de Póliza  
 Info. Biomédica

**Imagen 41.** Activos - Modificar FF Fabricación

**Modificar FF Ingreso Inventario:** Se Modifica Masivamente la fecha de ingreso al inventario ubicada en la pestaña de Vida Útil de los equipos que están previamente seleccionados en el visor.

Activos » Modificación Masiva

Modificar solamente este Activo  Modificar todos los Activos en el visor (555)

Ficha Técnica  
 Vida Útil  
 Modificar FF Registro  
 Modificar FF Fabricación  
 Modificar FF Ingreso Inventario  
 Nueva FF Ingreso Inventario  
 31/12/2021

Modificar FF Instalación  
 Modificar FF Inicio Operación  
 Modificar FF Dado de Baja  
 Modificar FF Adquisición  
 Modificar Tipo Adquisición  
 Modificar Contrato  
 Modificar Número de Póliza  
 Modificar FF Ingreso de Póliza  
 Modificar FF Retiro de Póliza  
 Info. Biomédica

**Imagen 42.** Activos - Modificar FF Ingreso Inventario

**Modificar FF Instalación:** Se Modifica Masivamente la fecha de instalación ubicada en la pestaña de Vida Útil de los equipos que están previamente seleccionados en el visor.

Infraestructura Activos Almacén Kárdex Programas Solicitudes Paros Órdenes Historia Administración

Activos » Modificación Masiva

**MODIFICAR**

Modificar solamente este Activo  Modificar todos los Activos en el visor (555)

Ficha Técnica  
 Vida Útil  
     Modificar FF Registro  
     Modificar FF Fabricación  
     Modificar FF Ingreso Inventario  
     Modificar FF Instalación  
        Nueva FF Instalación  
        08/01/2022  
     Modificar FF Inicio Operación  
     Modificar FF Dado de Baja  
     Modificar FF Adquisición  
     Modificar Tipo Adquisición  
     Modificar Contrato  
     Modificar Número de Póliza  
     Modificar FF Ingreso de Póliza  
     Modificar FF Retiro de Póliza  
 Info. Biomédica

**Imagen 43.** Activos - Modificar FF Ingreso Inventory

**Modificar FF Inicio Operación:** Se Modifica Masivamente la fecha de inicio de operación ubicada en la pestaña de Vida Útil de los equipos que están previamente seleccionados en el visor.

Infraestructura Activos Almacén Kárdex Programas Solicitudes Paros Órdenes Historia Administración

Activos » Modificación Masiva

**MODIFICAR**

Modificar solamente este Activo  Modificar todos los Activos en el visor (555)

Ficha Técnica  
 Vida Útil  
     Modificar FF Registro  
     Modificar FF Fabricación  
     Modificar FF Ingreso Inventario  
     Modificar FF Instalación  
     Modificar FF Inicio Operación  
        Nueva FF Inicio Operación  
        12/01/2022  
     Modificar FF Dado de Baja  
     Modificar FF Adquisición  
     Modificar Tipo Adquisición  
     Modificar Contrato  
     Modificar Número de Póliza  
     Modificar FF Ingreso de Póliza  
     Modificar FF Retiro de Póliza  
 Info. Biomédica

**Imagen 44.** Activos - Modificar FF Inicio Operación

**Modificar FF Dado de Baja:** Se Modifica Masivamente la fecha de dada de baja en la pestaña de Vida Útil de los equipos que están previamente seleccionados en el visor.

Modificar solamente este Activo  Modificar todos los Activos en el visor (555)

Ficha Técnica  
 Vida Útil  
 Modificar FF Registro  
 Modificar FF Fabricación  
 Modificar FF Ingreso Inventario  
 Modificar FF Instalación  
 Modificar FF Inicio Operación  
 Modificar FF Dado de Baja  
 Nueva FF Dado de Baja  
 01/01/2020

Modificar FF Adquisición  
 Modificar Tipo Adquisición  
 Modificar Contrato  
 Modificar Número de Póliza  
 Modificar FF Ingreso de Póliza  
 Modificar FF Retiro de Póliza  
 Info. Biomédica

**Imagen 45.** Activos - Modificar FF Dado de Baja

**Modificar FF Adquisición:** Se Modifica Masivamente la fecha de adquisición ubicada en la pestaña de Vida Útil de los equipos que están previamente seleccionados en el visor.

Modificar solamente este Activo  Modificar todos los Activos en el visor (555)

Ficha Técnica  
 Vida Útil  
 Modificar FF Registro  
 Modificar FF Fabricación  
 Modificar FF Ingreso Inventario  
 Modificar FF Instalación  
 Modificar FF Inicio Operación  
 Modificar FF Dado de Baja  
 Modificar FF Adquisición  
 Nueva FF Adquisición  
 20/12/2021

Modificar Tipo Adquisición  
 Modificar Contrato  
 Modificar Número de Póliza  
 Modificar FF Ingreso de Póliza  
 Modificar FF Retiro de Póliza  
 Info. Biomédica

**Imagen 46.** Activos - Modificar FF Adquisición

**Modificar Tipo Adquisición:** Se Modifica Masivamente el tipo de adquisición seleccionado de la lista desplegada y que está ubicada en la pestaña de Vida Útil de los equipos que están previamente seleccionados en el visor.

**Activos » Modificación Masiva**

**MODIFICAR**

Modificar solamente este Activo  Modificar todos los Activos en el visor (555)

Ficha Técnica  
 Vida Útil  
 Modificar FF Registro  
 Modificar FF Fabricación  
 Modificar FF Ingreso Inventario  
 Modificar FF Instalación  
 Modificar FF Inicio Operación  
 Modificar FF Dado de Baja  
 Modificar FF Adquisición  
 Modificar Tipo Adquisición  
 Nuevo Tipo Adquisición  
 Compra  
**Compra**  
 Donación  
 Arrendamiento Financiero  
 Comodato  
 Préstamo  
 Otro  
 Modificar FF Retiro de Poliza  
 Info. Biomédica



**Imagen 47.** Activos - Modificar Tipo Adquisición

**Modificar Contrato:** Se Modifica Masivamente el Contrato ubicado en la pestaña de Vida Útil, de los equipos que están previamente seleccionados en el visor.

**Activos » Modificación Masiva**

**MODIFICAR**

Modificar solamente este Activo  Modificar todos los Activos en el visor (555)

Ficha Técnica  
 Vida Útil  
 Modificar FF Registro  
 Modificar FF Fabricación  
 Modificar FF Ingreso Inventario  
 Modificar FF Instalación  
 Modificar FF Inicio Operación  
 Modificar FF Dado de Baja  
 Modificar FF Adquisición  
 Modificar Tipo Adquisición  
 Modificar Contrato  
 Nuevo Contrato

Código CN	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Final
12345601	Hospimedics	2012-01-01	2012-12-31
1919033301	Rodrigo Sanchez	2011-05-05	2012-05-04
2019001	Susy Suescun		
20190011	Susy Suescun		
3005201013	Nissan Motor CO LTDA.	2012-01-01	2012-12-31
543201	Raikes, y CIA. S. en C.	2011-09-01	2012-08-31
765432101	GP-EMPAQUES INDUSTRIALES	2012-01-02	2019-07-31

**Imagen 48.** Activos - Modificar Contrato

**Modificar Número de Póliza:** Se Modifica Masivamente el número de la póliza ubicada en la pestaña de Vida Útil de los equipos que están previamente seleccionados en el visor.

**Imagen 49.** Activos - Modificar Número de Póliza

**Modificar FF Ingreso de Póliza:** Se Modifica Masivamente la fecha de ingreso de la póliza ubicada en la pestaña de Vida Útil de los equipos que están previamente seleccionados en el visor.

**Imagen 50.** Activos - Modificar FF Ingreso de Póliza

**Modificar FF Retiro de Póliza:** Se Modifica Masivamente la fecha de retiro de la póliza ubicada en la pestaña de Vida Útil de los equipos que están previamente seleccionados en el visor.

Modificar solamente este Activo  Modificar todos los Activos en el visor (555)

Ficha Técnica  
 Vida Útil  
 Modificar FF Registro  
 Modificar FF Fabricación  
 Modificar FF Ingreso Inventario  
 Modificar FF Instalación  
 Modificar FF Inicio Operación  
 Modificar FF Dado de Baja  
 Modificar FF Adquisición  
 Modificar Tipo Adquisición  
 Modificar Contrato  
 Modificar Número de Póliza  
 Modificar FF Ingreso de Póliza  
 Modificar FF Retiro de Póliza

FF Retiro Póliza  
20/01/2023

Info. Biomédica

**Imagen 51.** Activos - Modificar FF Ingreso de Póliza

## INFO. BIOMÉDICA

### Modificar Registro Sanitario Invima o Permiso de Comercialización: Se Modifica

Masivamente el número de registro sanitario INVIMA o el número de permiso de comercialización ubicada en la pestaña de Info. Biomédica de los equipos que están previamente seleccionados en el visor.

Modificar solamente este Activo  Modificar todos los Activos en el visor (555)

Info. Biomédica


Modificar Registro Sanitario Invima o Permiso Comercialización  
 Registro Sanitario Invima  
 Permiso Comercialización

Nuevo Número  
INVIMA 2008EBC-0002081

Modificar Impacto en el Proceso  
 Modificar Clasificación por Riesgo  
 Modificar Clasificación por Uso  
 Modificar Proceso Realizado por el Equipo


**Imagen 52.** Activos - Modificar Registro Sanitario Invima o Permiso de Comercialización

**Modificar Impacto en el Proceso:** Se Modifica Masivamente el impacto en el proceso ubicado en la pestaña de Info. Biomédica del o de los equipos que están previamente seleccionados en el visor.

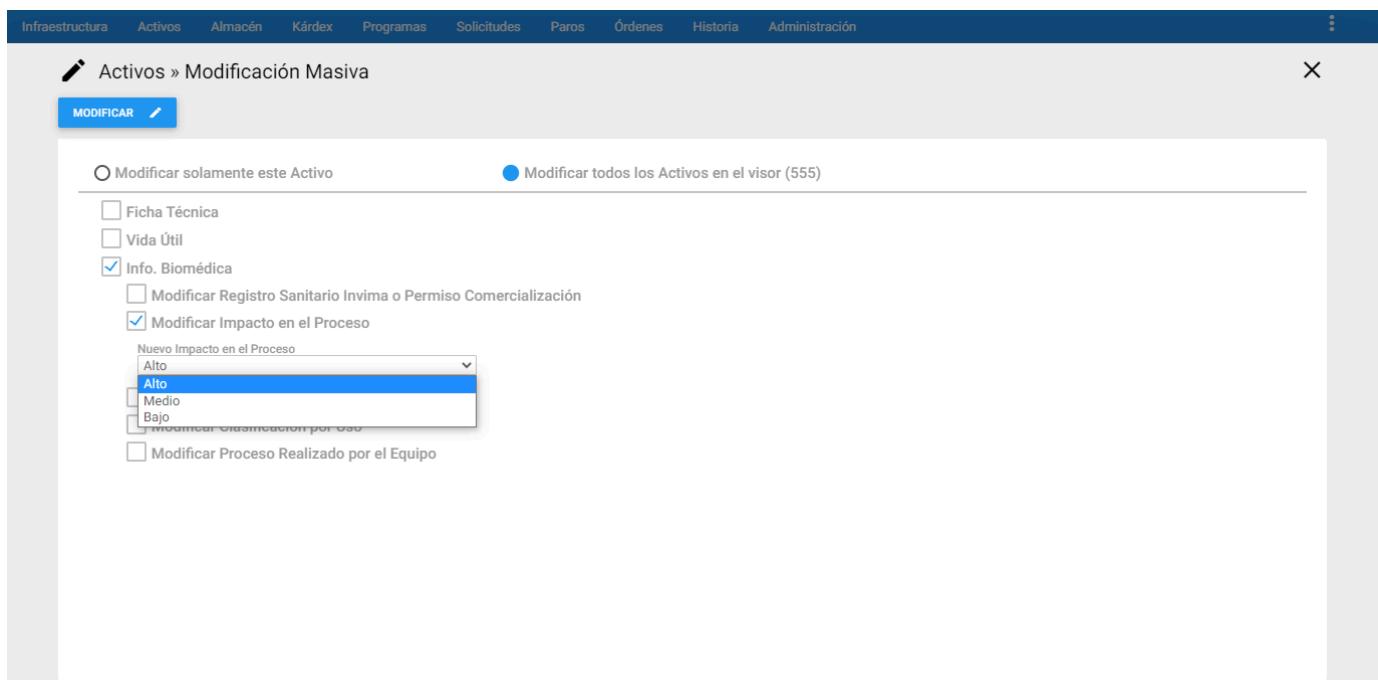


**Imagen 53.** Activos - Modificar Impacto en el Proceso

**Modificar Clasificación por Riesgo:** Se Modifica Masivamente la clasificación por riesgo ubicado en la pestaña de Info. Biomédica del o de los equipos que están previamente seleccionados en el visor.

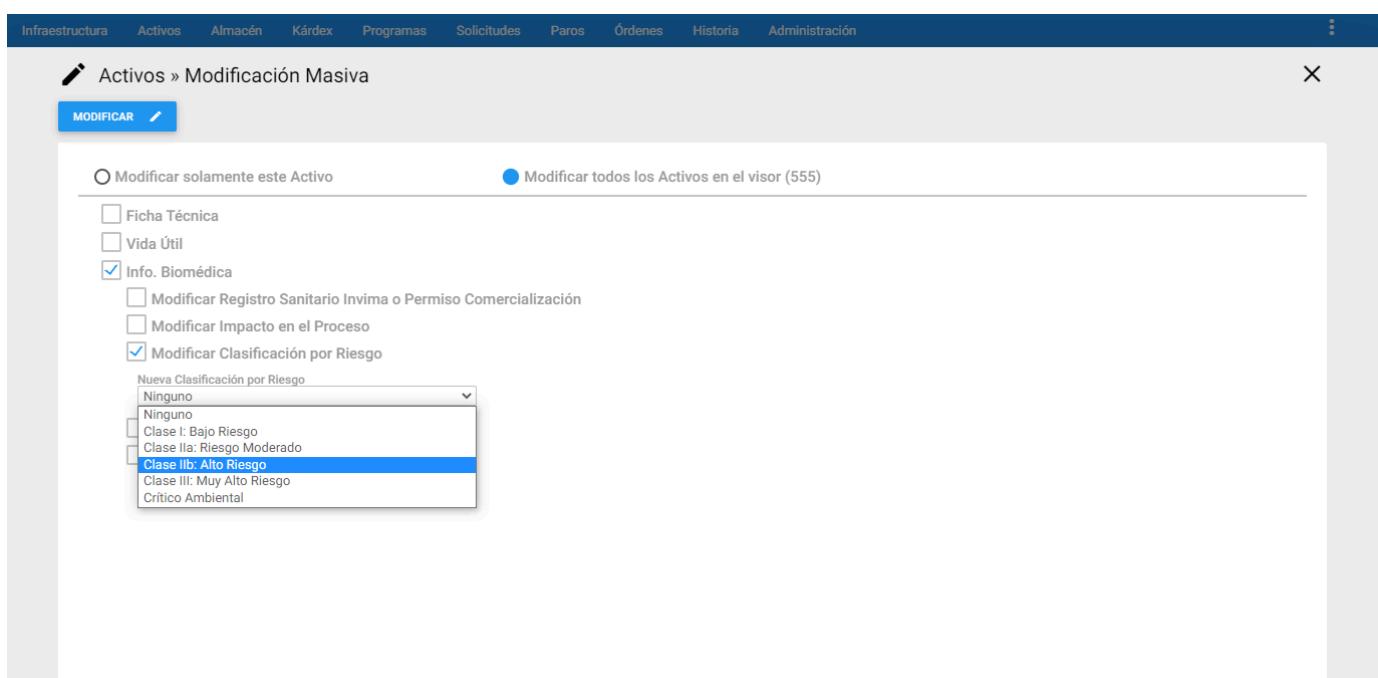


**Imagen 54.** Activos - Modificar Impacto en el Proceso

**Modificar Clasificación por Uso:** Se Modifica Masivamente la clasificación por uso ubicado en la pestaña de Info. Biomédica del o de los equipos que están previamente seleccionados en el visor.

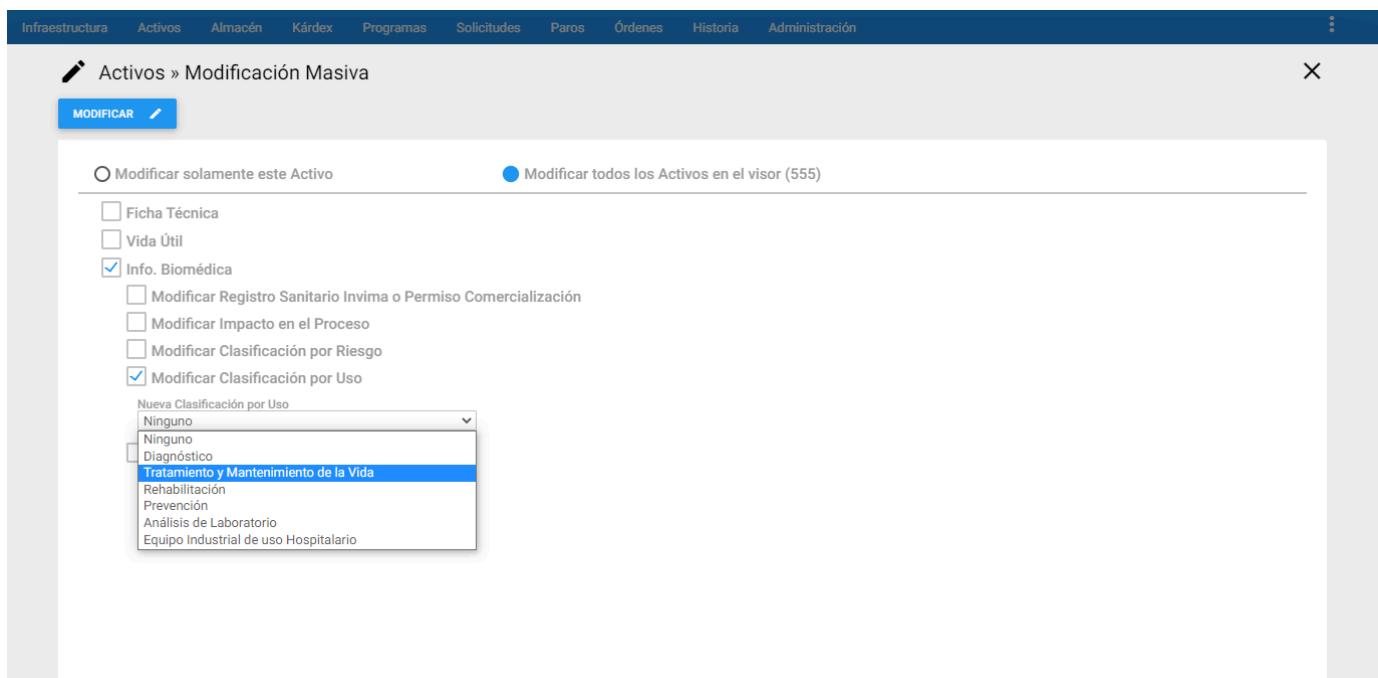

**Imagen 55.** Activos - Modificar Clasificación por uso

**Modificar Proceso Realizado por el Equipo:** Se Modifica Masivamenteel proceso realizado por el equipo ubicado en la pestaña de Info. Biomédica del o de los equipos que están previamente seleccionados en el visor.

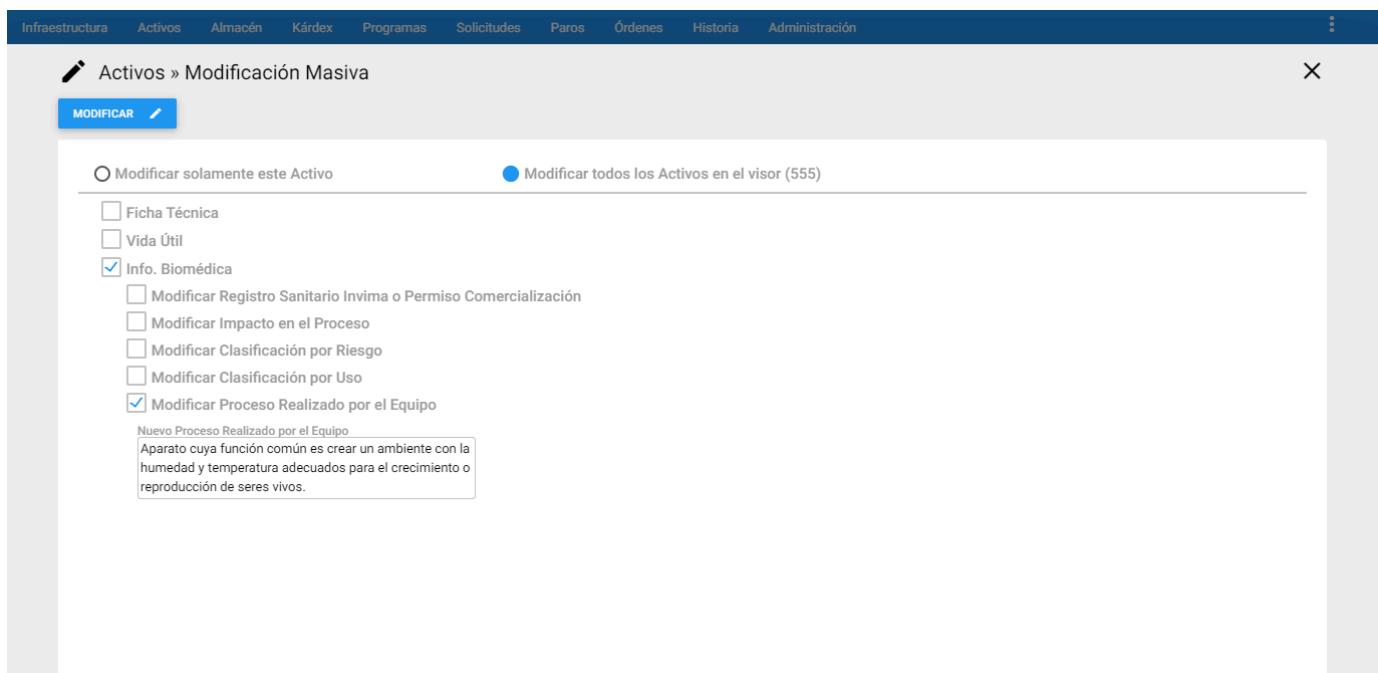


**Imagen 56.** Activos - Modificar Clasificación por uso

**Nota:** Estas opciones de modificar masivamente la información biomédica, sólo está habilitada para este tipo de compañías.

## Actualizar Contadores

Es la función que facilita la Actualización de los Contadores asociados a los Activos/Equipos. A esta ventana se llega sobreponiendo el cursor sobre el Módulo de Activos y mediante un clic en la opción **Actualizar Contadores**.

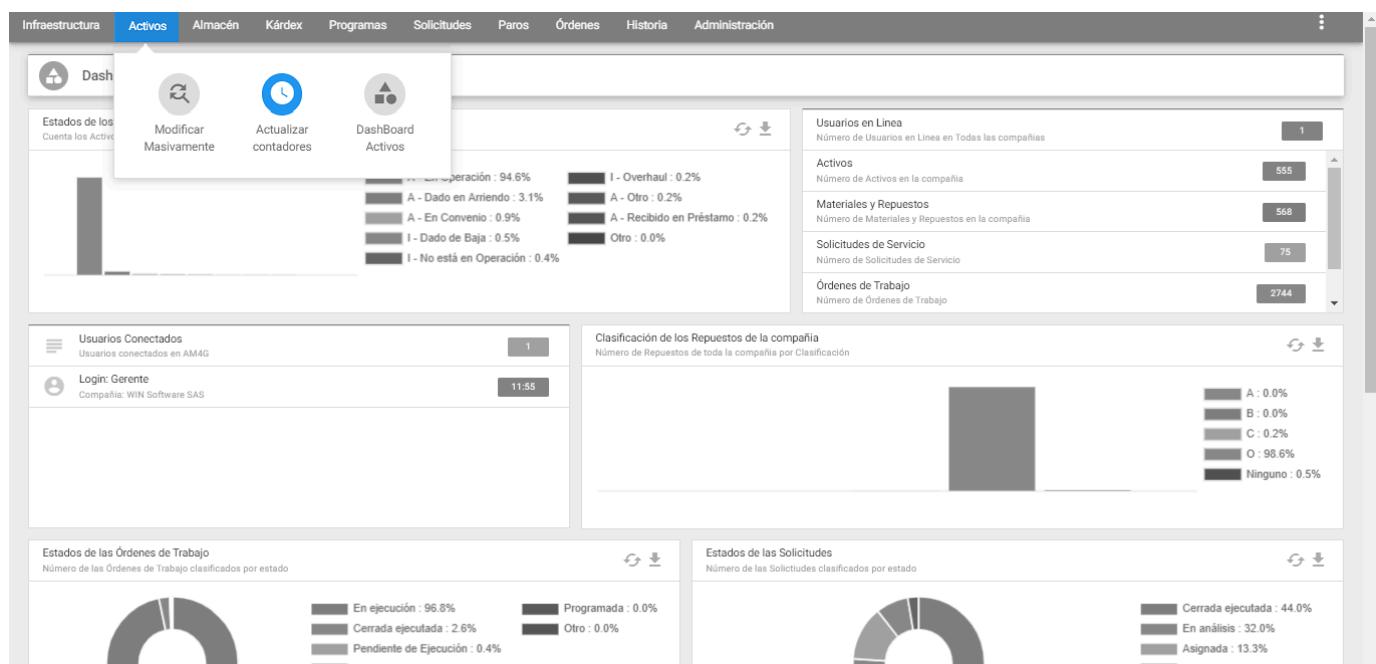

**Imagen 57.** Activos - Transacción Actualizar Contadores

La ventana despliega la lista de los Activos que tienen registrado un Contador dentro de su definición de Ficha Técnica. Junto al Código de cada Activo aparece el tipo de Contador y los datos referentes a la última lectura registrada. Posteriormente, a la derecha de cada línea de un Activo se encuentran disponibles un conjunto de campos para el registro de la información correspondiente a una nueva lectura.

The screenshot shows a table with the following columns:

- Activo (Equipment)
- Contador (Counter Type)
- FF Anterior (Previous Date)
- Valor Anterior (Previous Value)
- FF Nueva (New Date)
- Valor Nuevo (New Value)
- AD (Checkmark for selected equipment)
- RE (Checkmark for selected counter)
- Nueva Medición (New Measurement)

The table contains the following data:

	Activo	Contador	FF Anterior	Valor Anterior	FF Nueva	Valor Nuevo	AD	RE	Nueva Medición
<input type="checkbox"/> BL03	Horas	1999-11-06	9129.00	18/01/2022			<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	
<input checked="" type="checkbox"/> BL03MT	Horas	2003-06-11	13573.00	18/01/2022			<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
<input checked="" type="checkbox"/> BL03MT02	Horas	2003-06-11	13573.00	18/01/2022			<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
<input type="checkbox"/> CA01	Horas	1997-08-21	6543.00	18/01/2022			<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	
<input type="checkbox"/> CC-039	Odómetro	2003-08-30	22000.00	18/01/2022			<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	
<input type="checkbox"/> CC-041	Kilómetros	2001-01-29	36092.00	18/01/2022			<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	
<input checked="" type="checkbox"/> CC-049	Kilómetros	2001-09-12	56789.00	18/01/2022	67540.00		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	124329.00
<input type="checkbox"/> CC-049MO	Kilómetros	2001-09-12	56789.00	18/01/2022			<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	
<input type="checkbox"/> CC-096	Odómetro	1995-11-23	30000.00	18/01/2022			<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	
<input type="checkbox"/> CC-098	Odómetro	1995-11-23	30000.00	18/01/2022			<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	
<input type="checkbox"/> CMPTIN115	Kilómetros	2002-10-19	17892.00	18/01/2022			<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	

**Imagen 58.** Activos - Actualizar Contadores

En la gráfica anterior, ventana para Actualización de Contadores, se aprecian sus componentes y sus respectivos contenidos. A continuación se describen los campos que componen esta ventana:

**Activo:** En esta columna aparece el listado de todos los Activos/Equipos que tienen definido un Contador en su Ficha Técnica. Al lado izquierdo del Equipo puede haber dos campos. El primero, al extremo izquierdo un signo Más  $\oplus$  o un signo Menos  $\ominus$ , que permiten visualizar u ocultar respectivamente, el despiece del Equipo en aquellos componentes de despiece que también tienen una definición de contador, en su Ficha Técnica. El segundo es una casilla de selección que es marcada cuando se quiere actualizar con un nuevo valor, el contador para el Equipo de esa línea.

**Contador:** En esta columna se trae automáticamente para cada Equipo el Contador que tenga definido en su Ficha Técnica.

**FF Anterior:** En esta columna se muestra la fecha de la anterior medición del Contador de cada Equipo.

**Valor Anterior:** En esta columna se despliega el valor de la medición anterior.

**FF Nueva:** En esta columna el sistema propone la fecha actual como fecha de la nueva lectura del Contador. Cada fecha se puede asumir o se puede modificar, según sea la fecha de realización de la lectura que se está registrando.

**Valor Nuevo:** En esta columna se ingresa el valor de la lectura de contador a ser registrada.

**AD:** Seleccionando esta opción se realiza la adición del campo **Valor Nuevo** al campo


**Valor Anterior** y deja el resultado en la columna **Nueva Medición**.

**RE:** Seleccionando esta opción se copia el valor de la columna **Valor Nuevo** a la columna

**Nueva Medición**.

**Nueva Medición:** En esta columna se listan los valores actualizados de ese contador para el Equipo de cada línea.

**Nota:** Al finalizar el registro de todas las lecturas de contadores se debe procesar a dar clic en el botón **Actualizar**, el sistema muestra un mensaje alerta y para continuar presionar **ACEPTAR**

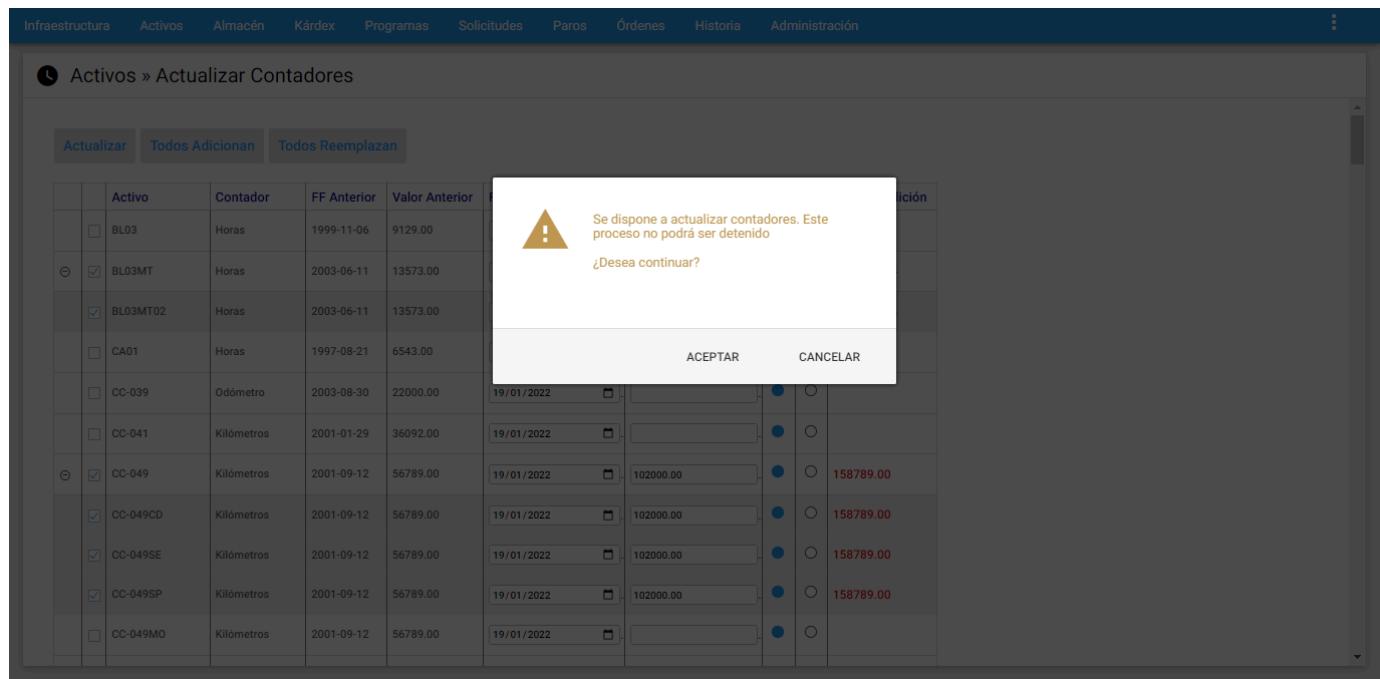

**Imagen 59.** Activos - Mensaje Alerta Contadores

Realizado el proceso se cambian los datos en rojo de la columna Nueva Medición por color verde, mostrando los campos actualizados:

	Infraestructura	Activos	Almacén	Kárdex	Programas	Solicitudes	Paros	Órdenes	Historia	Administración	⋮
<b>⌚ Activos » Actualizar Contadores</b>											
		<b>Actualizar</b>	<b>Todos Adicionan</b>	<b>Todos Reemplazan</b>							
		Activo	Contador	FF Anterior	Valor Anterior	FF Nueva	Valor Nuevo	AD	RE	Nueva Medición	
		BL03	Horas	1999-11-06	9129.00	19/01/2022		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		
⊖		BL03MT	Horas	2003-06-11	13573.00	19/01/2022	1542092.64	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	1542092.64	
		BL03MT02	Horas	2003-06-11	13573.00	19/01/2022	1542092.64	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	1542092.64	
		CA01	Horas	1997-08-21	6543.00	19/01/2022		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		
		CC-039	Odómetro	2003-08-30	22000.00	19/01/2022		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		
		CC-041	Kilómetros	2001-01-29	36092.00	19/01/2022		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		
⊖		CC-049	Kilómetros	2001-09-12	56789.00	19/01/2022	102000.00	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	158789.00	
		CC-049CD	Kilómetros	2001-09-12	56789.00	19/01/2022	102000.00	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	158789.00	
		CC-049SE	Kilómetros	2001-09-12	56789.00	19/01/2022	102000.00	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	158789.00	
		CC-049SP	Kilómetros	2001-09-12	56789.00	19/01/2022	102000.00	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	158789.00	
		CC-049MO	Kilómetros	2001-09-12	56789.00	19/01/2022		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		

**Imagen 60.** Activos - Actualización de Valores Contadores

Adicionalmente, se cuenta con la posibilidad de activar la opción de "No permitir modificaciones por encima del estándar de planeación", cuya funcionalidad es impedir la carga de contadores por encima de un estándar predefinido para un periodo de tiempo. Para activarla, se debe ingresar con un usuario administrador e ingresar a Valores por Defecto, en la opción Activos, como se indica a continuación:

	Infraestructura	Activos	Almacén	Kárdex	Programas	Solicitudes	Paros	Órdenes	Historia	Administración	⋮
<b>█ Valores por defecto</b>											
		<input checked="" type="radio"/> Compañía									
		<b>Actualizar</b>	<b>Cancelar</b>								
		<input checked="" type="radio"/> General									
		<input checked="" type="radio"/> Activos									
		Permitir Seriales Duplicados				<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No				
		Validar que incrementos en contadores no sean superiores al Estándar de Planeación Mensual				<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No				
		Manejo de Depreciación por linea Recta				<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No				
		Grupo 1 de Activos						<input type="text"/> Apoyo administrativo			
		Grupo 2 de Activos						<input type="text"/> Apoyo operacional			
		Grupo 3 de Activos						<input type="text"/> Infraestructura			
		Grupo 4 de Activos						<input type="text"/> Producción			

**Imagen 61.** Activos - Valores por Defecto - Contadores

## Cruce de Activos

En ocasiones se hace necesario hacer búsquedas rápidas de los Activos sobre su asociación con Órdenes, Solicitudes, Paros e Historia; esta transacción hace posible, que en el módulo de Activos se pueda acceder rápidamente a esta información, bien sea uno a uno ó registros preseleccionados en un Subgrupo.

Para acceder se sobreponer el cursor sobre el módulo de **Activos** donde se despliega el submenú de transacciones y a continuación dar clic en **Cruces de Activos** como se muestra a continuación:

Indicadores	Centro de Costo	Ubicación Física	Activo Fijo	Cod. Barras Int.	Serial	Alias
Cirugía	CCES2PT12-CIRUGIA REC...	302			63112/2	CX-MS-17
Unidad de Cuidados Intens...	CCES2PT3-UCI CUBICUL...	333			6429985	HP-MS-07
Hospitalización 3PT2	CCES3PT2-PUESTO DE E...	339			6441588	HP-MS-08
Unidad de Cuidados Intens...	CCES2PT3-UCI CUBICUL...	334			6429975	HP-MS-09
Unidad de Cuidados Especi...	CCES2PT1-UCE HABITAC...	335			6433756	HP-MS-10
Ecografía y Endoscopia	CCES1PT2-ENDOSCOPIA	336	208		6442235	HP-MS-11
Ingeniería Biomédica	ACESS1-INGENIERIA Y M...	328			6441589	HP-MS-12
Urgencias	CCES1PT2-URGENCIAS ...	243	N/A		6300252	UR-MS-02
Urgencias	CCES1PT2-URGENCIAS ...	244	N/A		6196660	UR-MS-03
Urgencias	CCES1PT2-URGENCIAS ...	245	N/A		6300210	UR-MS-04
Cirugía	CCES2PT2-CIRUGIA REC...	394			6300251	CX-MS-18
Cirugía	CCES2PT2-CIRUGIA SAL...	802			6571120	CX-MS-19
Unidad de Cardiología	CCES5PT2-CARDIO SAL...	983			DE72857499	KA-MS-01
Unidad de Cardiología	CCES5PT2-CARDIO REC...	972			DE72857491	KA-MS-02
Unidad de Cardiología	CCESS5PT2-CARDIO REC...	981			DE72857519	KA-MS-03
Unidad de Cardiología	CCESS5PT2-CARDIO REC...	974			DE72857492	KA-MS-04
Unidad de Cardiología	CCESS5PT2-CARDIO SAL...	980			DE72857493	KA-MS-05
Unidad de Cardiología	CCESS5PT2-CARDIO REC...	973			DE72857523	KA-MS-06
Cirugía	CCES2PT2-CIRUGIA REC...	964	N/A		6689484	CX-MS-20
I- Dado de Baja	CCES2PT3-UCE PUESTO ...	1004			6154456	HP-MS-13
I- Dado de Baja	Hospitalización 3PT1	1058			03760	CX-MS-21
A - En Operación	Cirugía	1059	N/A		03789	CX-MS-22
A - En Operación	Terapia Física	1072	N/A		SF312024890WA	
I- No está en Opera...	Unidad de Cuidados Intensi...	1071	N/A		SF311524855WA	
A - En Operación	Urgencias	1101	cubículo 2		03688	UR-MS-04
A - En Operación	Servicio de Observación Es...	1102			01177	UR-MS-05
A - En Operación	Cirugía	1458	N/A		0107106	CX-MS-23
A - En Operación	Hospitalización 5PT3	1459	N/A		0107108	HP-MS-01
A - En Operación	Cirugía	1520	N/A		0107351	CX-MS-24
A - En Operación	CCES2PT2-CIRUGIA REC...	1521	N/A		0107309	CX-MS-25

**Imagen 64. Activos - Ir a Cruce de Activos**

A continuación se visualiza la Ventana Visor de Cruces Activos:

Infraestructura	Activos	Almacén	Kárdex	Programas	Solicitudes	Paros	Órdenes	Historia	Historia Archivada	Administración	⋮
	Cruces Activos	PM	SS	ADF	OT	HI					
Indicador	Código ^	Descripción		Estado	Indicadores		PM asociados	SS asociados	ADF asociados	OT asociados	HI as
<input type="checkbox"/>	APCO-MN-133	MANOMETRO PRESION AIRE MEDICINAL		A- En Operación	<span style="color: green;">●</span> <span style="color: red;">●</span>		1	0	0	0	0
<input type="checkbox"/>	APCO-MN-134	MANOMETRO REGULADOR DE PRESIÓN DE NITROGENO		A- En Operación	<span style="color: green;">●</span> <span style="color: red;">●</span>		1	0	0	0	0
<input type="checkbox"/>	APCO-MN-135	MANOMETRO OXÍGENO		A- En Operación	<span style="color: green;">●</span> <span style="color: red;">●</span>		1	0	0	0	0
<input type="checkbox"/>	APCO-MN-136	MANOMETRO DIOXIDO DE CARBONO		A- En Operación	<span style="color: green;">●</span> <span style="color: red;">●</span>		1	0	0	0	0
<input type="checkbox"/>	APCO-MN-137	MANOMETRO AIRE MEDICINAL		A- En Operación	<span style="color: green;">●</span> <span style="color: red;">●</span>		1	0	0	0	0
<input type="checkbox"/>	APCO-MN-138	MANOMETRO NITRÓGENO		A- En Operación	<span style="color: green;">●</span> <span style="color: red;">●</span>		1	0	0	0	0
<input type="checkbox"/>	APCO-MN-139	MANOMETRO VACÍO		A- En Operación	<span style="color: green;">●</span> <span style="color: red;">●</span>		1	0	0	0	0
<input type="checkbox"/>	APCO-MN-14	MANOMETRO VACÍO		A- En Operación	<span style="color: green;">●</span> <span style="color: red;">●</span>		1	0	0	0	0
<input type="checkbox"/>	APCO-MN-140	MANOMETRO OXÍGENO		A- En Operación	<span style="color: green;">●</span> <span style="color: red;">●</span>		1	0	0	0	0
<input type="checkbox"/>	APCO-MN-141	MANOMETRO DIOXIDO DE CARBONO		A- En Operación	<span style="color: green;">●</span> <span style="color: red;">●</span>		1	0	0	0	0
<input type="checkbox"/>	APCO-MN-142	MANOMETRO AIRE MEDICINAL		A- En Operación	<span style="color: green;">●</span> <span style="color: red;">●</span>		1	0	0	0	0
<input type="checkbox"/>	APCO-MN-143	MANOMETRO NITRÓGENO		A- En Operación	<span style="color: green;">●</span> <span style="color: red;">●</span>		1	0	0	0	0
<input type="checkbox"/>	APCO-MN-144	MANOMETRO VACÍO		A- En Operación	<span style="color: green;">●</span> <span style="color: red;">●</span>		1	0	0	0	0
<input type="checkbox"/>	APCO-MN-145	MANOMETRO REGULADOR DE PRESIÓN DE NITROGENO		I- No está en Opera...	<span style="color: green;">●</span> <span style="color: red;">●</span>		1	0	0	0	0
<input type="checkbox"/>	APCO-MN-146	MANOMETRO REGULADOR DE PRESIÓN DE NITROGENO		I- No está en Opera...	<span style="color: green;">●</span> <span style="color: red;">●</span>		1	0	0	0	0
<input type="checkbox"/>	APCO-MN-147	MANOMETRO REGULADOR DE PRESIÓN DE NITROGENO		I- No está en Opera...	<span style="color: green;">●</span> <span style="color: red;">●</span>		1	0	0	0	0
<input type="checkbox"/>	APCO-MN-148	MANOMETRO REGULADOR DE PRESIÓN DE NITROGENO		I- No está en Opera...	<span style="color: green;">●</span> <span style="color: red;">●</span>		1	0	0	0	0
<input type="checkbox"/>	APCO-MN-149	MANOMETRO PRESIÓN DE OXÍGENO		A- En Operación	<span style="color: green;">●</span> <span style="color: red;">●</span>		1	0	0	0	0
<input type="checkbox"/>	APCO-MN-15	MANOMETRO PRESIÓN DE OXÍGENO		A- En Operación	<span style="color: green;">●</span> <span style="color: red;">●</span>		1	0	0	0	0
<input type="checkbox"/>	APCO-MN-150	MANOMETRO DE VACÍO		I- Dado de Baja	<span style="color: green;">●</span> <span style="color: red;">●</span>		1	0	0	0	0
<input type="checkbox"/>	APCO-MN-151	MANOMETRO PRESIÓN DE OXÍGENO		A- En Operación	<span style="color: green;">●</span> <span style="color: red;">●</span>		1	0	0	0	0
<input type="checkbox"/>	APCO-MN-152	MANOMETRO PRESIÓN DE AIRE MEDICINAL		A- En Operación	<span style="color: green;">●</span> <span style="color: red;">●</span>		1	0	0	0	0
<input type="checkbox"/>	APCO-MN-153	MANOMETRO DE VACÍO		A- En Operación	<span style="color: green;">●</span> <span style="color: red;">●</span>		1	0	0	0	0
<input type="checkbox"/>	APCO-MN-154	MANOMETRO PRESIÓN DE OXÍGENO		A- En Operación	<span style="color: green;">●</span> <span style="color: red;">●</span>		1	0	0	0	0
<input type="checkbox"/>	APCO-MN-16	MANOMETRO PRESIÓN TANQUE		I- Dado de Baja	<span style="color: green;">●</span> <span style="color: red;">●</span>		1	0	0	0	0
<input type="checkbox"/>	APCO-MN-17	MANOMETRO PRESIÓN MONITOR DE CO Y DP		I- Dado de Baja	<span style="color: green;">●</span> <span style="color: red;">●</span>		1	0	0	0	0
<input type="checkbox"/>	APCO-MN-18	MANOMETRO PRESIÓN DE OXÍGENO		A- En Operación	<span style="color: green;">●</span> <span style="color: red;">●</span>		1	0	0	0	0
<input type="checkbox"/>	APCO-MN-19	MANOMETRO PRESIÓN NITROGENO		A- En Operación	<span style="color: green;">●</span> <span style="color: red;">●</span>		1	0	0	0	0
<input type="checkbox"/>	APCO-MN-20	MANOMETRO PRESIÓN DE DIOXIDO DE CARBONO		A- En Operación	<span style="color: green;">●</span> <span style="color: red;">●</span>		1	0	0	0	0
<input type="checkbox"/>	APCO-MN-21	MANOMETRO PRESIÓN DE AIRE MEDICINAL		A- En Operación	<span style="color: green;">●</span> <span style="color: red;">●</span>		1	0	0	0	0

Registros por página: 60 481-540 de 6108 / 6108

« Primera Página &lt; Anterior 9 Siguiente &gt; Última Página »

### Imagen 65. Activos - Visor Cruce de Activos

Los títulos de cada columna en color azul permiten organizar la información ascendente o descendente a través de un clic.

**Esta transacción contiene las funcionalidades en cada ventana:** Subgrupos de información , exportar registros seleccionados , imprimir reportes  y consultar indicadores .

Es posible seleccionar uno a uno en la primera columna **Indicador** a través de un clic en el recuadro  y elegir lo que se desea consultar en los botones superiores en la izquierda:

- Programas: 
- Solicitudes de Servicio: 
- Paros: 
- Órdenes de Trabajo: 
- Historia de Mantenimiento: 

A continuación se ilustra el siguiente ejemplo:

Indicador	Código ^	Descripción	Estado	Indicadores	PM asociados	SS asociados	ADF asociados	OT asociados	HI asociados
<input checked="" type="checkbox"/>	BMMO-MS-74	MONITOR DE SIGNOS VITALES	A - En Operación	<input checked="" type="checkbox"/>	2	0	0	0	27
<input checked="" type="checkbox"/>	BMMO-MS-75	MONITOR DE SIGNOS VITALES	A - En Operación	<input checked="" type="checkbox"/>	2	0	0	1	28
<input checked="" type="checkbox"/>	BMMO-MS-76	MONITOR DE SIGNOS VITALES	A - En Operación	<input checked="" type="checkbox"/>	2	0	0	0	30
<input checked="" type="checkbox"/>	BMMO-MS-77	MONITOR DE SIGNOS VITALES	A - En Operación	<input checked="" type="checkbox"/>	2	0	0	0	29
<input checked="" type="checkbox"/>	BMMO-MS-78	MONITOR DE SIGNOS VITALES	A - En Operación	<input checked="" type="checkbox"/>	2	0	0	0	26
<input checked="" type="checkbox"/>	BMMO-MS-79	MONITOR DE SIGNOS VITALES	A - En Operación	<input checked="" type="checkbox"/>	2	0	0	0	26
<input checked="" type="checkbox"/>	BMMO-MS-80	MONITOR DE SIGNOS VITALES (TRANSPORTE)	A - En Operación	<input checked="" type="checkbox"/>	2	0	0	0	35
<input checked="" type="checkbox"/>	BMMO-MS-81	MONITOR DE SIGNOS VITALES	A - En Operación	<input checked="" type="checkbox"/>	2	0	0	0	31
<input checked="" type="checkbox"/>	BMMO-MS-82	MONITOR DE SIGNOS VITALES	A - En Operación	<input checked="" type="checkbox"/>	2	0	0	0	29
<input checked="" type="checkbox"/>	BMMO-MS-83	MONITOR DE SIGNOS VITALES	A - En Operación	<input checked="" type="checkbox"/>	2	0	0	0	34
<input checked="" type="checkbox"/>	BMMO-MS-84	MONITOR DE SIGNOS VITALES	A - En Operación	<input checked="" type="checkbox"/>	2	0	0	0	37
<input checked="" type="checkbox"/>	BMMO-MS-85	MONITOR DE SIGNOS VITALES	A - En Operación	<input checked="" type="checkbox"/>	2	0	0	0	28
<input checked="" type="checkbox"/>	BMMO-MS-86	MONITOR DE SIGNOS VITALES	A - En Operación	<input checked="" type="checkbox"/>	2	0	0	0	45
<input checked="" type="checkbox"/>	BMMO-MS-87	MONITOR DE SIGNOS VITALES	A - En Operación	<input checked="" type="checkbox"/>	2	0	0	0	25
<input checked="" type="checkbox"/>	BMMO-MS-88	MONITOR DE SIGNOS VITALES	A - En Operación	<input checked="" type="checkbox"/>	2	0	0	0	21
<input checked="" type="checkbox"/>	BMMO-MS-89	MONITOR DE SIGNOS VITALES	A - En Operación	<input checked="" type="checkbox"/>	2	0	0	0	19
<input checked="" type="checkbox"/>	BMMO-MS-90	MONITOR DE SIGNOS VITALES	A - En Operación	<input checked="" type="checkbox"/>	2	0	0	0	26
<input checked="" type="checkbox"/>	BMMO-MS-91	MONITOR DE SIGNOS VITALES	A - En Operación	<input checked="" type="checkbox"/>	2	1	1	1	24
<input checked="" type="checkbox"/>	BMMO-MS-92	MONITOR DE SIGNOS VITALES	A - En Operación	<input checked="" type="checkbox"/>	2	0	0	0	26
<input checked="" type="checkbox"/>	BMMO-MS-93	MONITOR DE SIGNOS VITALES	A - En Operación	<input checked="" type="checkbox"/>	2	0	0	0	28
<input checked="" type="checkbox"/>	BMMO-MS-94	MONITOR DE SIGNOS VITALES #9	A - En Operación	<input checked="" type="checkbox"/>	2	0	0	0	62
<input checked="" type="checkbox"/>	BMMO-MS-95	MONITOR DE SIGNOS VITALES	A - En Operación	<input checked="" type="checkbox"/>	2	0	0	0	28
<input checked="" type="checkbox"/>	BMMO-MS-96	MONITOR DE SIGNOS VITALES	A - En Operación	<input checked="" type="checkbox"/>	2	0	0	0	27
<input checked="" type="checkbox"/>	BMMO-MS-97	MONITOR DE SIGNOS VITALES	A - En Operación	<input checked="" type="checkbox"/>	2	0	0	0	22
<input checked="" type="checkbox"/>	BMMO-MS-98	MONITOR DE SIGNOS VITALES	A - En Operación	<input checked="" type="checkbox"/>	2	0	0	0	18
<input checked="" type="checkbox"/>	BMMO-MS-99	MONITOR DE SIGNOS VITALES	A - En Operación	<input checked="" type="checkbox"/>	2	0	0	0	19

Registros por página: 100 101-126 de 126 / 108

« Primera Página &lt; Anterior 2 Siguiente &gt; Última Página »

### Imagen 66. Activos - Subgrupo Cruce de Activos

La imagen anterior muestra el resultado por cada grilla de PM asociados, SS asociados, OT asociados e HI asociados al subgrupo o conjunto de Activos.

También puede visualizarse en la opción :

Indicador	Código ^	Descripción	Estado	Indicadores	PM asociados	SS asociados	ADF asociados	OT asociados	HI asociados
<b>Exportar Cruces</b>									
<input checked="" type="radio"/> Exportar Visor <input type="radio"/> Exportar Todos los Registros									
<input type="checkbox"/> Exportar Todos Los Campos									
<input checked="" type="checkbox"/> Código <input checked="" type="checkbox"/> Descripción <input checked="" type="checkbox"/> Estado <input checked="" type="checkbox"/> PM Asociados <input checked="" type="checkbox"/> SS Asociados <input checked="" type="checkbox"/> ADF Asociados <input checked="" type="checkbox"/> OT Asociados <input checked="" type="checkbox"/> HI Asociados									
<span style="background-color: red; color: white; padding: 2px 10px;">EXPORTAR</span> CERRAR									

Registros por página: 60 121-147 de 147 / 61

Anterior 3 Siguiente &gt; Última Página »

### Imagen 67. Activos - Exportar Grilla de Cruce de Activos

Esto puede tardar algunos minutos dependiendo de la cantidad de datos a exportar, para continuar dar clic en el botón **Descargar**. Esto descarga un archivo en formato excel en la estación Cliente:

Cruces Activos PM SS ADF OT HI

Indicador	Código ^	Descripción	Estado	PM Asociados	SS Asociados	ADF Asociados	OT Asociados	HI Asociados
	BMMO-MS-08	MONITOR DE S		0	0	0	0	1
	BMMO-MS-09	MONITOR DE S		0	0	0	0	0
	BMMO-MS-10	MONITOR DE S		0	0	0	0	0
	BMMO-MS-100	MONITOR DE S		0	0	0	0	0
	BMMO-MS-101	MONITOR DE S		0	0	0	0	0
	BMMO-MS-102	MONITOR DE S		0	0	0	0	0
	BMMO-MS-103	MONITOR DE S		0	0	0	0	1
	BMMO-MS-104	MONITOR DE S		0	0	0	0	0
	BMMO-MS-105	MONITOR DE S		0	0	0	0	0
	BMMO-MS-106	MONITOR DE S		0	0	0	0	0
	BMMO-MS-107	MONITOR DE S		0	0	0	0	0
	BMMO-MS-108	MONITOR DE S		0	0	0	0	0
	BMMO-MS-109	MONITOR DE S		0	0	0	0	0
	BMMO-MS-11	MONITOR DE S		0	0	0	0	0
	BMMO-MS-110	MONITOR DE S		0	0	0	0	0
	BMMO-MS-112	MONITOR DE S		0	0	0	0	0
	BMMO-MS-113	MONITOR DE S		0	0	0	0	0
	BMMO-MS-114	MONITOR DE S		0	0	0	0	0
	BMMO-MS-115	MONITOR DE S		0	0	0	0	0
	BMMO-MS-116	MONITOR DE S		0	0	0	0	0
	BMMO-MS-117	MONITOR DE S		0	0	0	0	0
	BMMO-MS-118	MONITOR DE S		0	0	0	0	0
	BMMO-MS-119	MONITOR DE S		0	0	0	0	0
	BMMO-MS-12	MONITOR DE S		0	0	0	0	0
	BMMO-MS-120	MONITOR DE S		0	0	0	0	0
	BMMO-MS-121	MONITOR DE S		0	0	0	0	0
	BMMO-MS-122	MONITOR DE S		0	0	0	0	0
	BMMO-MS-123	MONITOR DE S		0	0	0	0	0
	BMMO-MS-124	MONITOR DE S		0	0	0	0	0
	BMMO-MS-125	MONITOR DE SIGNOS VITALES		0	0	0	0	0

Exportar Cruces

Exportar Visor  Exportar Todos los Registros

Exportar Todos Los Campos

Código  Descripción  Estado  
 PM Asociados  SS Asociados  ADF Asociados  
 OT Asociados  HI Asociados

Exportación realizada en: 5sg

DESCARGAR

Registros por página: 100 1-100 de 147 / 6108

« Primera Página Anterior 1 Siguiente » Última Página »

**Imagen 68.** Activos - Descarga Grilla de Cruce de Activos

Visualización de la exportación:

A	B	C	D	E	F	G	H
1	Código	Descripción	Estado	PM Asociados	SS Asociados	OT Asociados	HI Asociados
2	BMMO-MS-08	MONITOR DE SIGNOS VITALES #6	A - En Operación	2	0	0	110
3	BMMO-MS-09	MONITOR DE SIGNOS VITALES	I - Dado de Baja	3	0	0	37
4	BMMO-MS-10	MONITOR DE SIGNOS VITALES	I - Dado de Baja	3	0	0	78
5	BMMO-MS-100	MONITOR DE SIGNOS VITALES	A - En Operación	2	0	0	22
6	BMMO-MS-101	MONITOR DE SIGNOS VITALES	A - En Operación	2	0	0	18
7	BMMO-MS-102	MONITOR DE SIGNOS VITALES #10	A - En Operación	2	0	0	44
8	BMMO-MS-103	MONITOR DE SIGNOS VITALES #8	A - En Operación	2	0	1	45
9	BMMO-MS-104	MONITOR DE SIGNOS VITALES	A - En Operación	2	0	0	36
10	BMMO-MS-105	MONITOR DE SIGNOS VITALES	A - En Operación	2	0	0	35
11	BMMO-MS-106	MONITOR DE SIGNOS VITALES	A - En Operación	2	0	0	25
12	BMMO-MS-107	MONITOR DE SIGNOS VITALES	A - En Operación	2	0	0	21
13	BMMO-MS-108	MONITOR DE SIGNOS VITALES	A - En Operación	2	1	0	29
14	BMMO-MS-109	MONITOR DE SIGNOS VITALES	A - En Operación	2	0	0	25
15	BMMO-MS-11	MONITOR DE SIGNOS VITALES	I - Dado de Baja	3	0	0	84
16	BMMO-MS-110	MONITOR DE SIGNOS VITALES	A - En Operación	2	0	0	16
17	BMMO-MS-112	MONITOR DE SIGNOS VITALES	A - En Operación	2	0	0	28
18	BMMO-MS-113	MONITOR DE SIGNOS VITALES	A - En Operación	2	0	0	15
19	BMMO-MS-114	MONITOR DE SIGNOS VITALES	A - En Operación	2	0	0	17
20	BMMO-MS-115	MONITOR DE SIGNOS VITALES	A - En Operación	2	0	0	21
21	BMMO-MS-116	MONITOR DE SIGNOS VITALES	A - En Operación	2	0	0	21

Datos

Introducir Accesibilidad: todo correcto Recuento: 147

**Imagen 69.** Activos - Visualización Descarga Grilla Cruce de Activos

Para continuar y consultar Programas asociados al Activo o Activos seleccionados dar clic en el

botón **PM**:

Código AC	Tar	Descripción	Ind	TT	TM	TA	Cri	Pri	CCE
BMMO-MS-74	4	SEGURIDAD ELECTRICA		Otr	Otro	SG-Seguridad Electrica	AN	3	CCE
BMMO-MS-74	3	PREVENTIVO		Otr	Preventivo	MN-Manto	SM	3	CCE
BMMO-MS-75	4	SEGURIDAD ELECTRICA		Otr	Otro	SG-Seguridad Electrica	AN	3	CCE
BMMO-MS-75	1	PREVENTIVO		Otr	Preventivo	MN-Manto	SM	3	CCE
BMMO-MS-76	4	SEGURIDAD ELECTRICA		Otr	Otro	SG-Seguridad Electrica	AN	3	CCE
BMMO-MS-76	2	PREVENTIVO		Otr	Preventivo	MN-Manto	SM	3	CCE
BMMO-MS-77	4	SEGURIDAD ELECTRICA		Otr	Otro	SG-Seguridad Electrica	AN	3	CCE
BMMO-MS-77	3	PREVENTIVO		Otr	Preventivo	MN-Manto	SM	3	CCE
BMMO-MS-78	4	SEGURIDAD ELECTRICA		Otr	Otro	SG-Seguridad Electrica	AN	3	CCE
BMMO-MS-78	3	PREVENTIVO		Otr	Preventivo	MN-Manto	SM	3	CCE
BMMO-MS-91	2	SEGURIDAD ELECTRICA		I/E	Otro	SG-Seguridad Electrica	AN	3	CCE
BMMO-MS-91	1	PREVENTIVO		I/E	Preventivo	MN-Manto	SM	3	CCE

asociados	OT asociados	HI asociados
0	0	27
0	0	28
0	0	30
0	0	29
0	0	26
0	0	26
0	0	35
0	0	31
0	0	29
0	0	34
0	0	37
0	0	28
0	0	28
0	0	27
0	0	22
0	0	18
0	0	19
0	0	26
0	1	24
0	0	26
0	0	35
0	0	31
0	0	29
0	0	34
0	0	37
0	0	28
0	0	45
0	0	25
0	0	21
0	0	19
0	0	26
0	1	24
0	0	26
0	0	28
0	0	62
0	0	0
0	0	28
0	0	27
0	0	22
0	0	18
0	0	19

### Imagen 70. Activos - Programas Cruce de Activos

Para consultar Solicitudes asociadas al Activo o Activos seleccionados dar clic en el botón  :

Solicitud	Diagnóstico del Usuario	Prioridad	F/H Creación	F/H Tentativa Entrega	Estado	Indicadores
77640	BUENOS DIAS FAVOR REVISAR MONITOR DE SIGNOS VITALES DEL C...	Alta	2022-07-01 09:18		CO	

asociados	OT asociados	HI asociados
0	0	27
0	1	28
0	0	30
0	0	29
0	0	26
0	0	35
0	0	31
0	0	29
0	0	34
0	0	37
0	0	28
0	0	45
0	0	25
0	0	21
0	0	19
0	0	26
0	1	24
0	0	26
0	0	28
0	0	62
0	0	0
0	0	28
0	0	27
0	0	22
0	0	18
0	0	19

### Imagen 71. Activos - Solicitudes Cruce de Activos

Para consultar ADF asociados al Activo o Activos seleccionados dar clic en el botón  :

AM - Google Chrome  
localhost:8080/AM4G/src/AC/AC-CrossesADF.html?Onbefore=0

① Paros

Paro	F/H Creación FDA	Activo	Alias	Restricción	Estado	Indicadores	Responsable	Ubicación Física
10	2022-12-29 16:01	BMMO-MS-91	HP-MS-15	No	En análisis	Daniel Acevedo ...	CCES2PT3-UCI CUBI.	

Registros por página: 100 1-1 de 1 / 1 « Primera Página Anterior Siguiente Última Página »

asociados OT asociados HI asociados

asociados	OT asociados	HI asociados
0	0	27
0	1	28
0	0	30
0	0	29
0	0	26
0	0	35
0	0	31
0	0	29
0	0	34
0	0	37
0	0	28
0	0	45
0	0	25
0	0	21
0	0	19
0	0	26
1	1	24
0	0	26
0	0	28
0	0	62
0	0	28
0	0	27
0	0	22
0	0	18
0	0	19

Registros por página: 100 101-126 de 126 / 6108 « Primera Página Anterior Siguiente Última Página »

**Imagen 72.** Activos - Paros Cruce de Activos

Para consultar Órdenes de Trabajo asociadas al Activo o Activos seleccionados dar clic en el botón :

AM - Google Chrome  
localhost:8080/AM4G/src/AC/AC-CrossesOT.html?Onbefore=0

② Ordenes de Trabajo

Número OT	Descripción	F/H Creación	Responsable	Pri	F/H Programada	Estado	Indicadores	Cod. Activo
2022 - 2388	PREVENTIVO	2022-06-01 09:51	Dennys Lorena Cárd...	3	2022-06-19 00:00	EJ	●	BMMO-MS-75
2022 - 2803	BUENOS DIASFAVOR REVISAR MONIT...	2022-07-01 12:08	Dennys Lorena Cárd...	2	2022-07-01 12:08	EJ	●	BMMO-MS-91

Registros por página: 100 1-2 de 2 / 2 « Primera Página Anterior Siguiente Última Página »

asociados OT asociados HI asociados

asociados	OT asociados	HI asociados
0	0	27
0	1	28
0	0	30
0	0	29
0	0	26
0	0	35
0	0	31
0	0	29
0	0	34
0	0	37
0	0	28
0	0	45
0	0	25
0	0	21
0	0	19
0	0	26
1	1	24
0	0	26
0	0	28
0	0	62
0	0	28
0	0	27
0	0	22
0	0	18
0	0	19

Registros por página: 100 101-126 de 126 / 6108 « Primera Página Anterior Siguiente Última Página »

**Imagen 73.** Activos - Órdenes Cruce de Activos

Para consultar Historia de Mantenimiento asociada al Activo o Activos seleccionados dar clic en el botón :

AM - Google Chrome  
localhost:8080/AM4G/src/AC/AC-CrossesHI.html?Onbefore=0

Número OT	Descripción OT	Código AC	CR	Responsable	Indicado
2022 - 916	monitor del cubículo 1 se ha apagado dos veces en la mañana, continua con un rui...	BMMO-MS-75	Ingeniería Biomé...	Dennys Lorena Cárdenas Chi...	●
2022 - 571	PREVENTIVO	BMMO-MS-77	Ingeniería y Man...	Dennys Lorena Cárdenas Chi...	●
2022 - 2518	OXIMETRO DEL CUBÍCULO NUMERO 4 NO SENSAR CORRECTAMENTE	BMMO-MS-78	Ingeniería Biomé...	Practicante Ingeniería biomé...	●
2022 - 2468	SEGURIDAD ELECTRICA	BMMO-MS-76	Ingeniería y Man...	Dennys Lorena Cárdenas Chi...	●
2022 - 2450	PREVENTIVO	BMMO-MS-76	Ingeniería y Man...	Dennys Lorena Cárdenas Chi...	●
2022 - 2382	PREVENTIVO	BMMO-MS-79	Ingeniería y Man...	Dennys Lorena Cárdenas Chi...	●
2022 - 2196	POR FAVOR REVISAR EL MODULO DEL MONITOR DE SIGNOS VITALES DE UCI 1 C...	BMMO-MS-78	Ingeniería Biomé...	Dennys Lorena Cárdenas Chi...	●
2022 - 1910	SEGURIDAD ELECTRICA	BMMO-MS-74	Ingeniería y Man...	Dennys Lorena Cárdenas Chi...	●
2022 - 1909	SEGURIDAD ELECTRICA	BMMO-MS-75	Ingeniería y Man...	Dennys Lorena Cárdenas Chi...	●
2022 - 1908	SEGURIDAD ELECTRICA	BMMO-MS-79	Ingeniería y Man...	Dennys Lorena Cárdenas Chi...	●
2022 - 1312	revisar modulo del monitor que al retirarlo y pasarlo al monitor de transporte,no ce...	BMMO-MS-74	Ingeniería Biomé...	Dennys Lorena Cárdenas Chi...	●
2022 - 118	PREVENTIVO	BMMO-MS-78	Ingeniería y Man...	Dennys Lorena Cárdenas Chi...	●
2022 - 117	PREVENTIVO	BMMO-MS-91	Ingeniería y Man...	Dennys Lorena Cárdenas Chi...	●
2022 - 1074	PREVENTIVO	BMMO-MS-74	Ingeniería y Man...	Dennys Lorena Cárdenas Chi...	●
2021 - 5317	PREVENTIVO	BMMO-MS-75	Ingeniería y Man...	Dennys Lorena Cárdenas Chi...	●
2021 - 5316	PREVENTIVO	BMMO-MS-76	Ingeniería y Man...	Dennys Lorena Cárdenas Chi...	●

Registros por página: 100 1-100 de 190 / 190

« Primera Página < Anterior 1 Siguiente > Última Página »

asociados	OT asociados	HI asociados	
0	0	1	28
0	0	0	30
0	0	0	29
0	0	0	26
0	0	0	26
0	0	0	35
0	0	0	31
0	0	0	29
0	0	0	34
0	0	0	37
0	0	0	28
0	0	0	45
0	0	0	25
0	0	0	21
0	0	0	19
0	0	0	26
1	1	1	24
0	0	0	26
0	0	0	28
0	0	0	62
0	0	0	27
0	0	0	22
0	0	0	18
0	0	0	19

« Primera Página < Anterior 2 Siguiente > Última Página »


BMMO-MS-99 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | A - En Operación

Registros por página: 100 101-126 de 126 / 6108

**Imagen 74.** Activos - Historia Cruce de Activos

## Dashboard Activos

Esta transaccion permite ver indicadores gráficos básicos sobre la información de los Activos/Equipos. Para acceder a esta opción se sobreponen el cursor sobre el módulo de Activos en el menú principal donde se despliega un submenú de transacciones disponibles y luego dar clic en "DashBoard Activos".

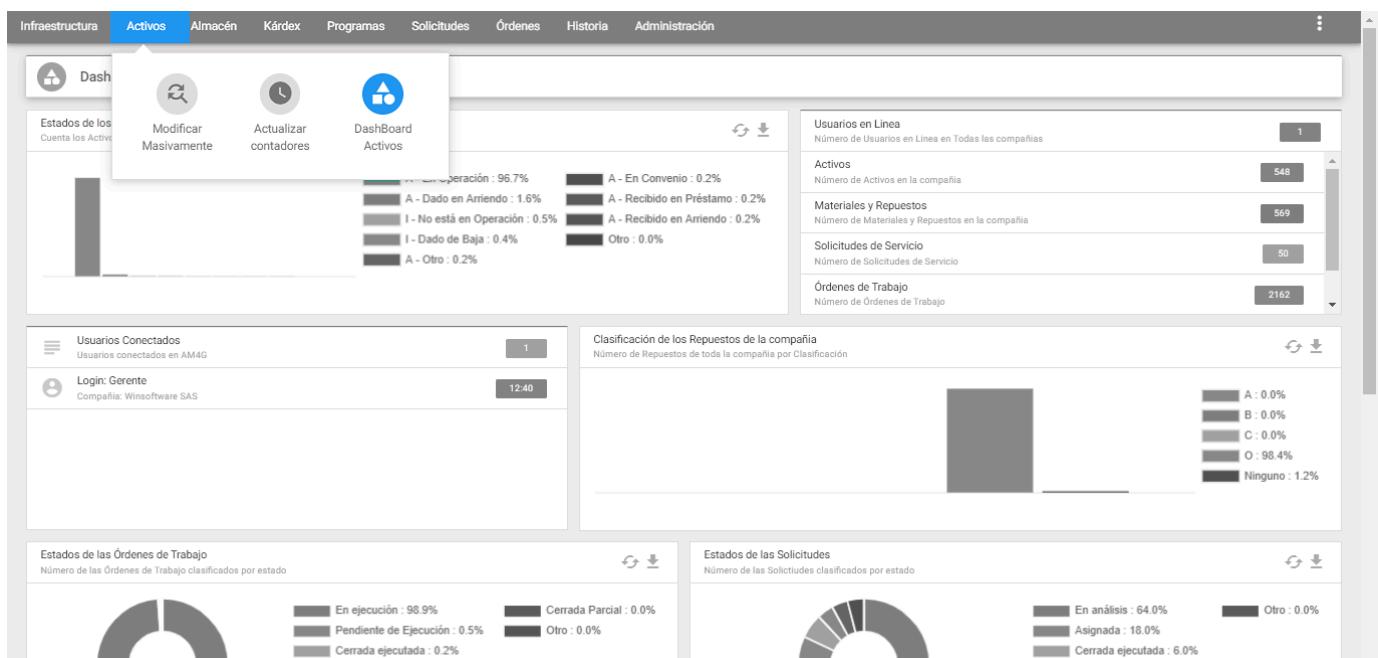

**Imagen 75.** Activos - Transacción Dashboard

---

Este comando permite visualizar en tiempo real el comportamiento de los Activos/Equipos con el fin de usarse como una herramienta para análisis y toma de decisiones rápidas.

**Infraestructura** **Activos** **Almacén** **Kárdex** **Combustibles** **Programas** **Solicitudes** **Paros** **Órdenes** **Historia** **⋮**

### Dashboard de Activos

**Estados de los Activos**  
Cuenta los Activos clasificados por estado

Estado	Porcentaje
A - En Operación	49.4%
I - Dado de Baja	34.2%
A - En Convenio	9.3%
I - No está en Operación	6.5%
I - Otro	0.4%
I - Overhaul	0.0%
A - En Comodato	0.0%

6110 / 6110

**Grupo de Activos**  
Cuenta los Activos por grupo

Grupo	Porcentaje
Apoyo administrativo	18.0%
Equipo de apoyo	1.1%
Infraestructura	0.0%
Biomédico	3.3%
Ninguno	77.6%

**Centros de Costo**  
Cuenta los 12 Centros de Costos con mas Activos

Centro de Costo	Porcentaje
Cirugía	16.2%
Unidad de Cuidados Intensivos	11.5%
Urgencias	4.9%
Ingeniería Biomédica	4.8%
Unidad de Cuidados Especiales	4.7%
Consulta Externa	4.3%
Unidad de Cardiología	3.9%
Hospitalización 3PT1	3.8%
Hospitalización 4PT1	3.5%
Hospitalización 4PT3	3.4%
Hospitalización 3PT2	3.4%
Clinica CES	2.9%

**Activos con Programas**  
Cuenta los Activos con y sin PM

Categoría	Porcentaje
Activos con PM	67.3%
Activos sin PM	32.7%

**Activos con Órdenes de Trabajo**  
Cuenta los Activos con y sin OT

Categoría	Porcentaje
Activos con OT	4.4%
Activos sin OT	95.6%

**Activos con Solicitudes de Servicio**  
Cuenta los Activos con y sin SS

Categoría	Porcentaje
Activos con SS	0.8%
Activos sin SS	99.2%

**Activos con Repuestos asociados**  
Cuenta los Activos con RP asociados

Categoría	Porcentaje
Activos con RP	2.6%
Activos sin RP	97.4%

**Activos con Características Técnicas**  
Cuenta los Activos con Características Técnicas diligenciada

6110

Categoría	Porcentaje
Con FT Diligenciada	0.4%
Sin FT Diligenciada	99.6%

6110

**Activos con póliza**  
Cuenta los AC con póliza activa clasificados por grupo

6110

Categoría	Porcentaje
AC con poliza 1057	17.3%
AC sin poliza 5053	82.7%

**Activos con información de Metrología**  
Cuenta los AC con Información de Metrología clasificados por grupo

6110

Categoría	Porcentaje
AC con Metrología 2	0.0%
AC sin Metrología 6108	100.0%

6110

**Activos con Registro Sanitario Invima**  
Cuenta los AC con Registro Sanitario Invima clasificados por grupo

Categoría	Porcentaje
AC con Registro Sanitario Invima 146	2.4%
AC sin Registro Sanitario Invima 5964	97.6%



**Imagen 76.** Activos - Dashboard

La información del rectángulo de color naranja ubicado en la parte superior derecha como guía a modo de fracción ( $N/M$ ), indica el número de registros del subgrupo en el visor( $N$ ) sobre el número total de registros de Activos existentes en la base de datos ( $M$ ). Si no hay preselección, los dos números en sus totales son los mismos. También un indicador de la existencia de un subgrupo, es el ícono  $\neq$  con una pelota de color rojo que se ubica al lado derecho de dicha fracción.

**Infraestructura** **Activos** **Almacén** **Kárdex** **Combustibles** **Programas** **Solicitudes** **Paros** **Órdenes** **Historia** **⋮**

### Dashboard de Activos

**Estados de los Activos**  
Cuenta los Activos clasificados por estado

Estado	Porcentaje
A - En Operación	81.7%
I - Dado de Baja	22.6%
I - No está en Operación	14.7%
A - En Convenio	1.1%
Otro	0.0%

**266 / 6110** ⋮

### Grupo de Activos

Cuenta los Activos por grupo

Grupo	Porcentaje
Apoyo administrativo	6.0%
Equipo de apoyo	0.4%
Infraestructura	0.0%
Biomédico	67.7%
Ninguno	25.0%

**Centros de Costo**  
Cuenta los 12 Centros de Costos con mas Activos

Centro de Costo	Porcentaje
Cirugía	25.6%
Unidad de Cuidados Intensivos	15.4%
Unidad de Cuidados Especiales	12.4%
Urgencias	11.7%
Unidad de Cardiología	8.0%
Ingeniería Biomédica	3.8%
Servicio de Observación Especializada	3.8%
Hospitalización 5PT3	3.4%
Hospitalización 3PT1	2.6%
Hospitalización 4PT1	1.9%
Consulta Externa	1.9%
Hospitalización 4PT2	1.5%
Otro	10.2%

**Activos con Programas**  
Cuenta los Activos con y sin PM

Categoría	Porcentaje
Activos con PM	94.4%
Activos sin PM	5.6%

**Activos con Órdenes de Trabajo**  
Cuenta los Activos con y sin OT

Categoría	Porcentaje
Activos con OT	17.7%
Activos sin OT	82.3%

**Activos con Solicitudes de Servicio**  
Cuenta los Activos con y sin SS

Categoría	Porcentaje
Activos con SS	2.3%
Activos sin SS	97.7%

**Activos con Repuestos asociados**  
Cuenta los Activos con RP asociados

Categoría	Porcentaje
Activos con RP	9.0%
Activos sin RP	91.0%

**Activos con Características Técnicas**  
Cuenta los Activos con Características Técnicas diligenciada

266

Categoría	Porcentaje
Con FT Diligenciada	0.0%
Sin FT Diligenciada	100.0%

**Activos con póliza**  
Cuenta los AC con póliza activa clasificados por grupo

266

Categoría	Porcentaje
AC con poliza 181	68.0%
AC sin poliza 85	32.0%

**Activos con información de Metrología**  
Cuenta los AC con Información de Metrología clasificados por grupo

266

Categoría	Porcentaje
AC con Metrologia	0.0%
AC sin Metrologia	100.0%

**Activos con Registro Sanitario Invima**  
Cuenta los AC con Registro Sanitario Invima clasificados por grupo


266

Categoría	Porcentaje
AC con Registro Sanitario Invima	3.8%
AC sin Registro Sanitario Invima	96.2%

**Activos con Registro Sanitario Invima**  
Cuenta los AC con Registro Sanitario Invima clasificados por grupo


266

Categoría	Porcentaje
AC con Registro Sanitario Invima	3.8%
AC sin Registro Sanitario Invima	96.2%

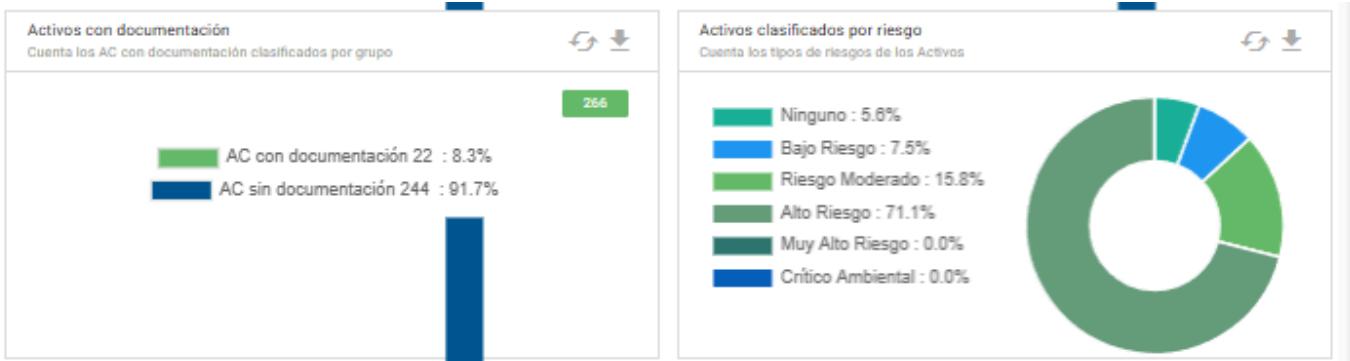


**Imagen 77.** Activos - Dashboard Subgrupos

Para personalizar la vista de los gráficos o tener una información específica se recomienda hacer subgrupos a través del ícono subgrupo . Asimismo los Dashboards permiten ocultar información con solo dar un clic sobre sus rectángulos de colores como se muestra en la siguiente imagen:

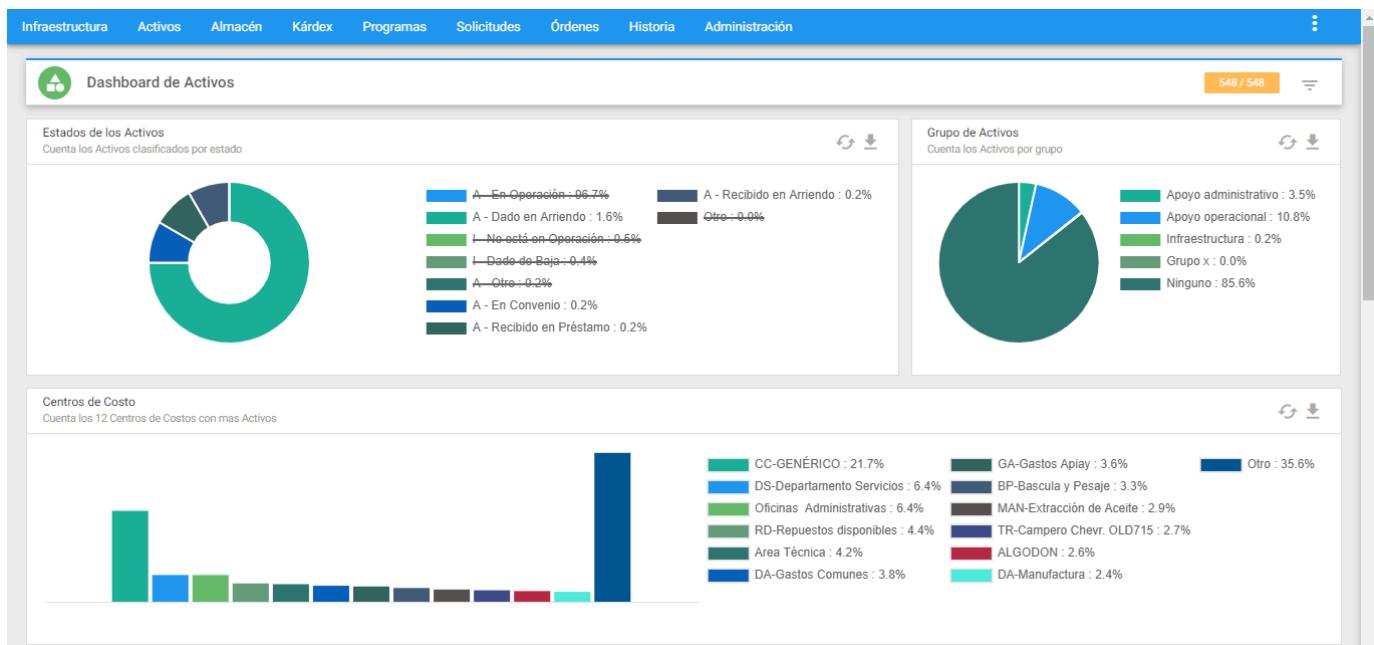

**Imagen 78.** Activos - Dashboard personalizado

Sí se desea restablecer la información, se debe dar clic al ícono (actualizar). En cambio, si se desea exportar el gráfico en un formato de imagen, es posible dando clic al ícono de la flecha hacia abajo como se muestra a continuación:

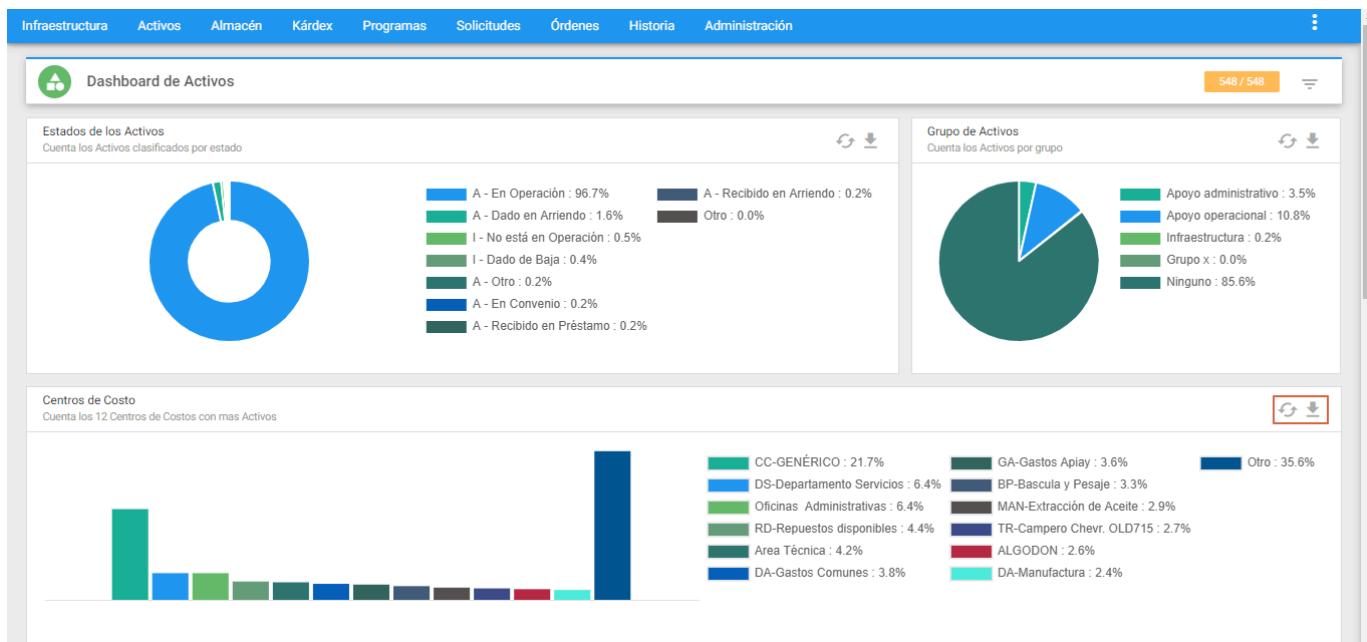

**Imagen 79.** Activos - Dashboard personalizado