



Roasting

Intermediate

Roast Color Correlation

工作表



Specialty
Coffee
Association




SCA认证系统中的烘焙色度相关性

为了得出不同烘焙色度分析仪之间实际的相关性，我们准备了5份不同烘焙色度的样品，每一份样品都通过3种不同的烘焙色度测量仪测量了6次。

- MyTonino (2016年底版)
- Javalitics JAV-RDA-DN
- ColorTrack

如果将咖啡从深烘到浅烘的程度作为X轴排列的话，每个色度测量仪的图表如图所示：

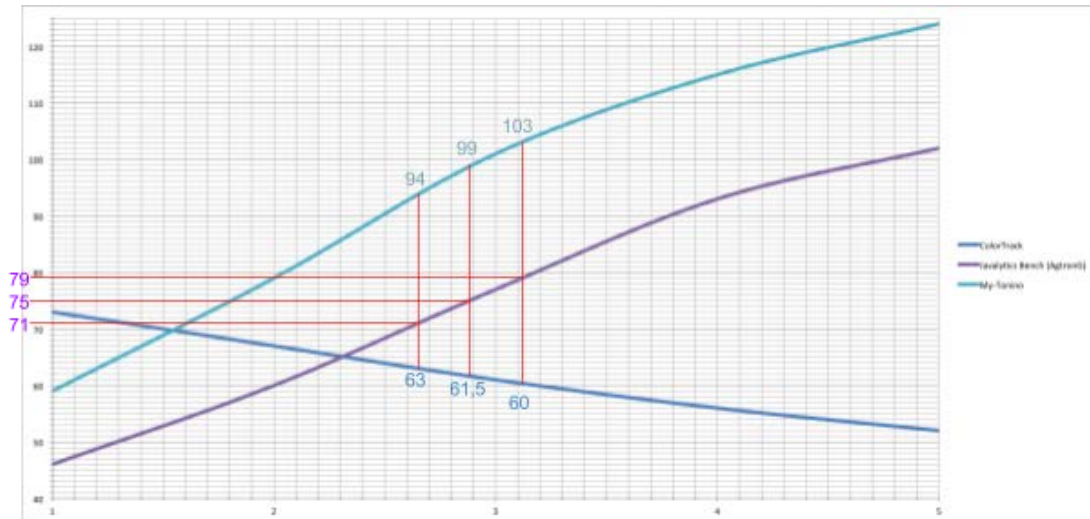

在过去的SCAE资料中，烘焙色度精确度挑战需要在Agtron Gourmet量度 ± 4 的范围之内才能得到最高的分数，Agtron Gourmet量度 ± 8 可以得到第二高的分数。这个挑战也被带到了新的SCA中级认证系统中。为了在使用其他色度测量仪时也能够进行这个测试，我们需要知道 MyTonino和ColorTrack这类的测量仪之间的不同之处。上方的图表显示了它们的测量值和它们之间的差距。

$$\begin{aligned} \pm 4 \text{ Agtron Gourmet} &\cong \pm 4.5 \text{ MyTonino} \cong \pm 1.5 \text{ ColorTrack} \\ \pm 8 \text{ Agtron Gourmet} &\cong \pm 9 \text{ MyTonino} \cong \pm 3 \text{ ColorTrack} \end{aligned}$$

上述数据提取自CoffeeMind Academy的一些为其他目的而设计的规范中的数据，但这些被提取的数据对SCA培训师在色度相关性的方面有所帮助。这一项目研究并不详尽，因为它应该在一系列不同的咖啡上进行测试。但为了我们比较的目的，我们只在一种咖啡上做了测试（Colombia Horizontes）。下方使用的是Tonino 99 = Agtron 75 = ColorTrack 61,5 作为参考指数(当烘焙在一爆和二爆之间停止的时候经常会得到这种颜色)

CoffeeMind

www.coffee-mind.com