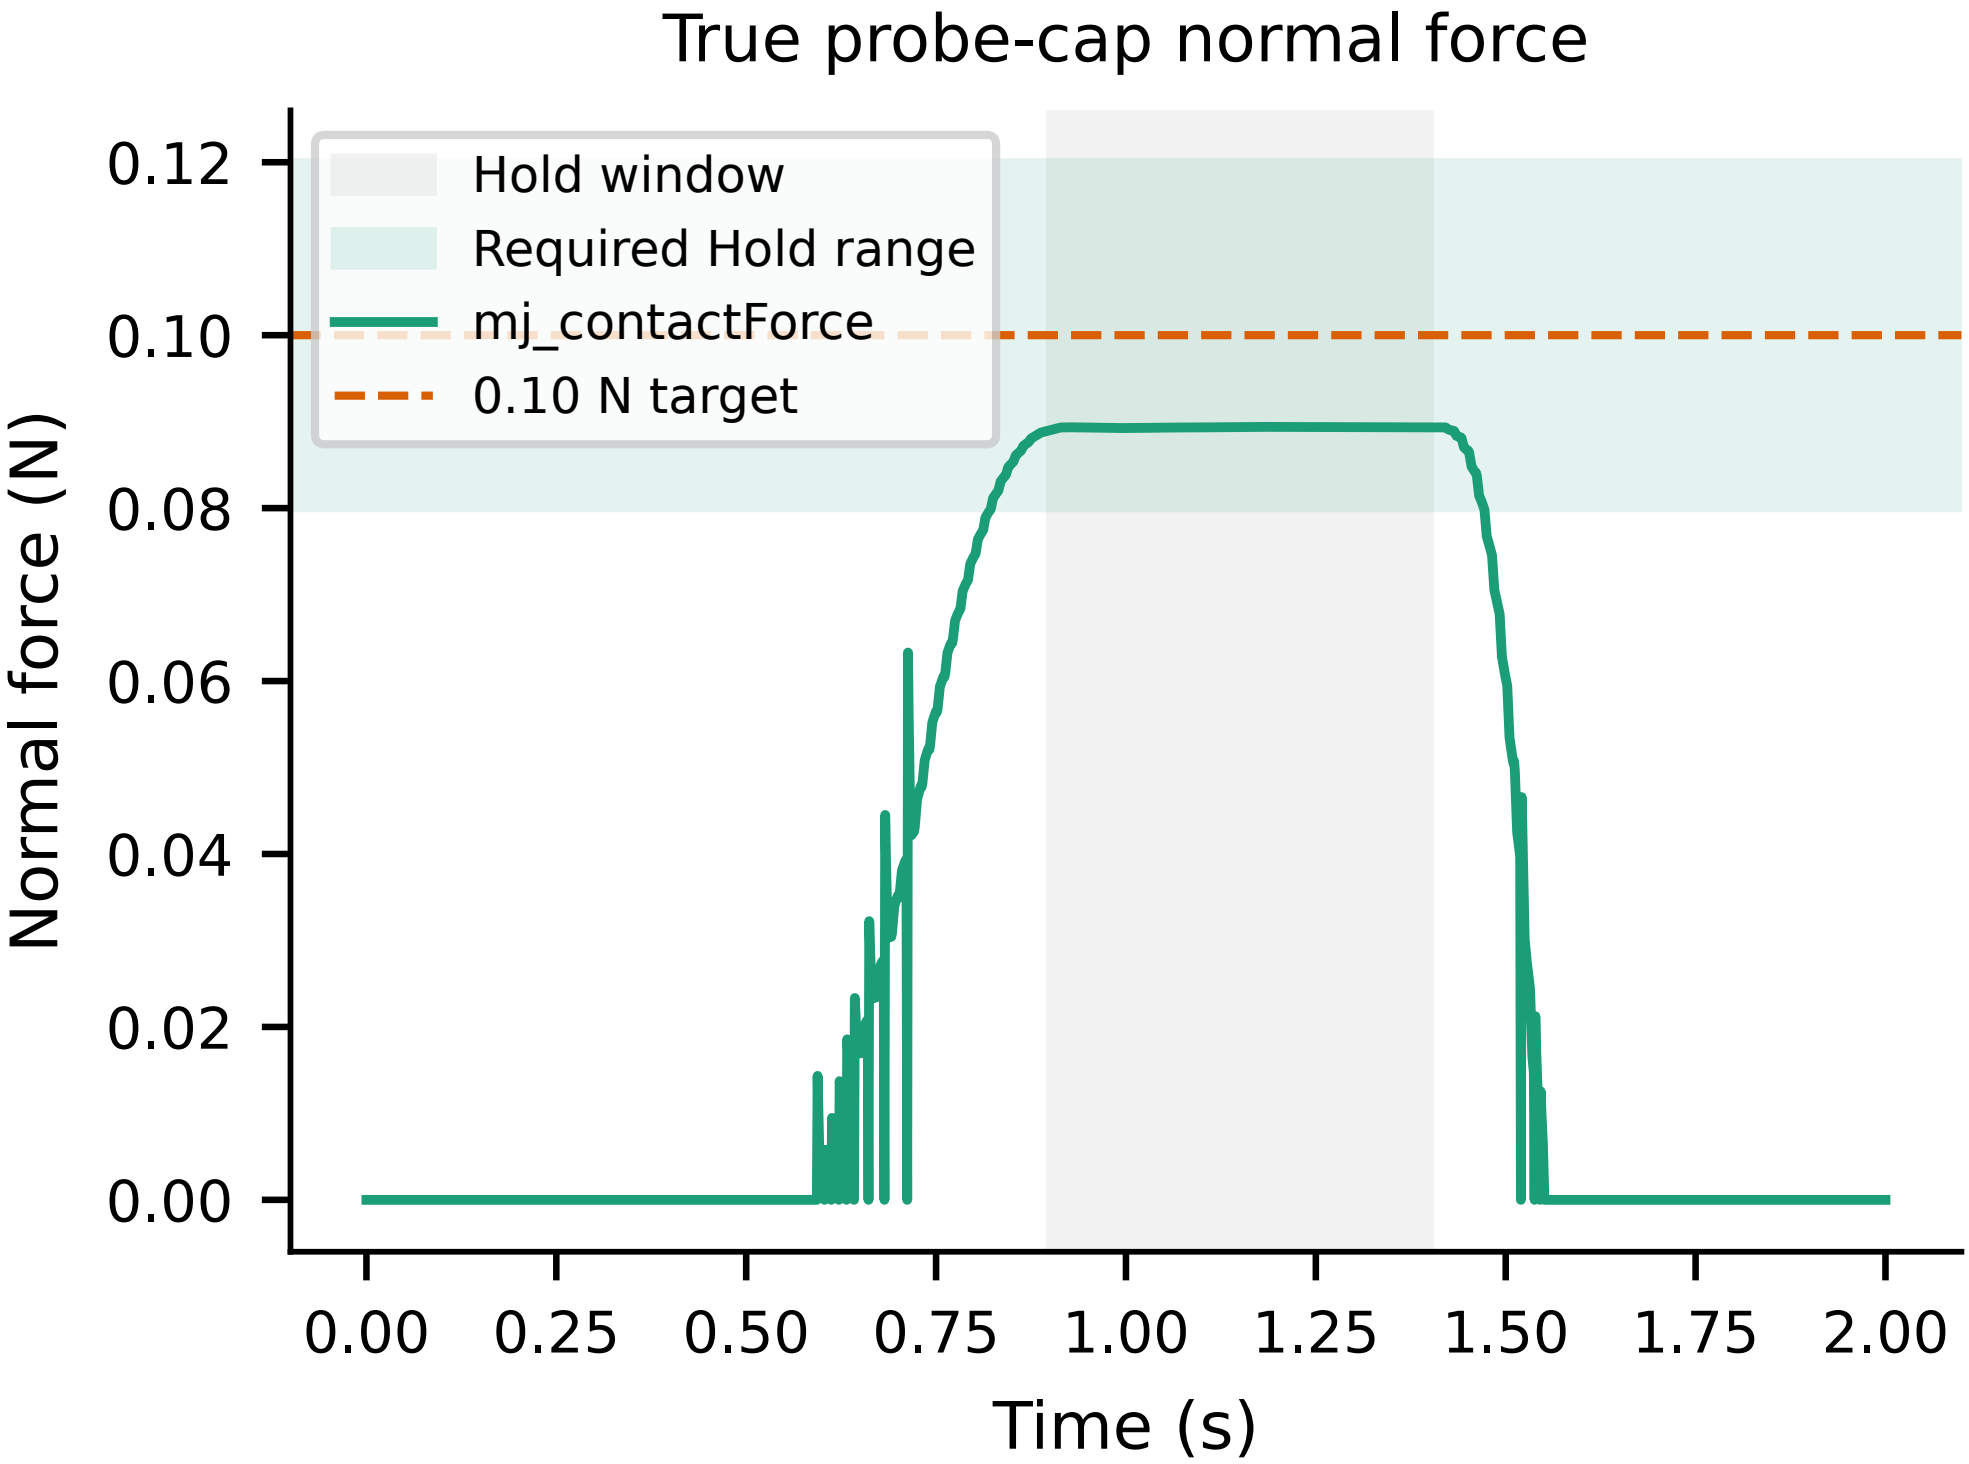
True probe-cap normal force
Hold window
Required Hold range
mj_contactForce
0.10 N target
Normal force (N)
0.12
0.10
0.08
0.06
0.04
0.02
0.00
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50
1.75
2.00
Time (s)