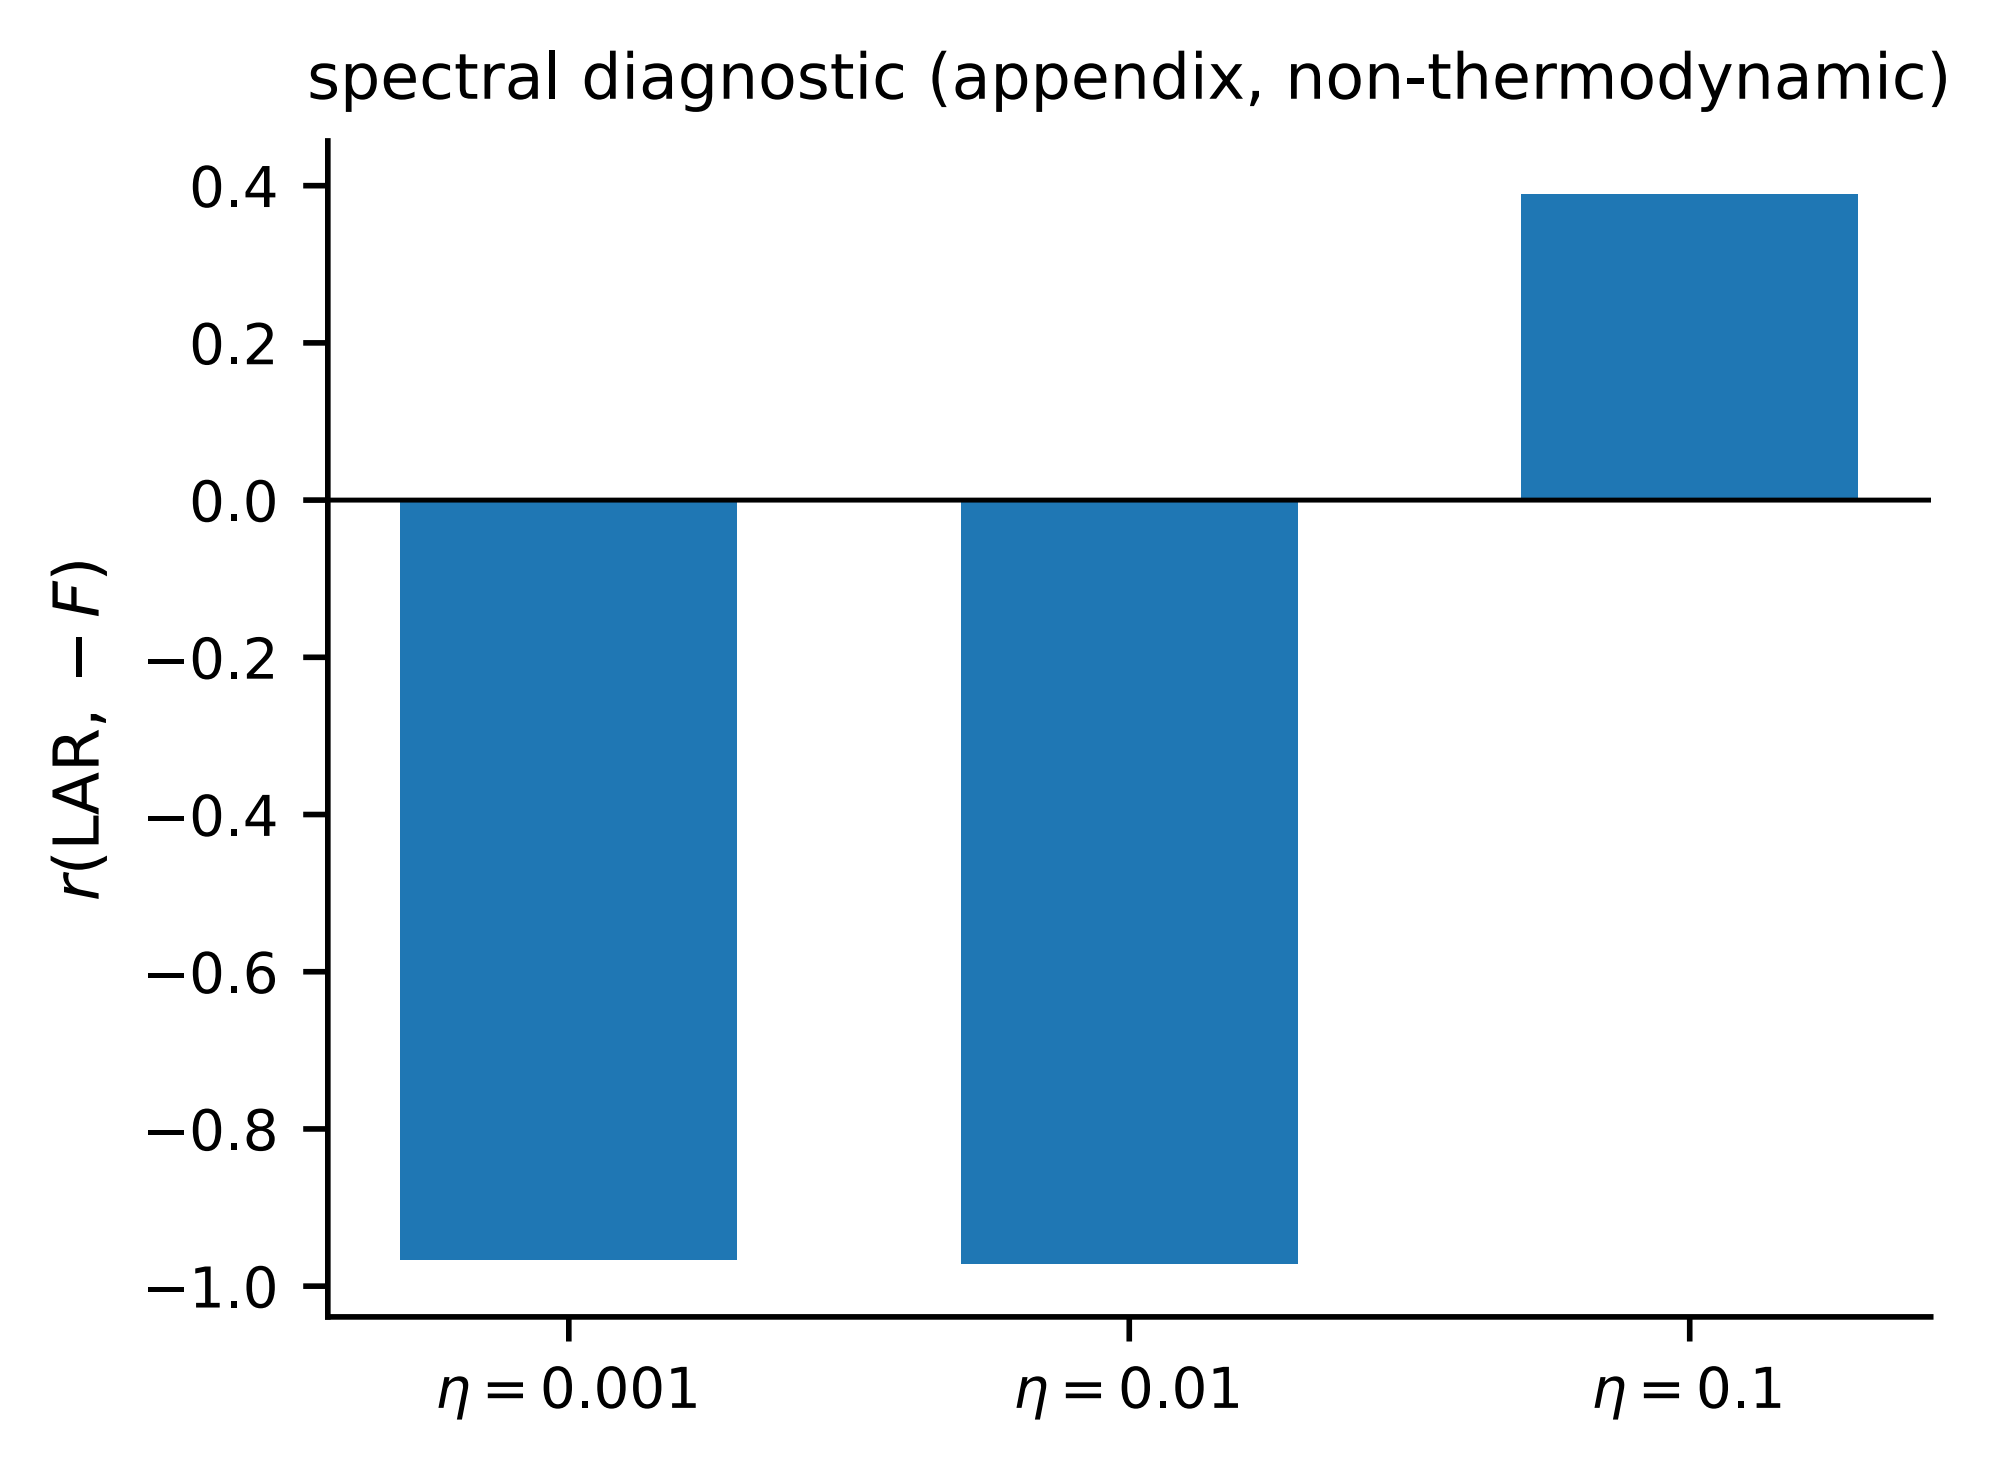
spectral diagnostic (appendix, non-thermodynamic)
0.4
0.2
0.0
−0.2
−0.4
−0.6
−0.8
−1.0
r(LAR, −F)
η = 0.001
η = 0.01
η = 0.1