


微玢回液、失吸容量与回收瓶接口

HJ-018

全湿段回流计入容量；瓶内库存由干式自由出液接口隔开；止回阀不计减益

液路布置（高程与管长按标注，NTS）

上下Ø60罩；下杯接触中心环，无孔壁滑擦

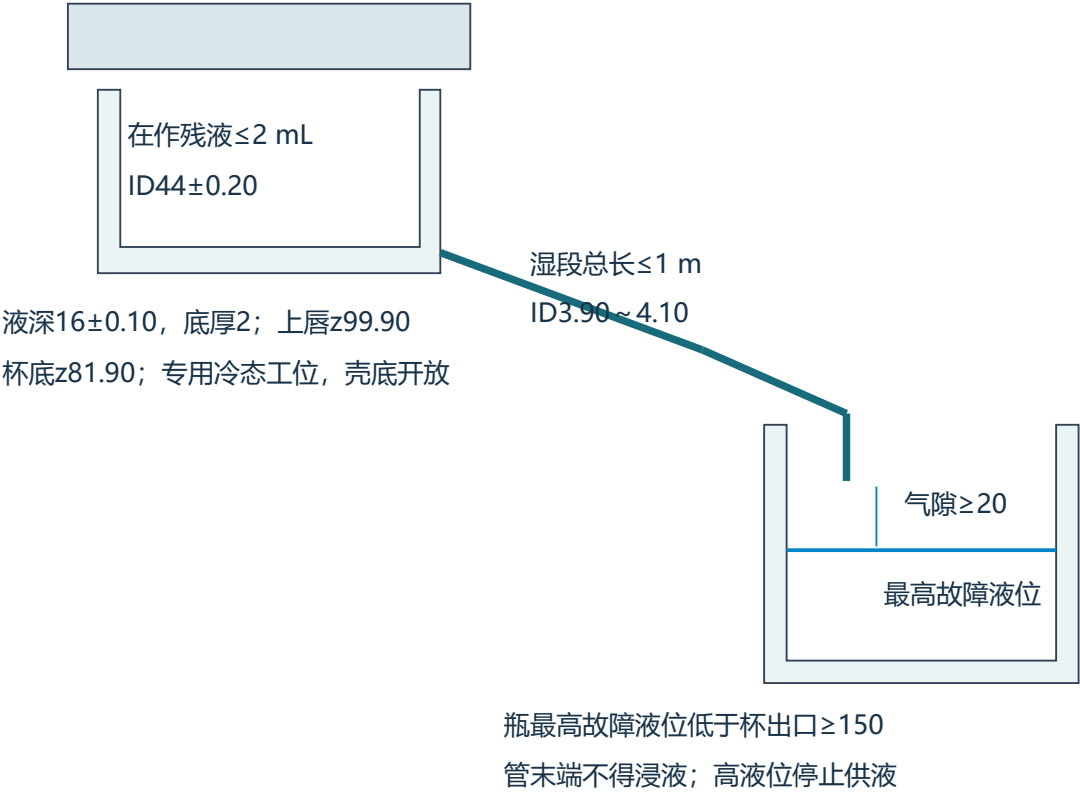

管线连续下坡固定；杯液位/净差压/瓶液位异常时0.10 s内停进给与供液
撤出前排尽并干燥、封回液口；不打开含液屏障，不以整腔冲洗补救

容量最不利：ID43.80、液深15.90
工具占位 $\leq 3.0\text{ mL}$ ；杯在作液 ≤ 2.0
净容积20.957 mL
 $\varnothing 4.10\times 1\text{ m}$ 全管回流13.203 mL
上罩及接头回流 $\leq 1.0\text{ mL}$
供液阀下游可排液 $\leq 0.50\text{ mL}$
 $60\text{ mL/min}\times 0.10\text{ s}=0.10\text{ mL}$
在作2 + 储备2亦计入故障需求
合计18.803，余量2.155 mL
瓶故障液位以下容量 $\geq 200\text{ mL}$
净驱动差压 $\geq 2.5\text{ kPa}$ ，扣测量U
 $\Delta p = p_{\text{杯}} - p_{\text{瓶}} + \rho g(z_{\text{杯}} - z_{\text{出液}})$
计算流量154.510 mL/min
牛顿液 $\mu \leq 5\text{ mPa}\cdot\text{s}$ ，局部 $K \leq 10$
非牛顿UT凝胶用独立回收资格
每件封闭供液筒 $\leq 35\text{ mL}$ ；作业中不续液
开工前瓶存液 ≤ 100 ；单循环最高151.703
装机验收湿段、死腔、液位及停机延迟

工艺设计图 · 单位mm · 未注公差 ± 0.10 关键配合按尺寸；检验按说明书§7执行	比例：NTS（不按比例） 视图NTS；不得量图取值	材料：316L / 回液软管 工序与零件见明细	工艺设计图 / 修订5 试制检验按说明书执行
--	------------------------------	----------------------------	---------------------------