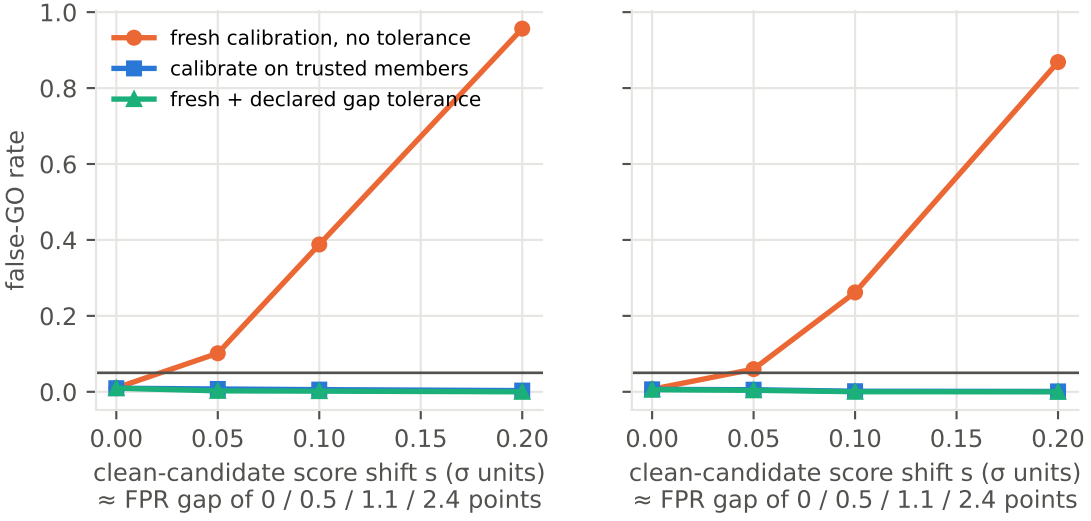
π = 1% (true TPR ≈ 0.43, target 0.5)
π = 5% (true TPR ≈ 0.43, target 0.5)
fresh calibration, no tolerance
calibrate on trusted members
fresh + declared gap tolerance
false-GO rate
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
clean-candidate score shift s (σ units)
≈ FPR gap of 0 / 0.5 / 1.1 / 2.4 points