

附件5：多卡同机操作

说明书

说明书版本：V2.03

更新日期：2016.10.01

多个 USBCAN 总线适配器/CANalyst-II 分析仪等在同一台电脑上使用。使用流程如下：

1、把他们接入同一台电脑，会提示安装新硬件驱动。USBCAN总线适配器/CANalyst-II 分析仪使用相同的USB驱动，一台电脑只需要安装一次驱动。如果插上电脑，设备管理器已能正常加载驱动，可直接跳过此步骤。

2、打开“USB_CAN TOOL.exe”，在“设备类型”菜单中选择要打开的设备类型，然后点击菜单：“设备操作”->“启动设备”打开“打开USB设备对话框”，如下图：

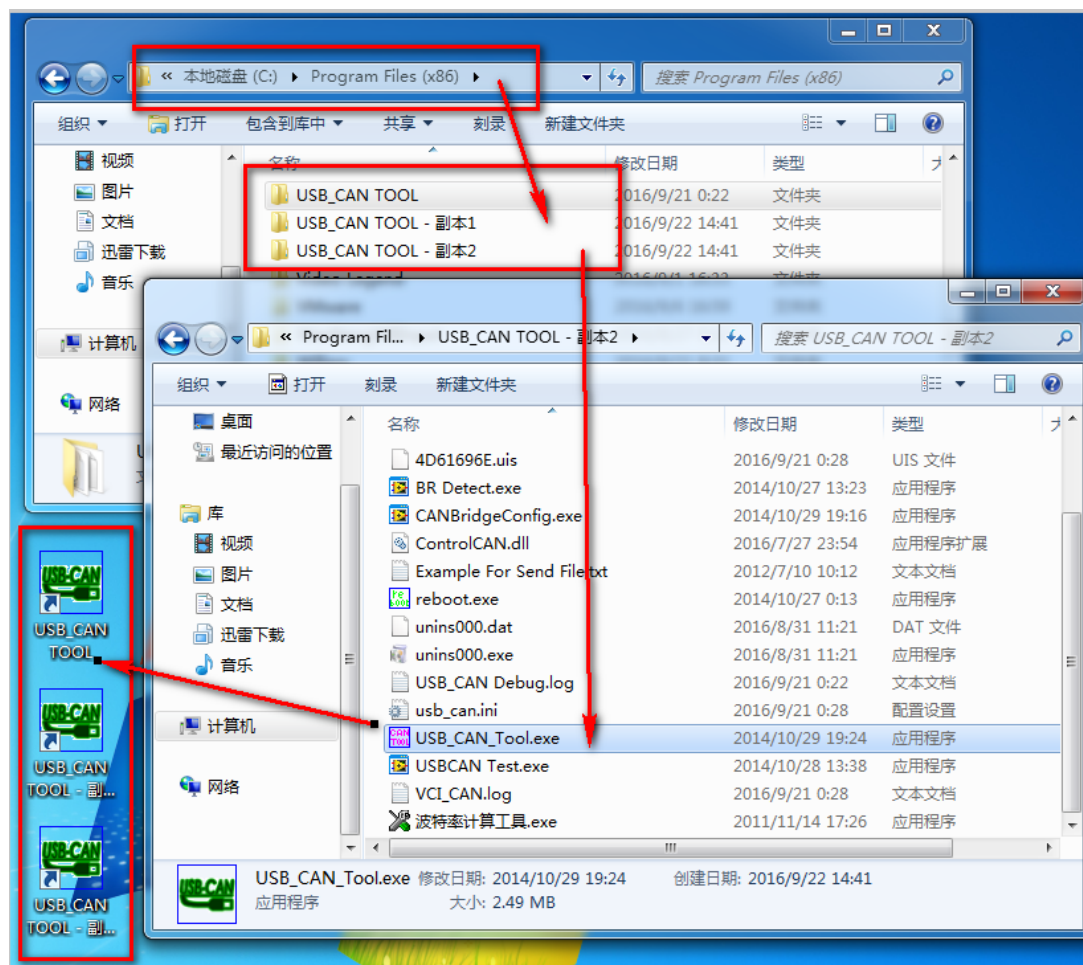


图1 选择计算机中的一个USB-CAN适配器

选择要打开的设备，点击“打开”，然后进行相应软件操作即可。

3、创建副本：

找到USB_CAN TOOL 软件安装目录，默认为C:\Program Files (x86)\USB_CAN TOOL，把USB_CAN TOOL文件夹根据需要创建副本（复制），分别把USB_CAN TOOL.exe创建桌面快捷方式，并重命名。



4、依次打开副本中的“USB_CAN TOOL.exe”，在“设备类型”菜单中选择要打开的设备类型，然后点击菜单：“设备操作”->“启动设备”打开“打开USB设备对话框”，如下图所示：

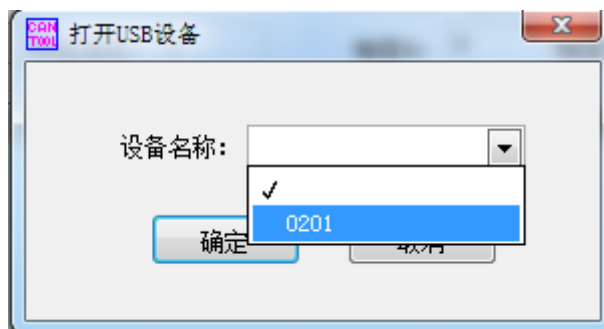


图2 选择计算机中另一个USB-CAN适配器

选择要打开的设备，点击“打开”，然后进行相应软件操作即可。

注意：一个“USB_CAN TOOL.exe”只能加载一个USB_CAN-2(x)或CANalyst-II分析仪，打开设备列表下拉框中会显示所有连接到计算机上的USB_CAN-2(x)或CANalyst-II分析仪的序

注意：一台电脑最多支持 10 个以上 USB_CAN 设备。

