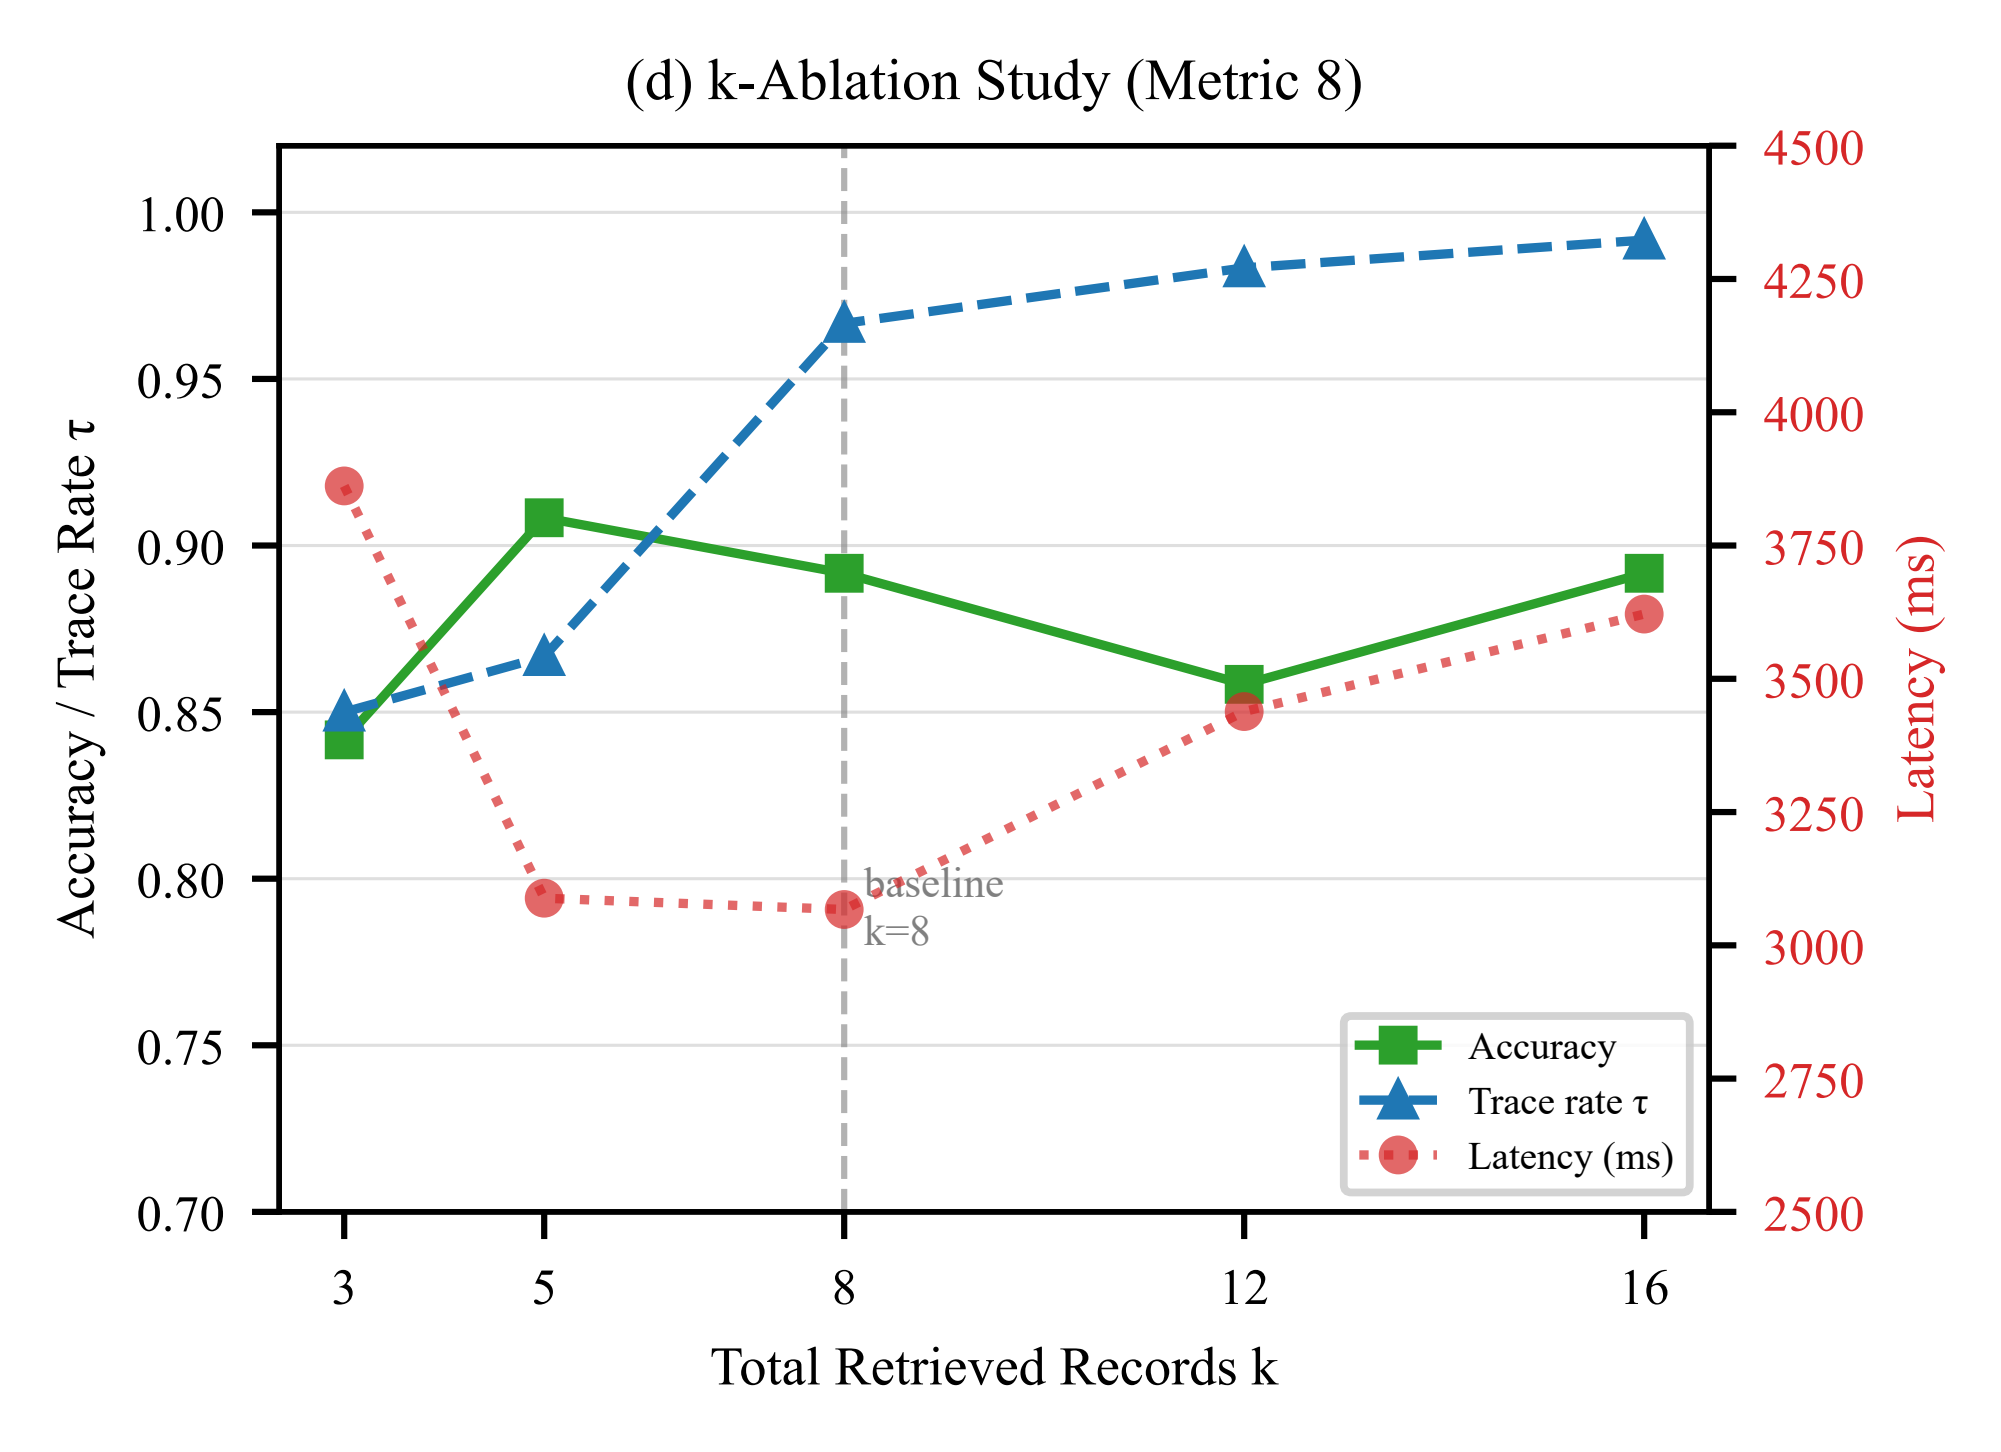
(d) k-Ablation Study (Metric 8)
Accuracy / Trace Rate τ
Latency (ms)
Total Retrieved Records k
1.00
0.95
0.90
0.85
0.80
0.75
0.70
4500
4250
4000
3750
3500
3250
3000
2750
2500
3
5
8
12
16
baseline
k=8
Accuracy
Trace rate τ
Latency (ms)