


膜電位(GHKの式)のシミュレータ

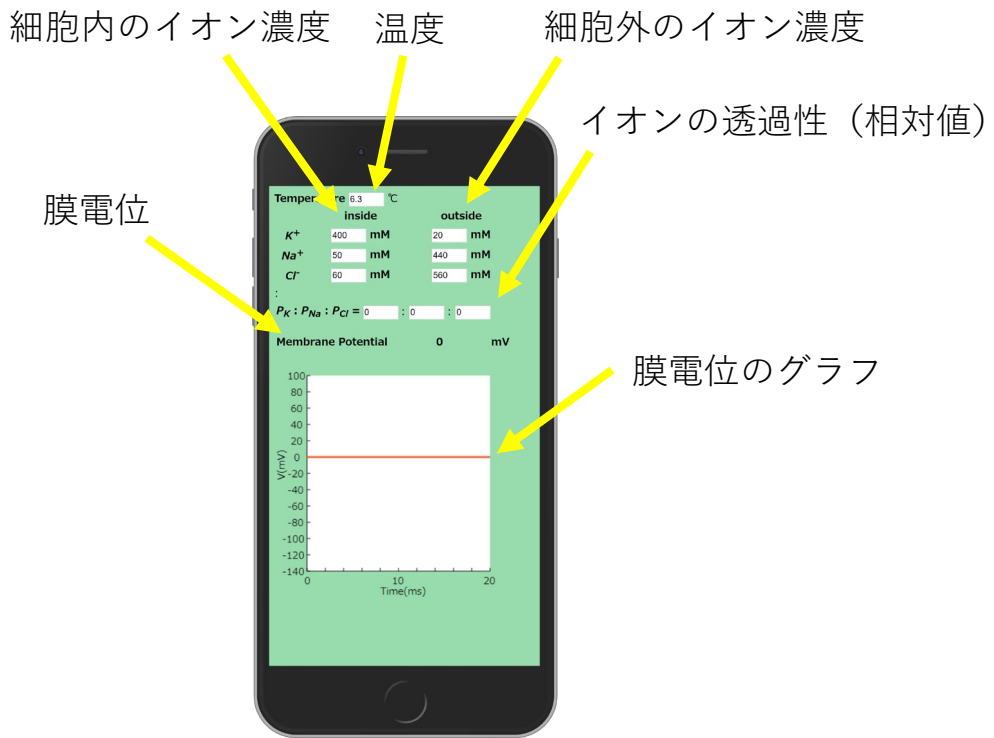

1. 温度を設定する。
2. K⁺, Na⁺, Cl⁻のそれぞれの細胞内のイオン濃度（左）と細胞外のイオン濃度（右）を設定する。
3. K⁺, Na⁺, Cl⁻のそれぞれのイオン透過性を設定する。
4. パラメータを変更するたびに、パラメータに応じた膜電位が自動的に表示される。