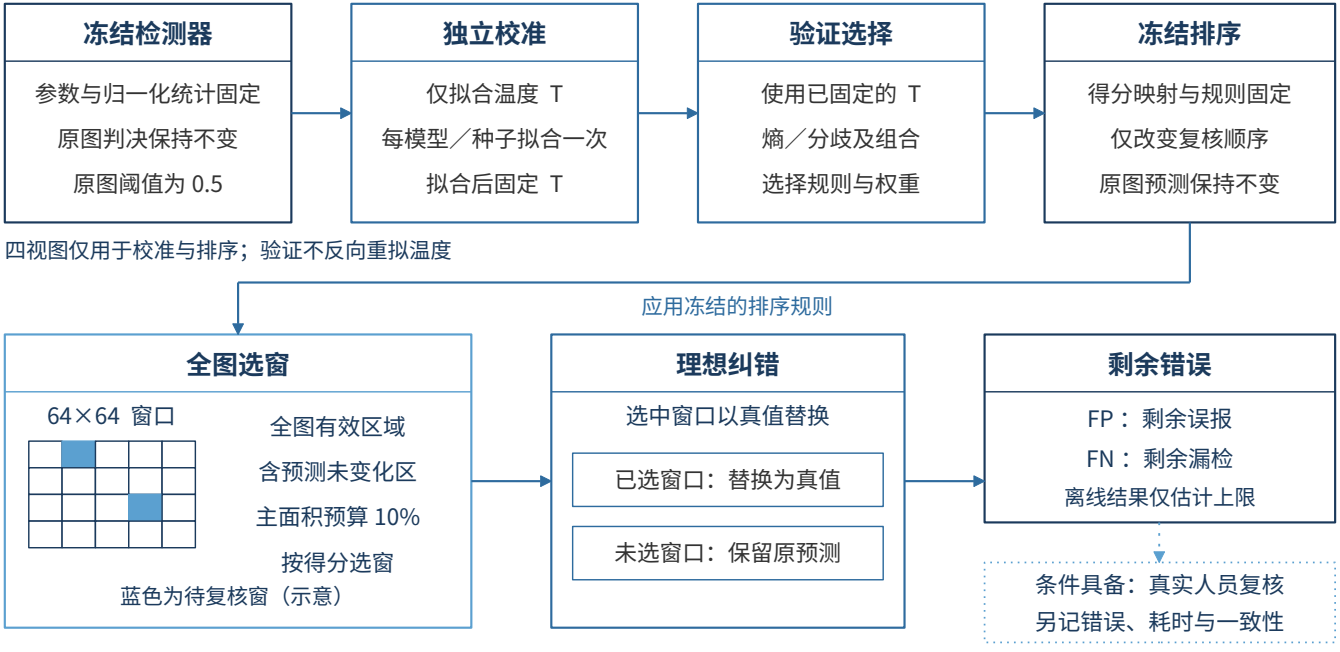

冻结检测器
参数与归一化统计固定
原图判决保持不变
原图阈值为 0.5
独立校准
仅拟合温度 T
每模型／种子拟合一次
拟合后固定 T
验证选择
使用已固定的 T
熵／分歧及组合
选择规则与权重
冻结排序
得分映射与规则固定
仅改变复核顺序
原图预测保持不变
四视图仅用于校准与排序；验证不反向重拟温度
应用冻结的排序规则
全图选窗
64×64 窗口
全图有效区域
含预测未变化区
主面积预算 10%
按得分选窗
蓝色为待复核窗（示意）
理想纠错
选中窗口以真值替换
已选窗口：替换为真值
未选窗口：保留原预测
剩余错误
FP： 剩余误报
FN： 剩余漏检
离线结果仅估计上限
条件具备：真实人员复核
另记错误、耗时与一致性