
## نقاط الحافة


| u° | السيرفو° | R | الفتحة | الجريان% | المنطقة |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 10 | 23.00 | 4.60 | 100 | فتح |
| 15 | 25 | 23.00 | 4.60 | 100 | سريعة |
| 25 | 35 | 23.73 | 3.87 | 100 | سريعة |
| 35 | 45 | 25.09 | 2.51 | 99 | سريعة |
| 45 | 55 | 25.82 | 1.78 | 95 | ضبط |
| 55 | 65 | 26.06 | 1.54 | 84 | ضبط |
| 65 | 75 | 26.15 | 1.45 | 73 | ضبط |
| 75 | 85 | 26.21 | 1.39 | 61 | ضبط |
| 85 | 95 | 26.25 | 1.35 | 50 | ضبط |
| 95 | 105 | 26.28 | 1.32 | 39 | ضبط |
| 105 | 115 | 26.32 | 1.28 | 28 | ضبط |
| 115 | 125 | 26.35 | 1.25 | 17 | ضبط |
| 125 | 135 | 26.40 | 1.20 | 6 | ضبط |
| 130 | 140 | 26.50 | 1.10 | 0 | قفل |
| 135 | 145 | 26.60 | 1.00 | 0 | قفل |
| 139 | 149 | 26.75 | 0.85 | 0 | قفل |
| 143 | 153 | 26.60 | 1.00 | 0 | قفل |
| 150 | 160 | 26.60 | 1.00 | 0 | قفل |
| 160 |  | 26.60 | 1.00 | 0 | رجوع |
| 200 |  | 24.42 | 3.18 |  | رجوع |
| 230 |  | 23.00 | 4.60 |  | فتح |
| 230-360 |  | 23.00 | 4.60 |  | فتح |

R من محور الشفت. الفتحة بين الحافة ووجه الجسر عند هذه الزاوية. الجريان تقدير محسوب. كل درجة بالملف `cam-profile.csv`.


### منظر من الأعلى

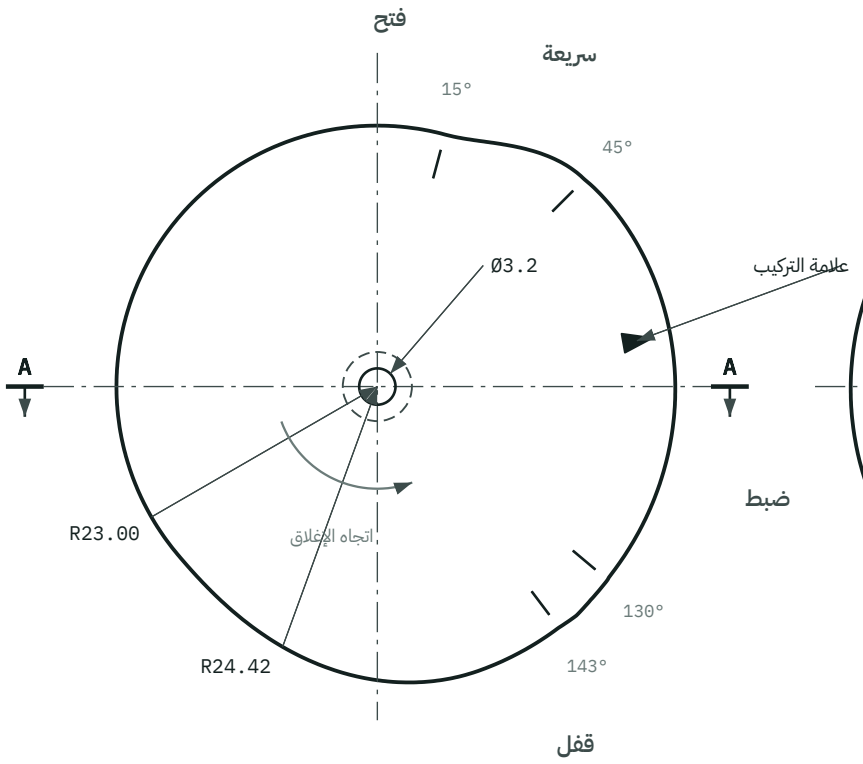


### منظر من الأسفل، جهة السيرفو

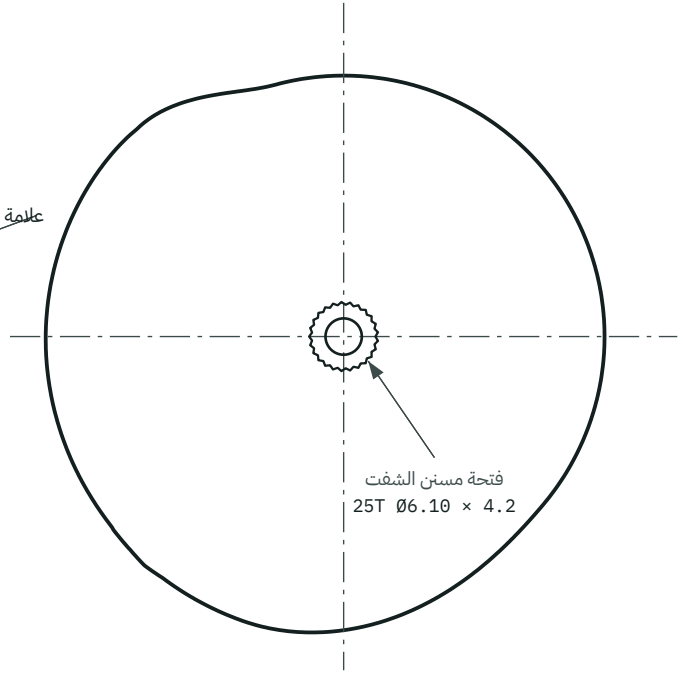


### المقطع A-A

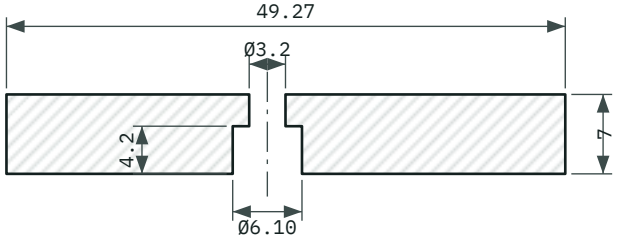


### الطباعة والتركيب

1. اطبعها والوجه العلوي على السرير، ففتحة المسنن تطلع لفوق بدون دعامات.
2. تركب على مسنن الشفت مباشرة بدل الريشتين، وبرغي الريشتين يشدها من فوق.
3. على 90° ركّبها بحيث علامة التركيب أقرب ما يكون للجسر. الفتح 20°، الضبط 55° إلى 140°، السد 160°.
4. العلامات محفورة 0.4 ملم على الوجه العلوي.


## القطعة 1: الكامة، بدل الريشتين

| المشروع | اللوحة |
|---|---|
| صمام الكامة لجهاز مراقبة المغذي | 1 / 2 |
| **المادة** | **المقياس** |
| PETG، حشوة 100% | 1 : 1.5، الأبعاد بالملم |

**الحالة**

أبعاد السيرفو من مخطط TowerPro لهيكل MG945. تتأكد بالقياس: طول مسنن الشفت وقطر الأنبوب


### المقطع B-B عند محور الشفت

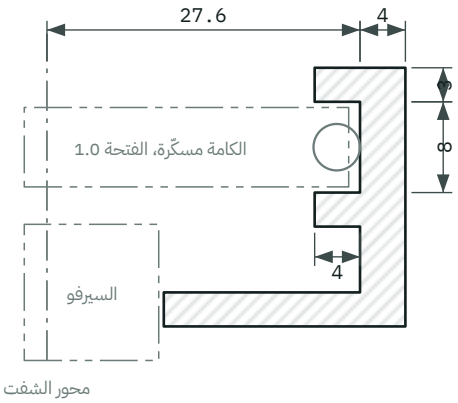



### الطباعة والتركيب

1. اطبعه وظهر الجدار على السرير: الحافتين والضلعين والمشابك والقاعدة كلها تطلع لفوق، بدون دعامات.
2. القاعدة تنحط على أذنين السيرفو، والأذنين على تبويبي حامل السيرفو من اردونك (ARD-080016). أربع براغي M3 × 12 مع صواميل تمر بالجسر والأذنين والحامل. والحامل ينربط على اللوح من صفيحته الطويلة، فالشفت يطلع لبرة من اللوح.
3. الفتحات الطويلة تسمح بتحريك الجسر 1 ملم نحو الكامة أو بعيد عنها: اضبطه على السد الكامل وشد البراغي.
4. الأنبوب ينكبس بين أصابع المشبكين (الفتحة 4.2، الإصبع 4.9 × 1.5 × 3)، ويمر بالمجرى بين الحافتين.
5. الفتحات الطويلة 5.8 × 3.8. الضلعين سمكهن 3 وارتفاعهن 5.8 فوق القاعدة.
6. الخطوط المتقطعة الرفيعة للسيرفو والكامة والأنبوب، للتوضيح، ومو جزء من القطعة.

### منظر من الأعلى

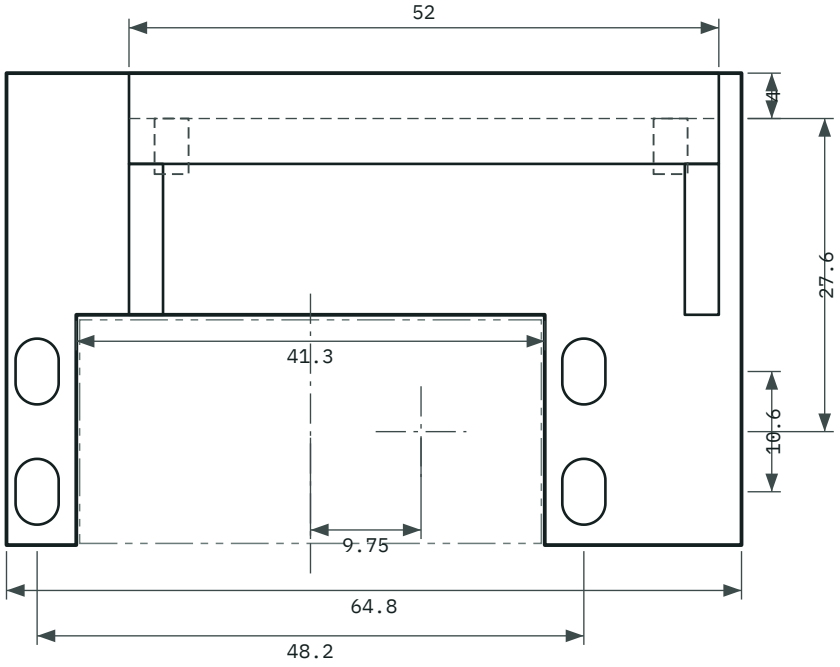


### منظر أمامي، من جهة الكامة

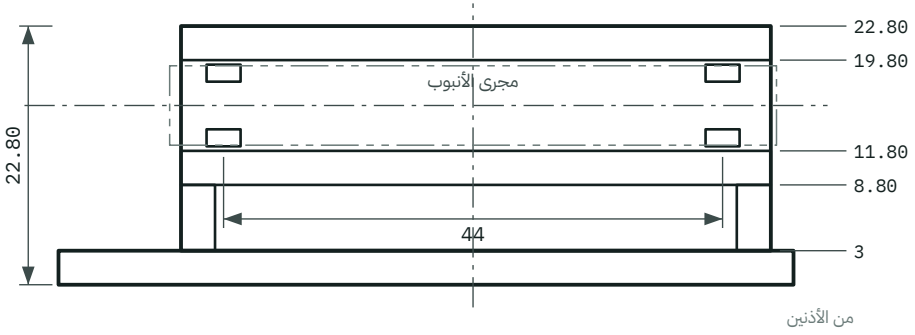


## القطعة 2: الجسر الثابت

| المشروع | اللوحة |
|---|---|
| صمام الكامة لجهاز مراقبة المغذي | 2 / 2 |
| **المادة** | **المقياس** |
| PETG، حشوة 100% | 1 : 1.5، الأبعاد بالملم |

**الحالة**

أبعاد السيرفو من مخطط TowerPro لهيكل MG945. تتأكد بالقياس: طول مسنن الشفت وقطر الأنبوب