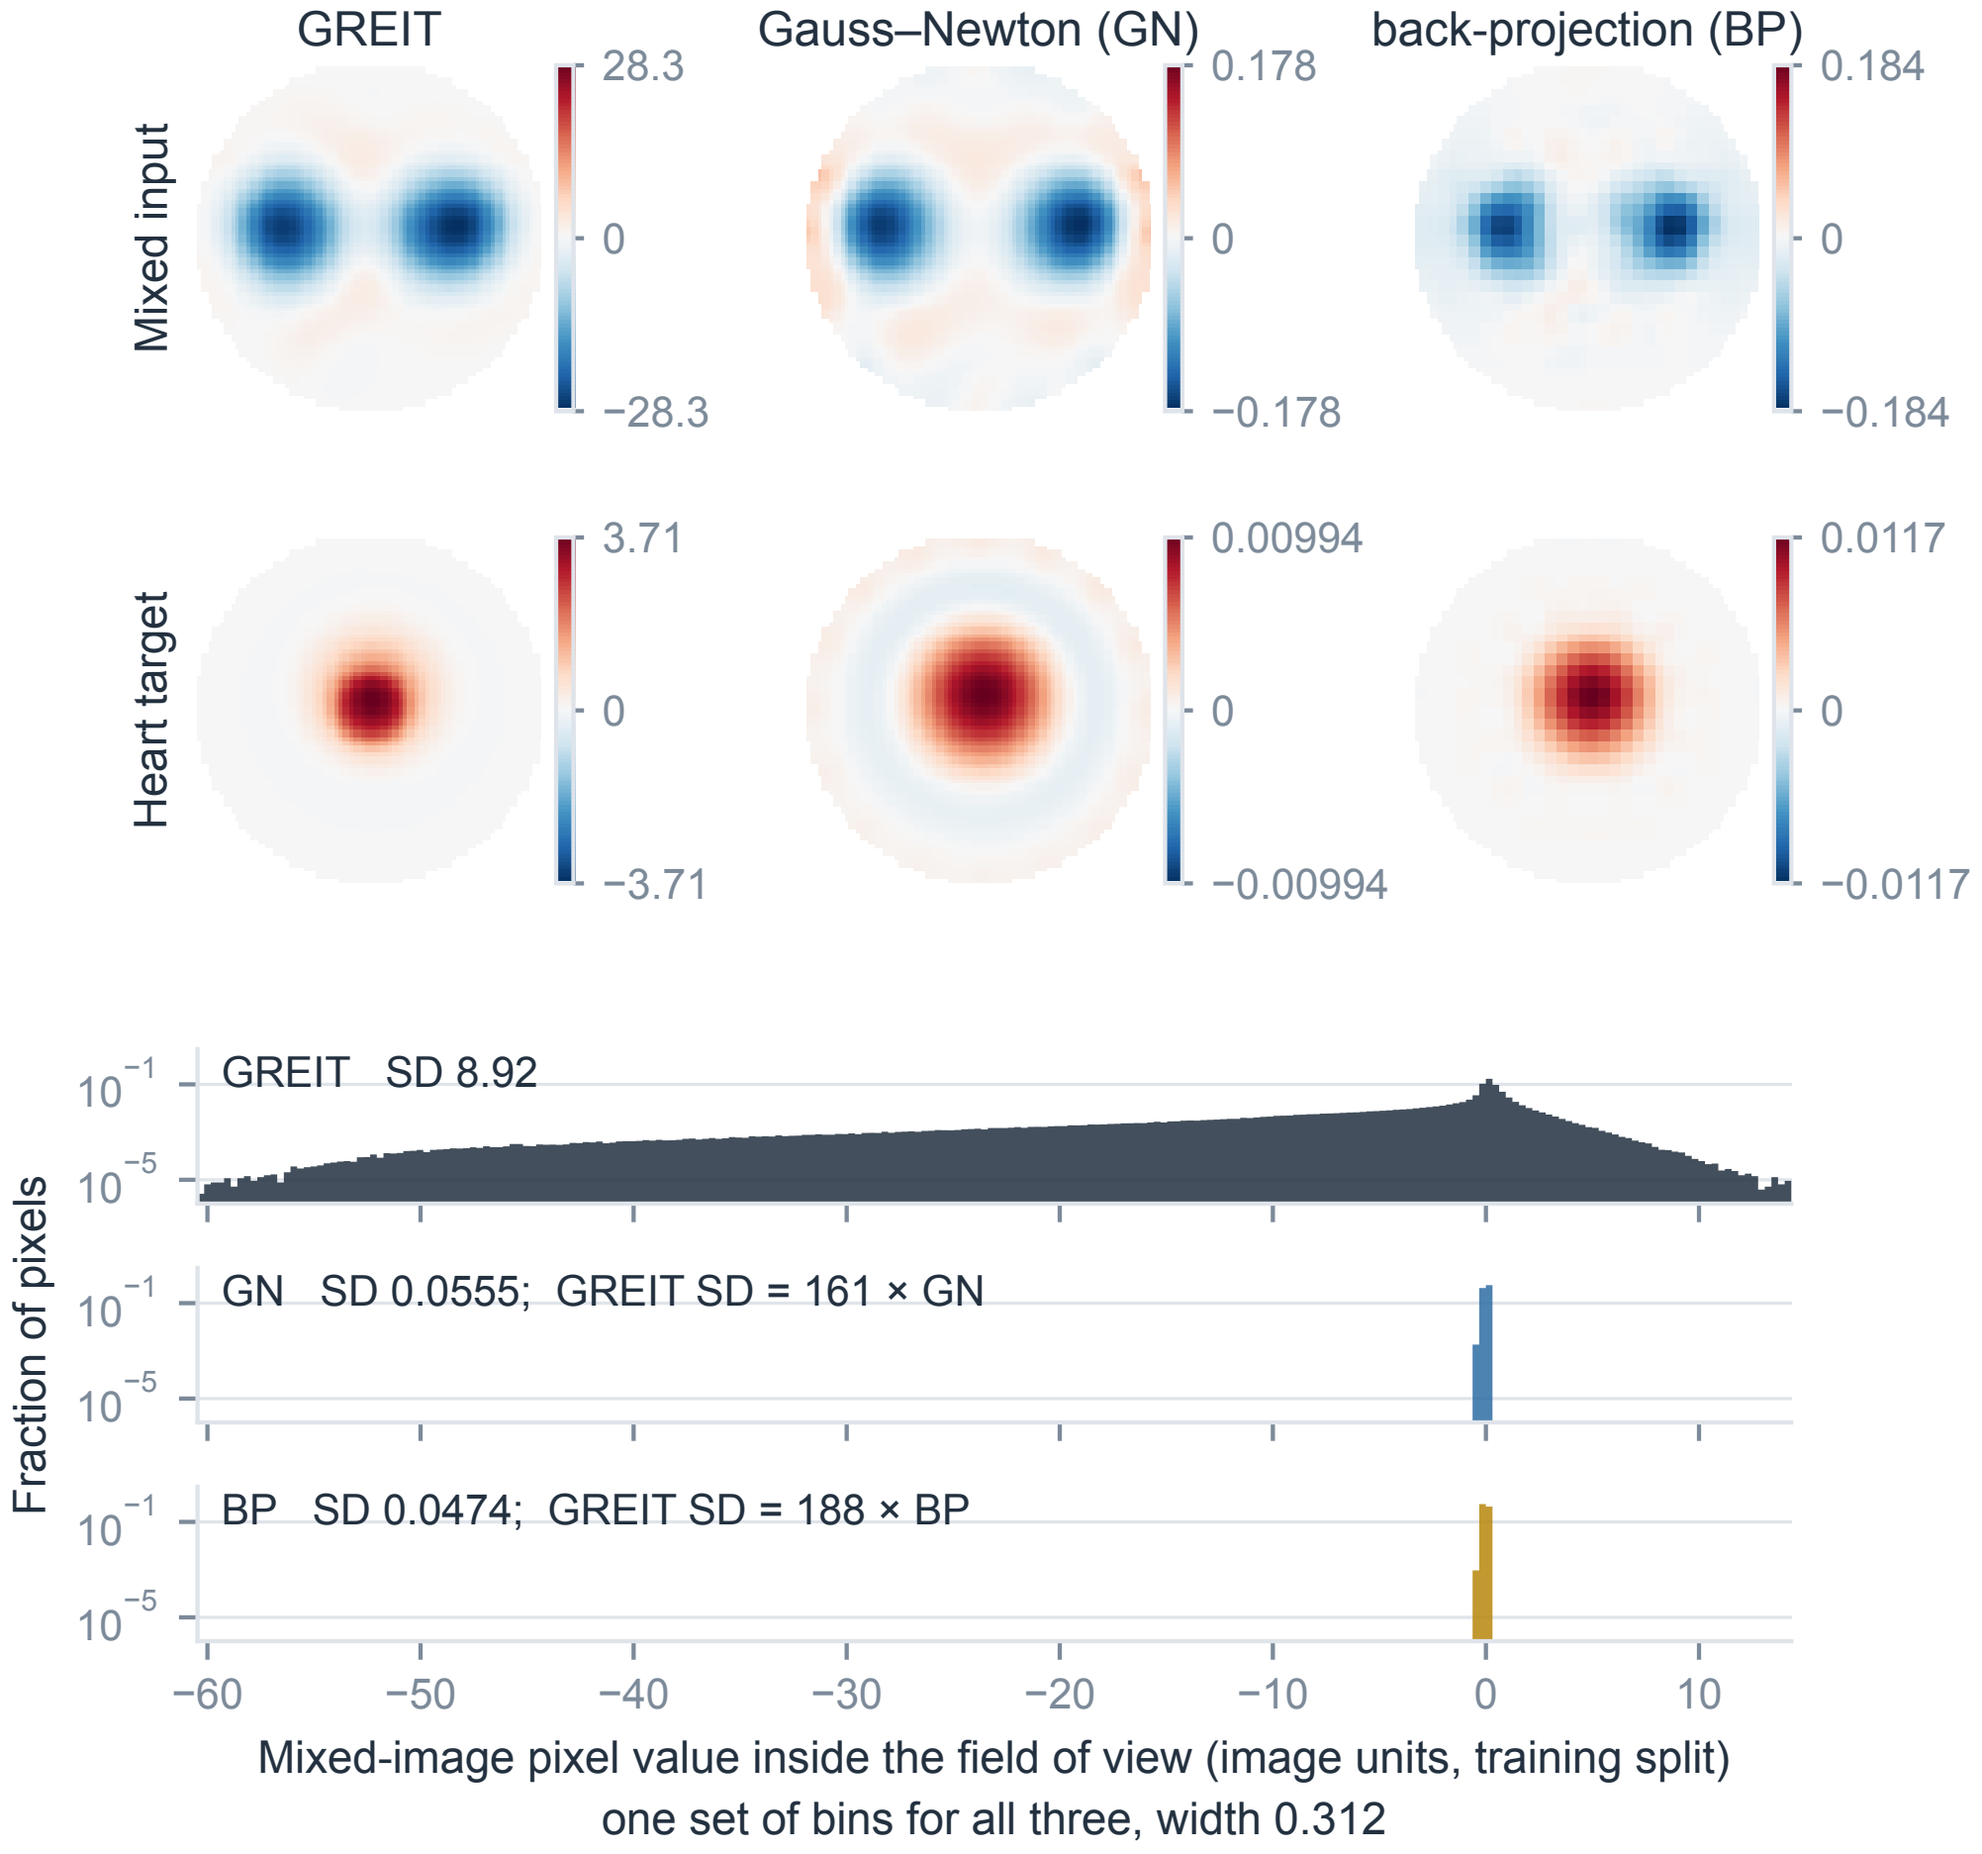
GREIT
Gauss–Newton (GN)
back-projection (BP)
Mixed input
Heart target
28.3
0
−28.3
0.178
−0.178
0.184
−0.184
3.71
−3.71
0.00994
−0.00994
0.0117
−0.0117
GREIT SD 8.92
GN SD 0.0555; GREIT SD = 161 × GN
BP SD 0.0474; GREIT SD = 188 × BP
Fraction of pixels
10^{-1}
10^{-5}
−60
−50
−40
−30
−20
−10
0
10
Mixed-image pixel value inside the field of view (image units, training split)
one set of bins for all three, width 0.312